


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/11/2025 - 23/11/2025
Dias de utilização	20/21 dias (95%)	
>= 4 horas	19 dias (90%)	
< 4 horas	1 dias (5%)	
Horas de utilização	133 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 53 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/11/2025)	1,093 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653880
Modo	CPAP
Pressão definida	10 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 7.0	Percentil 95.º: 17.3	Máximo: 25.9	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.5	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

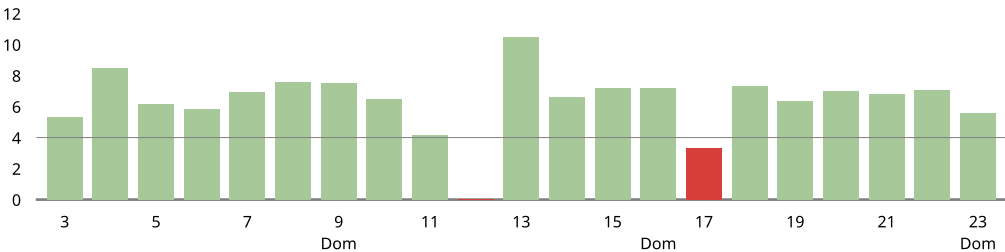


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653880


Utilização (horas)

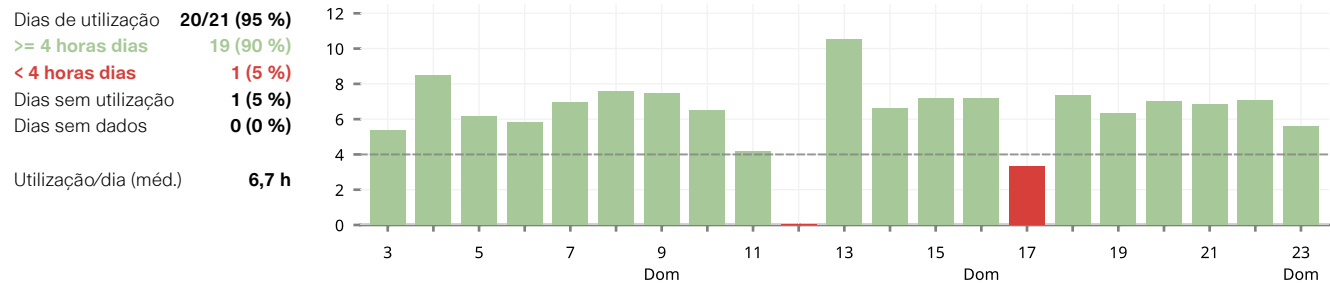

Fuga (l/min)

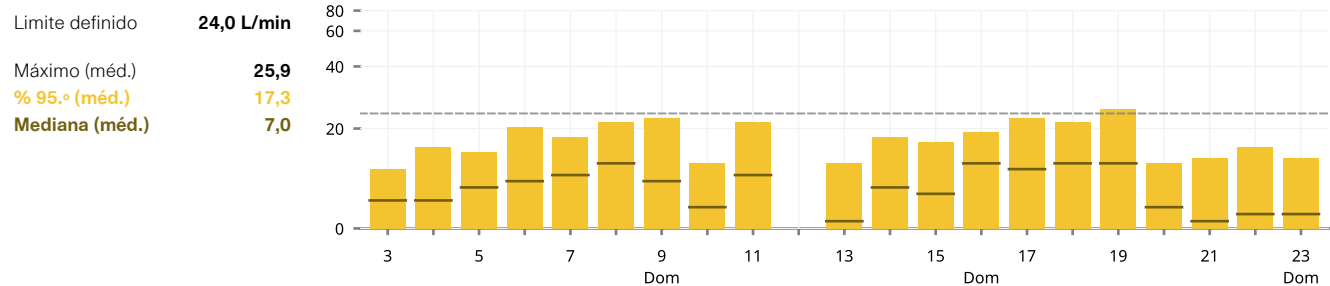

Pressão (cmH2O)

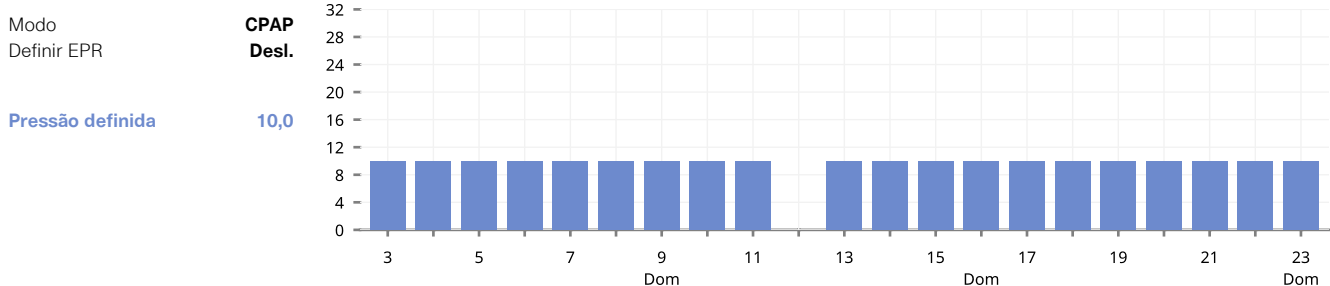

IAH (eventos/hora)

