


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/10/2025 - 01/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	199 horas 44 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 39 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 39 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/11/2025)	951 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653880
Modo	CPAP
Pressão definida	10 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 5.0	Percentil 95.º: 16.6	Máximo: 24.0	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.9	IAH: 2.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 1.7	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

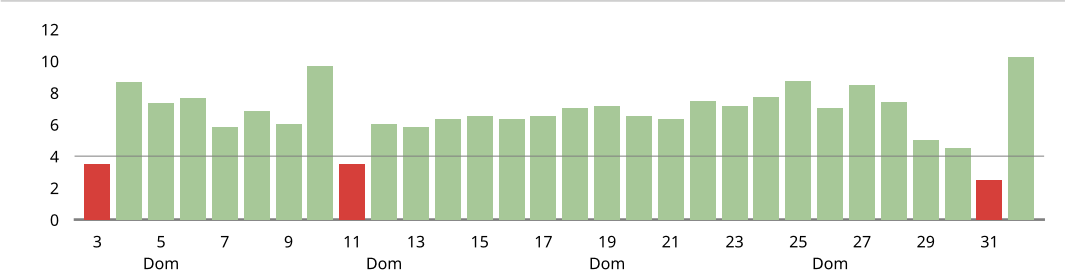


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653880


Utilização (horas)

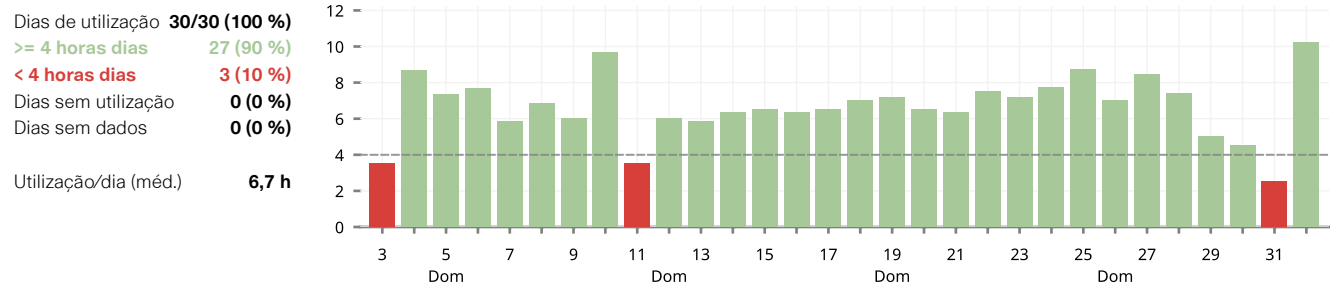

Fuga (l/min)

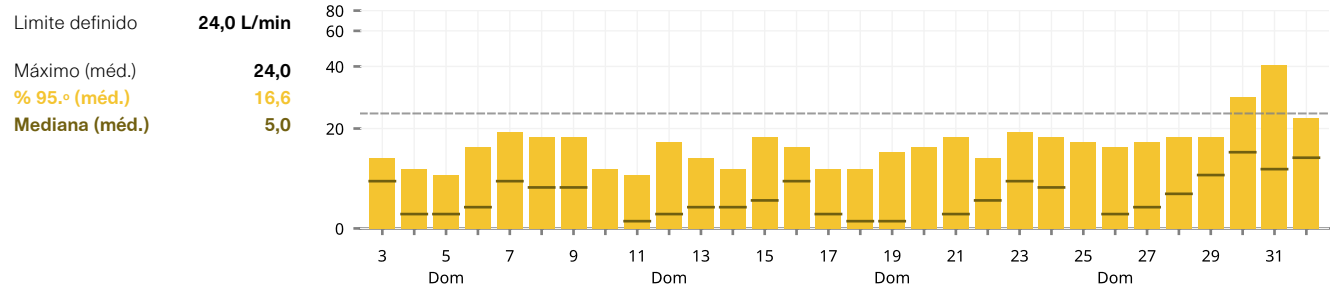

Pressão (cmH2O)

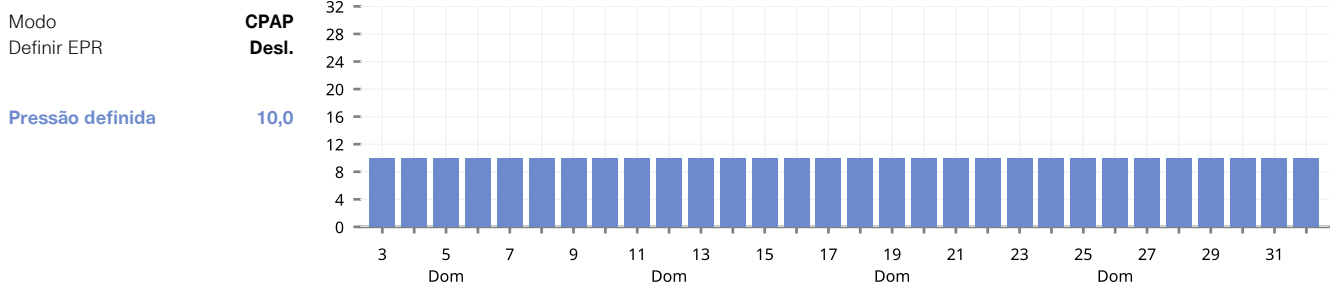

IAH (eventos/hora)

