


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/08/2025 - 02/09/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	205 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 32 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/09/2025)	3,748 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291887
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 5.6	Máximo: 12.4	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 1.2	IAH: 2.0	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

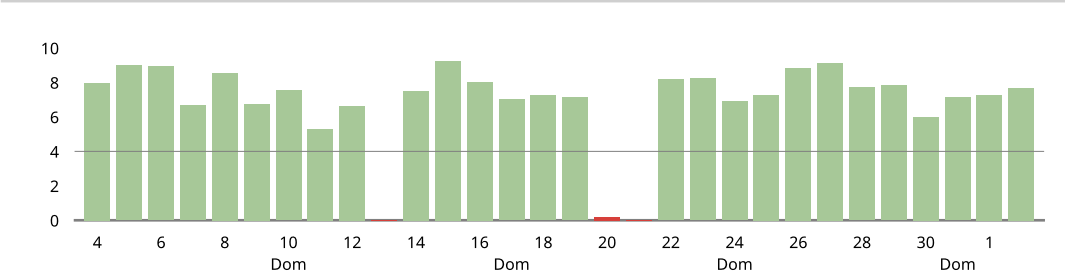

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291887

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/30 (93 %)**
>= 4 horas dias **27 (90 %)**
< 4 horas dias **1 (3 %)**
Dias sem utilização **2 (7 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,4 h**

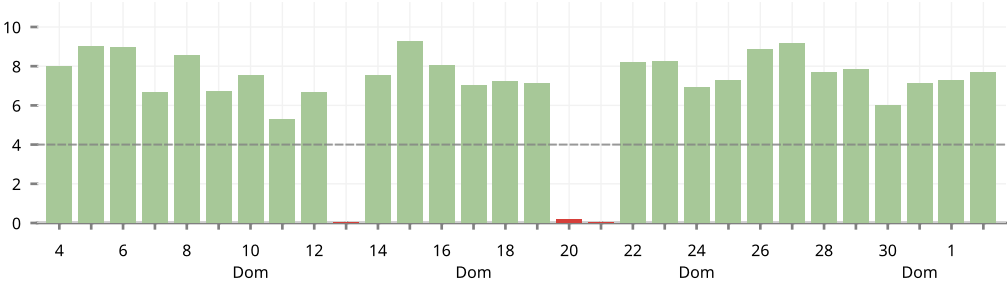

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **12,4**
% 95.º (méd.) **5,6**
Mediana (méd.) **0,0**

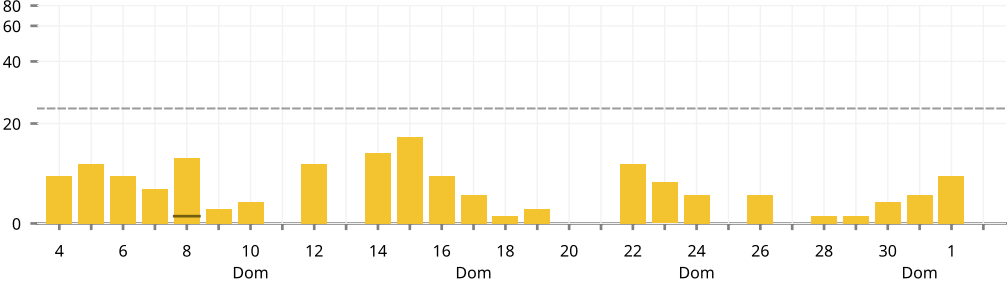

Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **7,6**

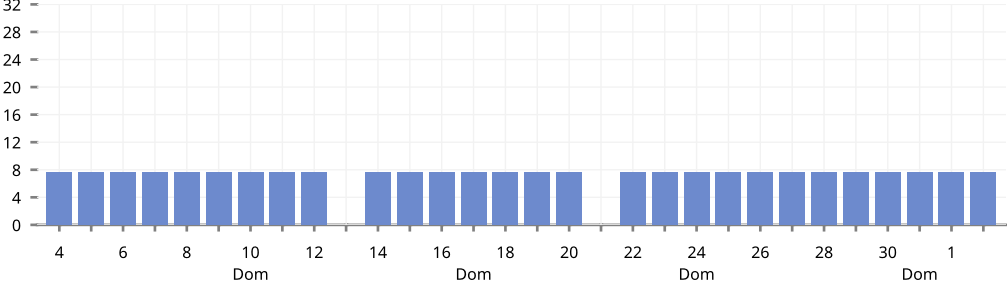

IAH (eventos/hora)

IAH **2.0**
IH **1.2**
IA **0.8**
IAC **0.5**
IAO **0.3**
IAD **0.0**
RERA **0.2**
%RCS (méd.) **0.0**

