


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 17/11/2025 - 16/12/2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 27/30 dias (90%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 27 dias (90%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 209 horas 34 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 6 horas 59 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 7 horas 46 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 7 horas 45 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 16/12/2025) | 7,245 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22222040047  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 6 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 9.6 cmH2O    |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 8.6   | Percentil 95.º: 9.5  | Máximo: 9.6  |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 14.9  | Percentil 95.º: 38.0 | Máximo: 50.4 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.1        | IH: 0.5              | IAH: 0.6     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.0   | Obstrutiva: 0.0      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 3.2            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

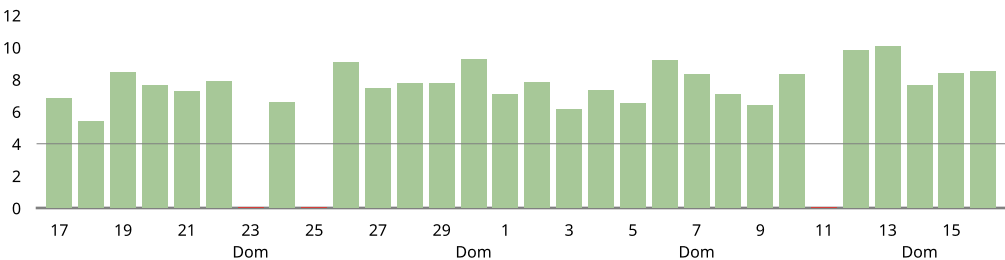


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040047


## Utilização (horas)

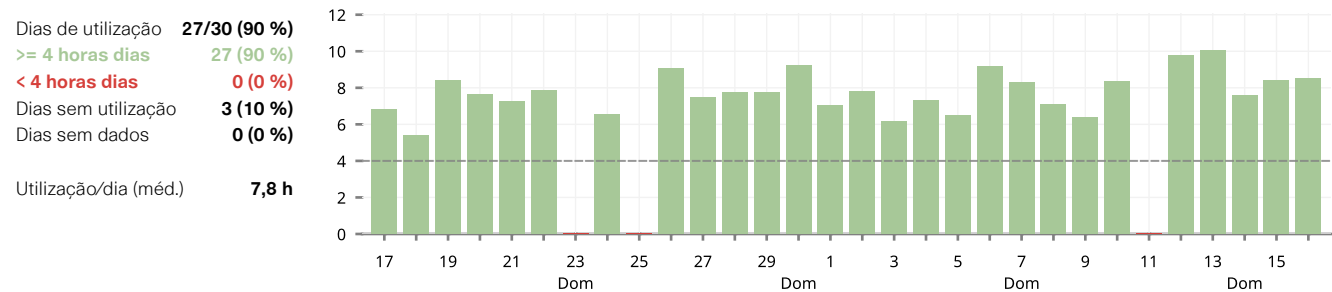

## Fuga (l/min)

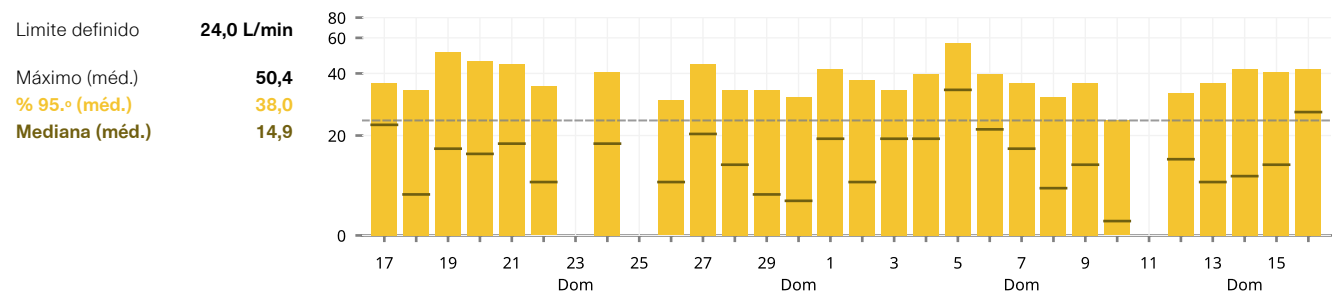

## Pressão (cmH2O)

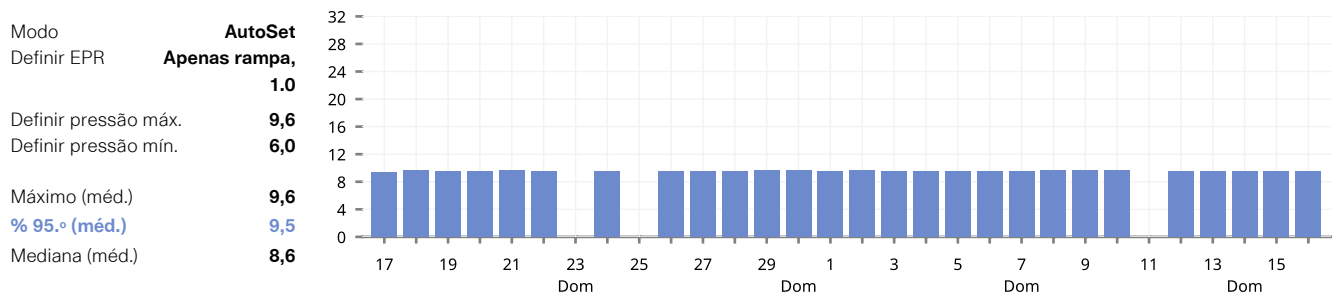

## IAH (eventos/hora)

