


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/08/2025 - 02/09/2025
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	221 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 23 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 13 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/09/2025)	6,514 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222040047
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 9.5	Máximo: 9.6	
Fugas — l/min	Mediana: 16.9	Percentil 95.º: 38.4	Máximo: 51.8	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.6	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	3.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

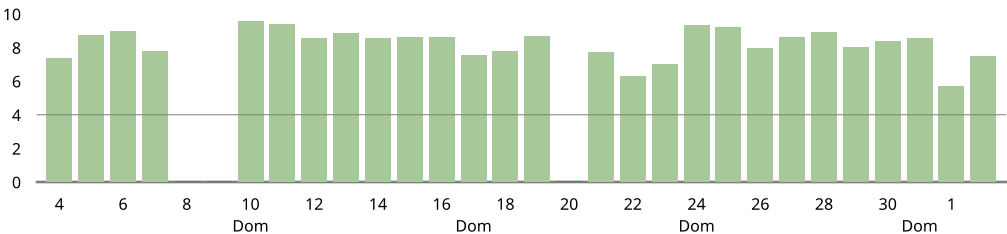


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040047


Utilização (horas)

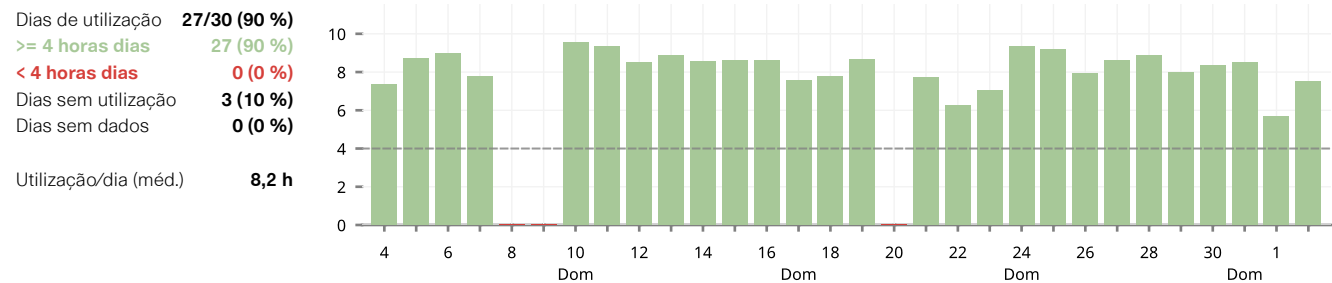

Fuga (l/min)

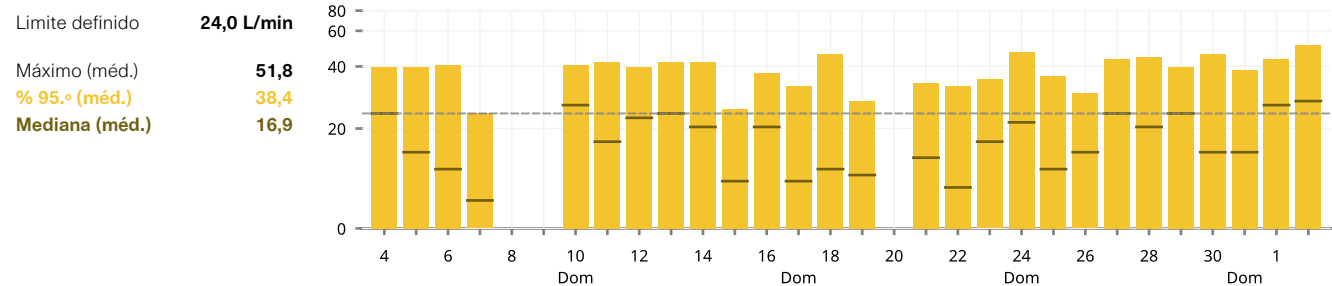

Pressão (cmH2O)

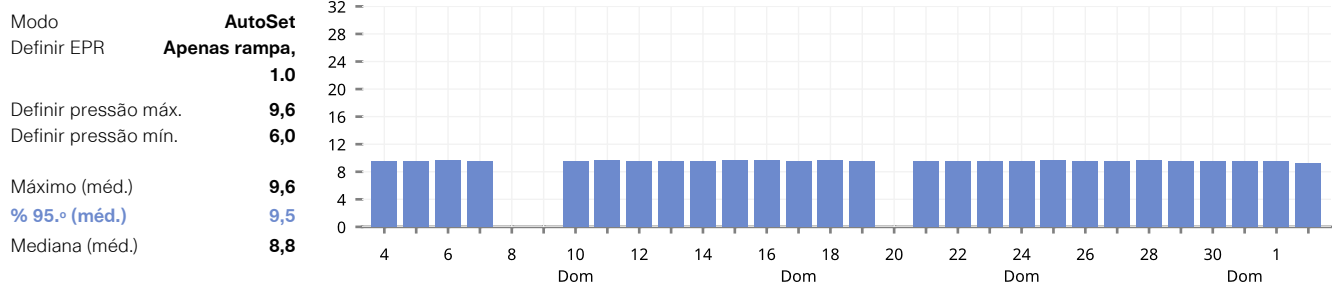

IAH (eventos/hora)

