


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/02/2026 - 10/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	235 horas 18 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 51 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/03/2026)	7,858 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222040047
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	8.2	Percentil 95.º:	9.5	Máximo:	9.6
Fugas — l/min	Mediana:	8.5	Percentil 95.º:	34.6	Máximo:	45.9
Eventos por hora	IA:	0.1	IH:	1.3	IAH:	1.4
Índice de apneia	Central:	0.0	Obstrutiva:	0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA						1.9
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					1 minutos (0%)	

Horas de utilização

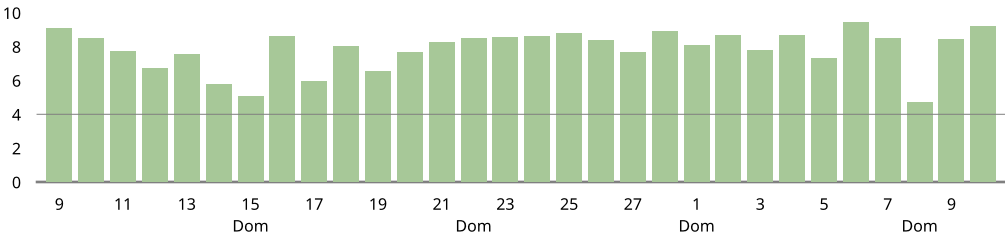


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040047


Utilização (horas)

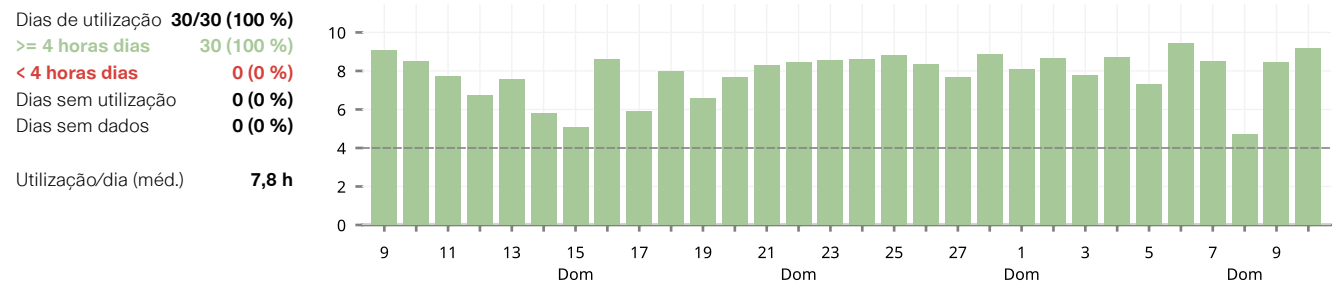

Fuga (l/min)

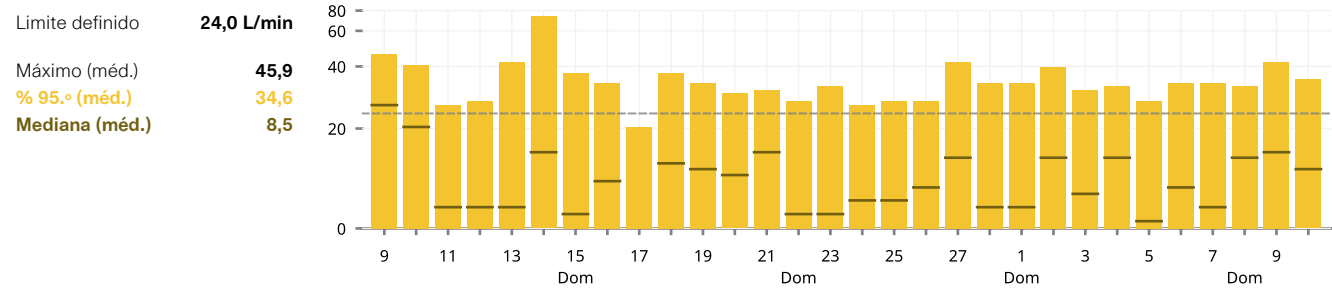

Pressão (cmH2O)

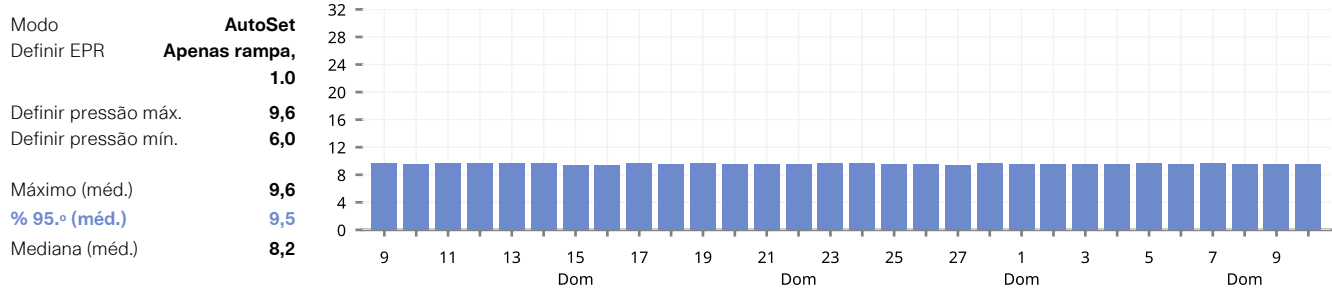

IAH (eventos/hora)

