


Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |              | 13/03/2026 - 19/03/2026 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Dias de utilização                                           |              | 5/7 dias (71%)          |                 |
| >= 4 horas                                                   |              | 4 dias (57%)            |                 |
| < 4 horas                                                    |              | 1 dias (14%)            |                 |
| Horas de utilização                                          |              | 22 horas 7 minutos      |                 |
| Utilização média (total de dias)                             |              | 3 horas 10 minutos      |                 |
| Utilização média (dias de utilização)                        |              | 4 horas 25 minutos      |                 |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |              | 4 horas 35 minutos      |                 |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 19/03/2026) |              | 3,789 horas             |                 |
| AirSense 10 Elite                                            |              |                         |                 |
| Número de série                                              |              | 22211230110             |                 |
| Modo                                                         |              | CPAP                    |                 |
| Pressão definida                                             |              | 5.8 cmH2O               |                 |
| EPR                                                          |              | Apenas rampa            |                 |
| Nível de EPR                                                 |              | 1                       |                 |
| Terapia                                                      |              |                         |                 |
| Fugas — l/min                                                | Mediana: 5.3 | Percentil 95.º: 13.2    | Máximo: 30.5    |
| Eventos por hora                                             | IA: 1.0      | IH: 0.6                 | IAH: 1.6        |
| Índice de apneia                                             | Central: 0.5 | Obstrutiva: 0.4         | Desconhecid 0.1 |
| Índice RERA                                                  | 0.1          |                         |                 |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)           |              | 0 minutos (0%)          |                 |

Horas de utilização

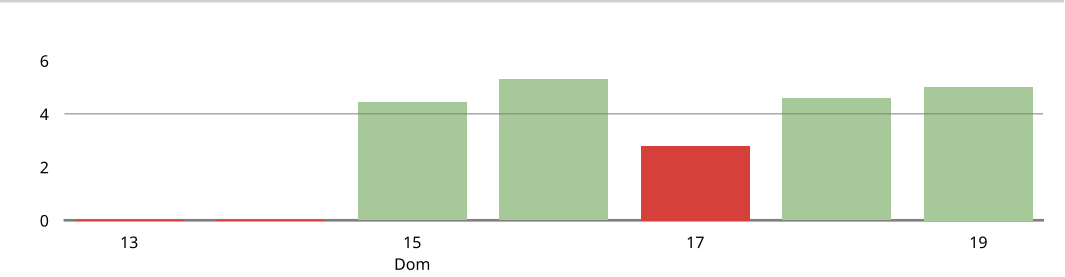


# Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22211230110


## Utilização (horas)

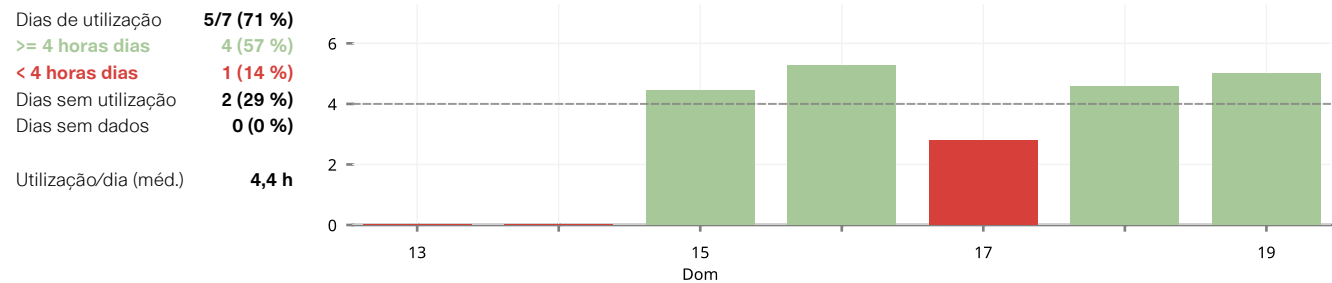

## Fuga (l/min)

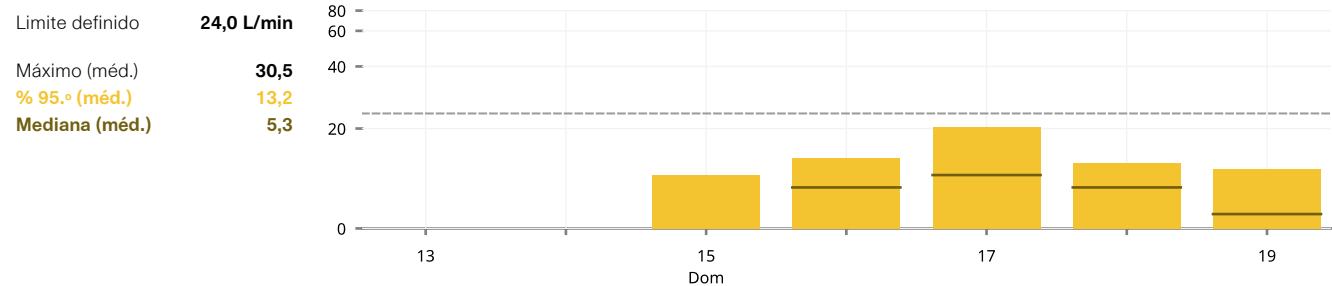

## Pressão (cmH2O)

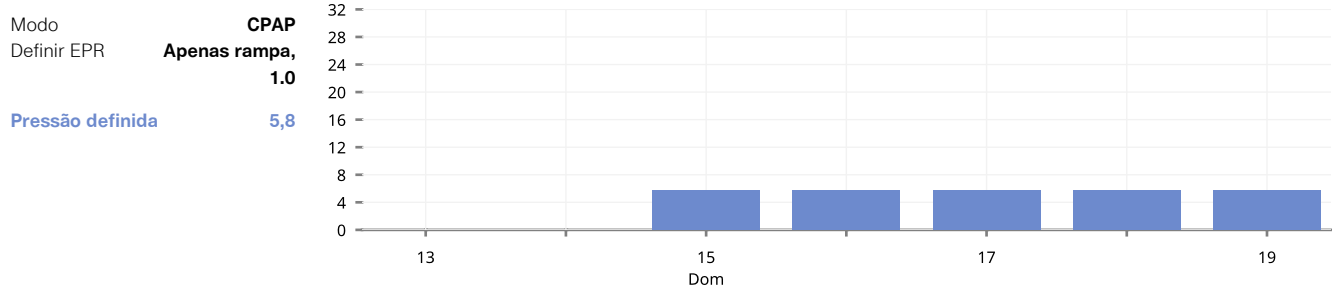

## IAH (eventos/hora)

