


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/09/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização		3/3 dias (100%)
>= 4 horas		3 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		17 horas 33 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 51 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 51 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 18 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)		3,917 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292587
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 11.2	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.5	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

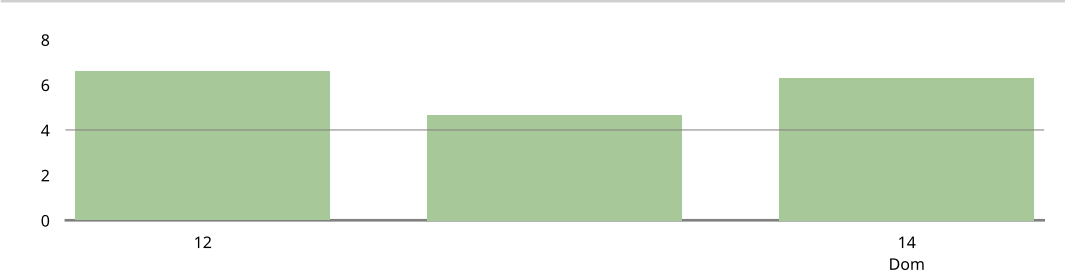


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292587


Utilização (horas)

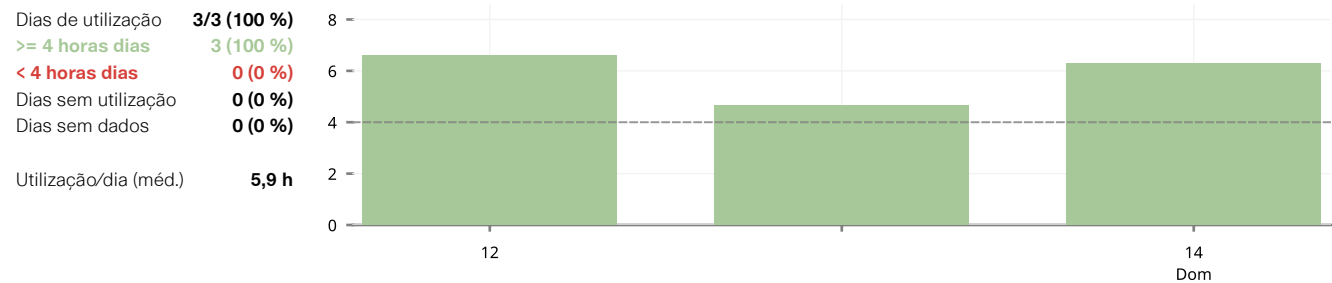

Fuga (l/min)

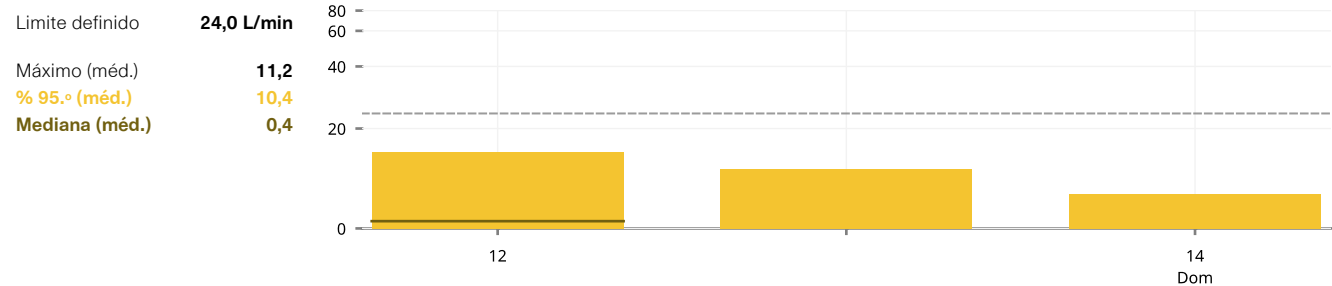

Pressão (cmH2O)

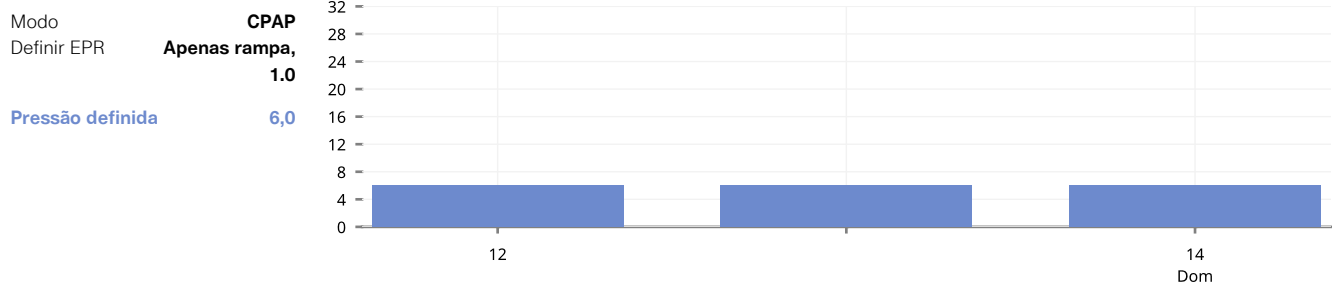

IAH (eventos/hora)

