


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/10/2025 - 26/10/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	58 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/10/2025)	2,512 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221596628
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.9	Percentil 95.º:	7.9	Máximo:	7.9
Fugas — l/min	Mediana:	14.9	Percentil 95.º:	40.3	Máximo:	52.8
Eventos por hora	IA:	0.7	IH:	0.3	IAH:	1.0
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	0.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA						1.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

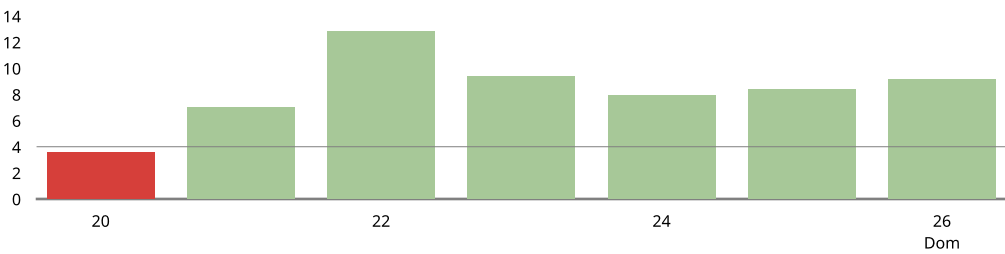


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628


Utilização (horas)

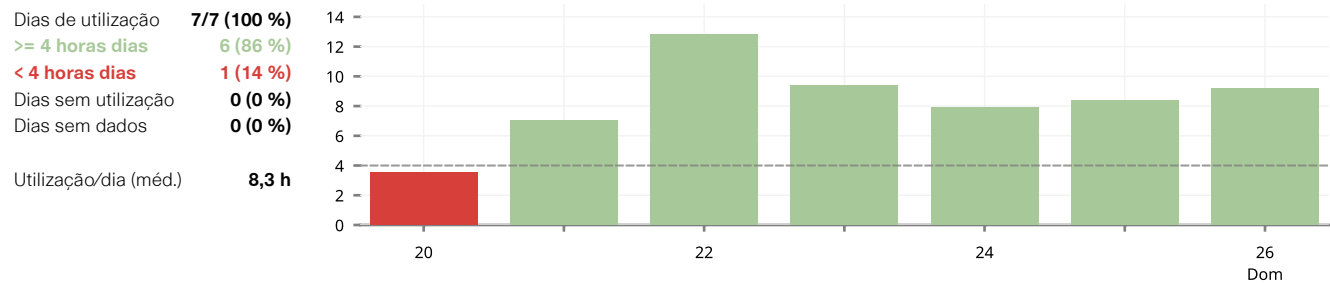

Fuga (l/min)

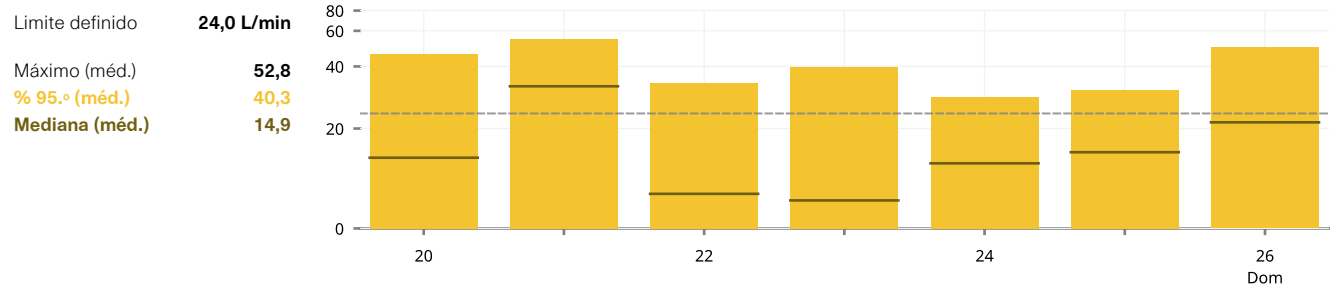

Pressão (cmH2O)

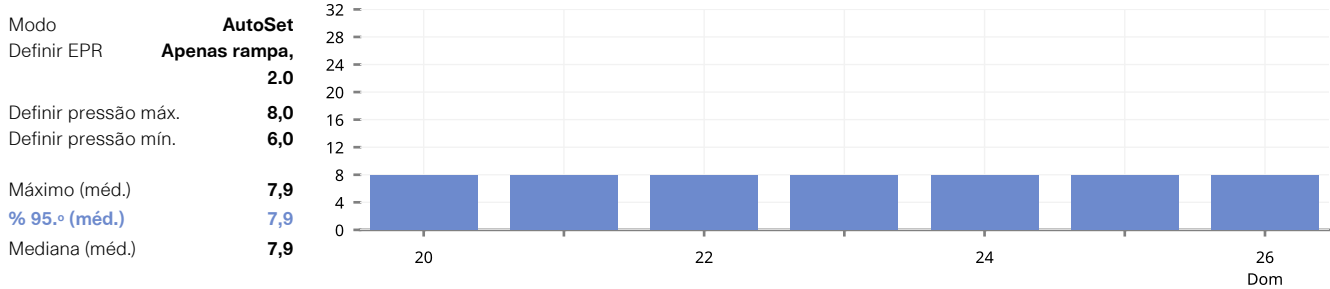

IAH (eventos/hora)

