


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/09/2025 - 05/10/2025
Dias de utilização	15/15 dias (100%)	
>= 4 horas	15 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	114 horas 24 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 38 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/10/2025)	2,338 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221596628
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.9	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 14.8	Percentil 95.º: 36.6	Máximo: 53.6	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.7	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.2
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

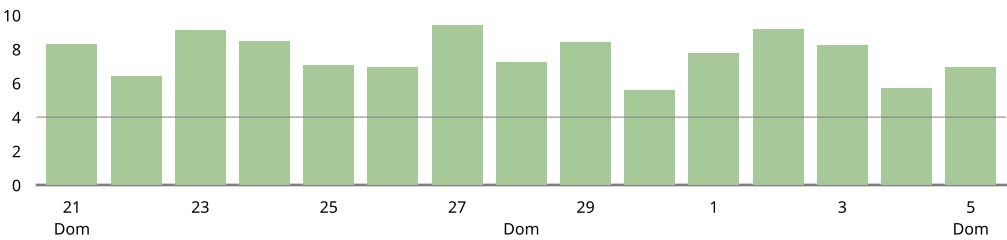


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628


Utilização (horas)

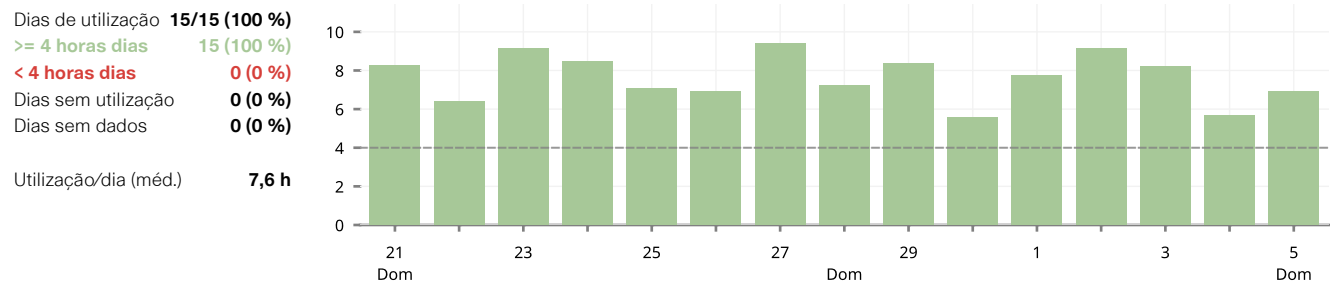

Fuga (l/min)

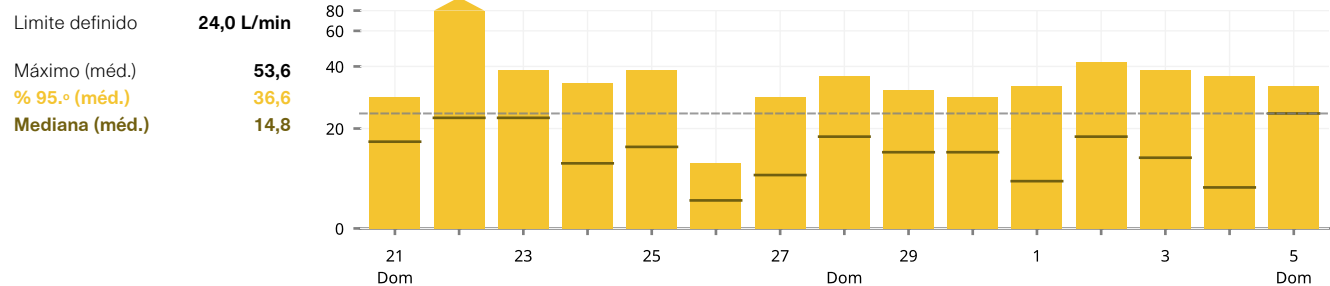

Pressão (cmH2O)

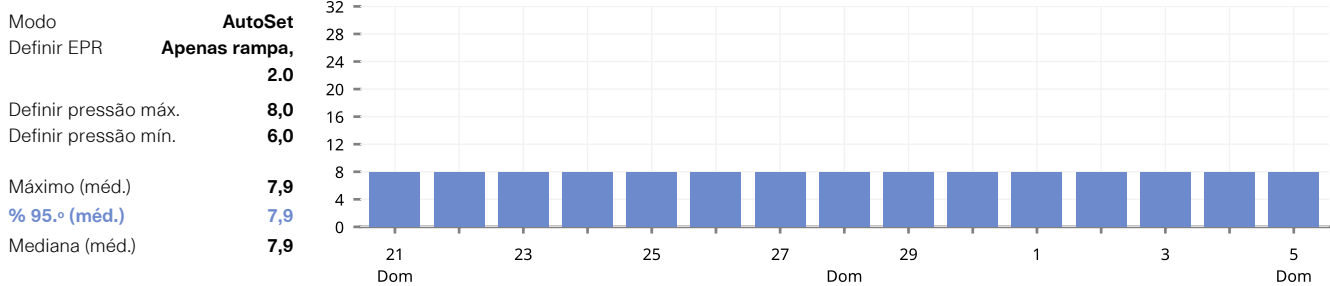

IAH (eventos/hora)

