


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/11/2025 - 01/12/2025
Dias de utilização	22/30 dias (73%)	
>= 4 horas	19 dias (63%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	118 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 23 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/12/2025)	4,473 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222041394
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.1	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 9.7	
Fugas — l/min	Mediana: 13.5	Percentil 95.º: 39.6	Máximo: 56.1	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.1	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

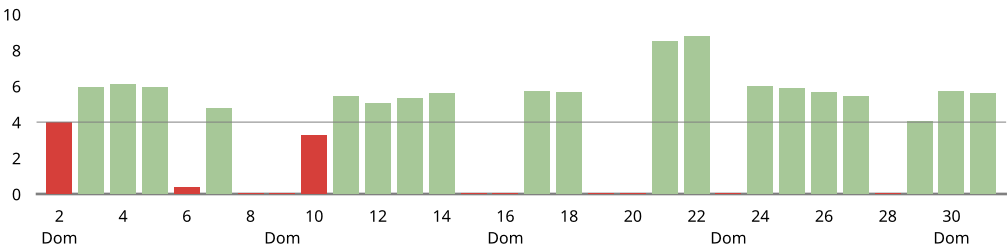


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222041394


Utilização (horas)

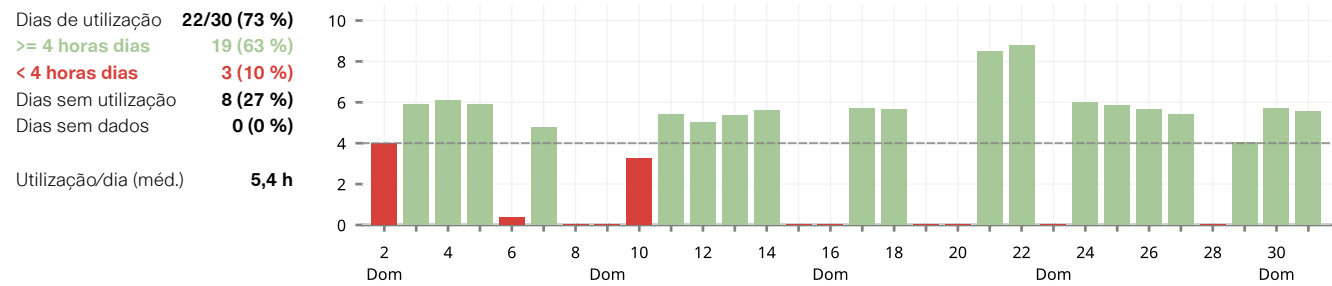

Fuga (l/min)

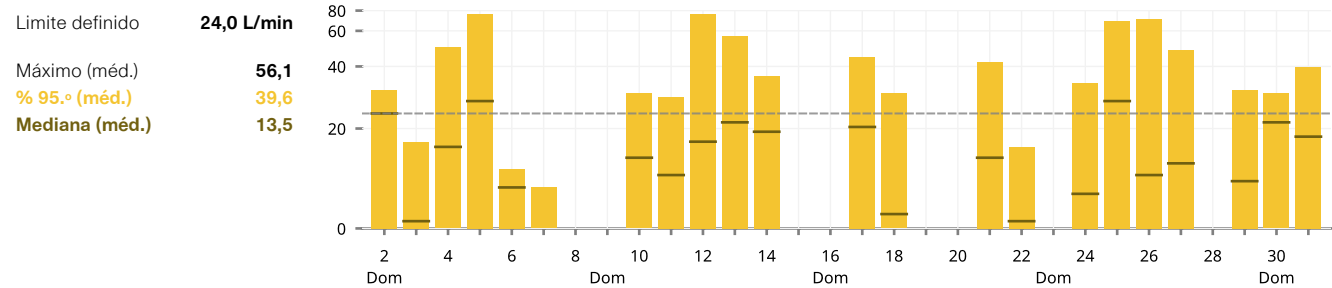

Pressão (cmH2O)

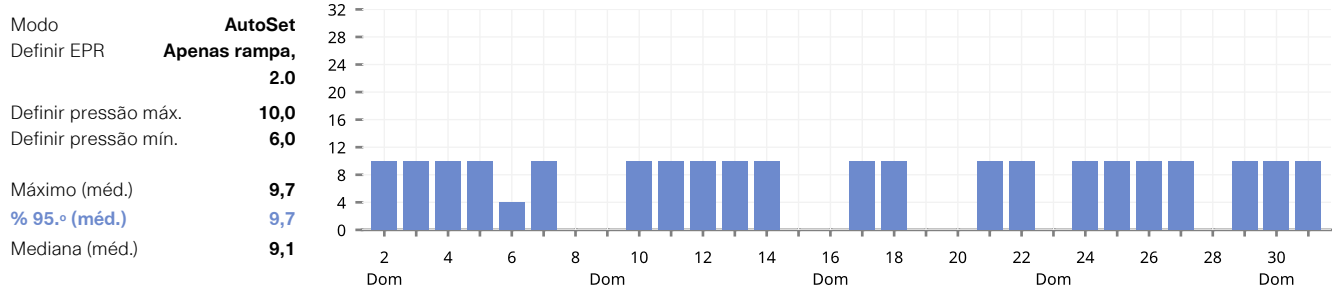

IAH (eventos/hora)

