


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/02/2026 - 17/03/2026
Dias de utilização	23/30 dias (77%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	5 dias (17%)	
Horas de utilização	134 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 32 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/03/2026)	2,039 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291915
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 11.1	Máximo: 11.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.8	Percentil 95.º: 7.1	Máximo: 16.0	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.5	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

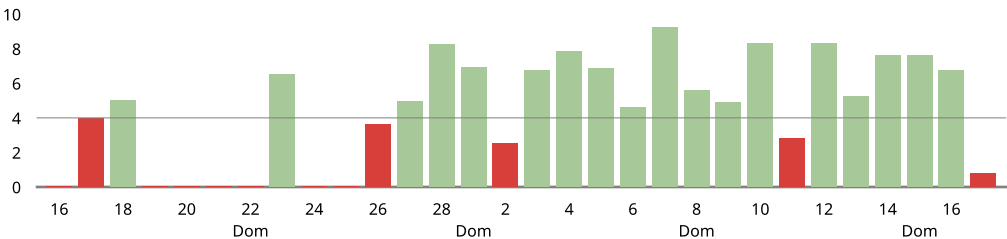

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291915

Utilização (horas)

Dias de utilização **23/30 (77 %)**
>= 4 horas dias **18 (60 %)**
< 4 horas dias **5 (17 %)**
Dias sem utilização **7 (23 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **5,9 h**

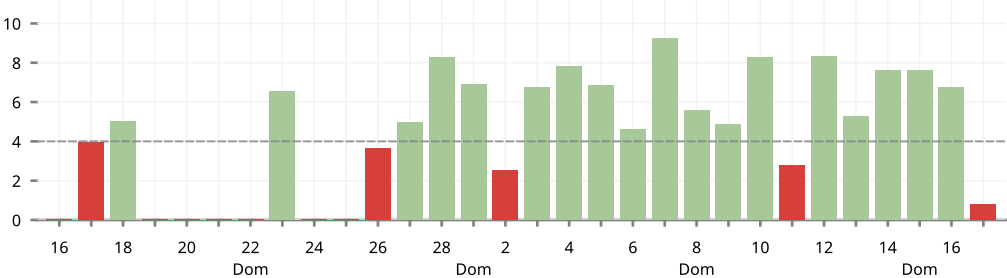

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **16,0**
% 95.º (méd.) **7,1**
Mediana (méd.) **0,8**

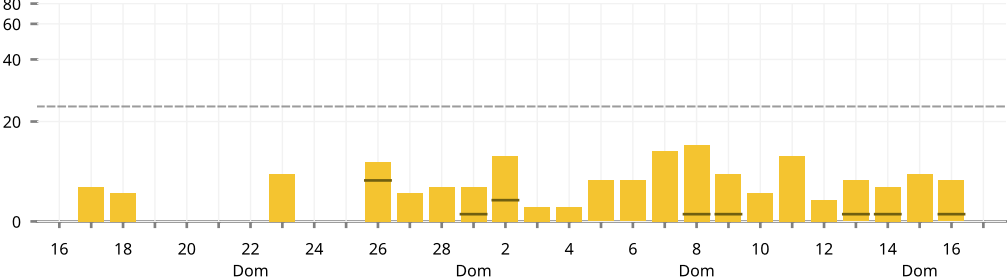


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Tempo total, 3.0**

Definir pressão máx. **14,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **11,9**
% 95.º (méd.) **11,1**
Mediana (méd.) **9,5**

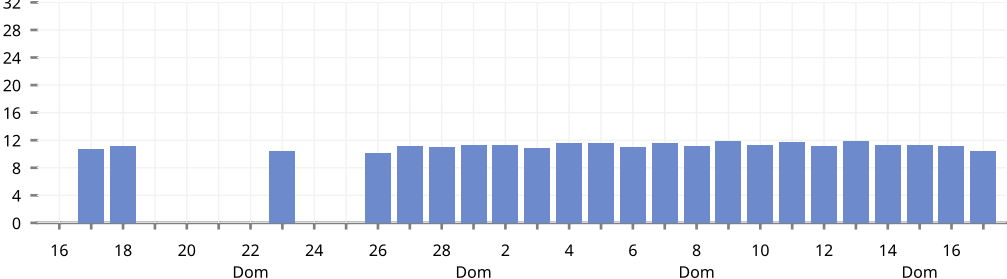

IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.7**
IH ☐ **0.5**
IA ☐ **0.2**
IAC **0,0**
IAO **0,1**
IAD **0,0**
RERA **0,2**
%RCS (méd.) **0.0**

