


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/09/2025 - 10/09/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		6 dias (86%)
< 4 horas		1 dias (14%)
Horas de utilização		38 horas 54 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 33 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 33 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 57 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/09/2025)		2,694 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291904
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.0	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 16.6	Máximo: 34.8	
Eventos por hora	IA: 2.9	IH: 0.5	IAH: 3.4	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

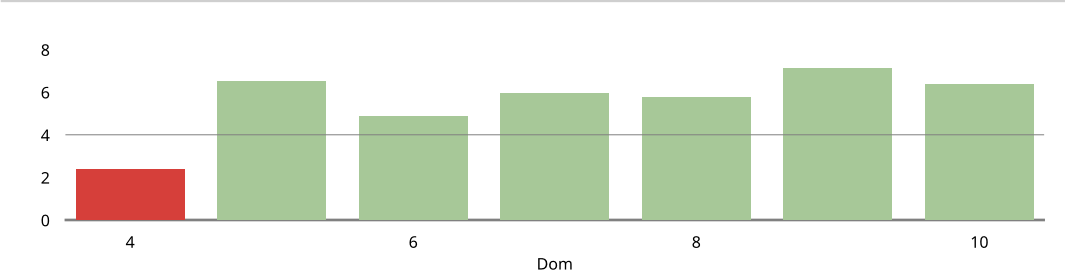


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291904


Utilização (horas)

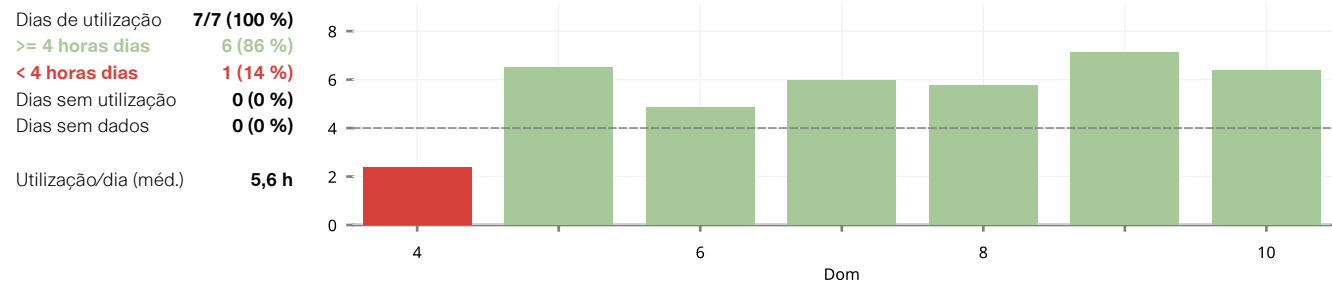

Fuga (l/min)

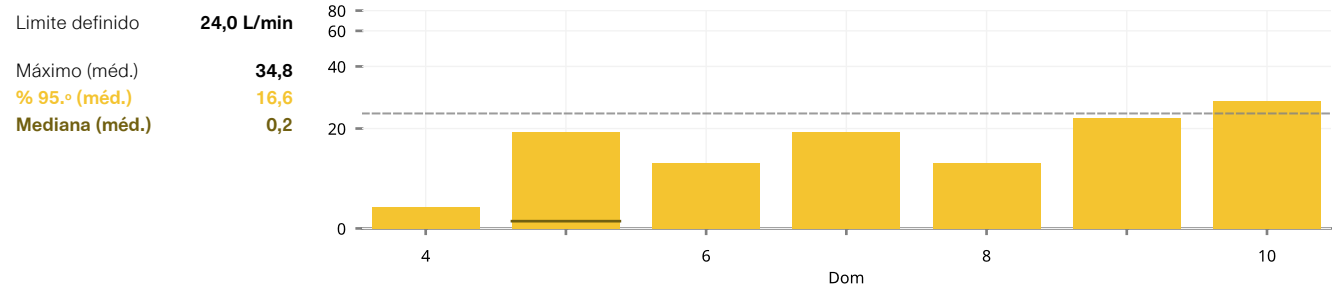

Pressão (cmH2O)

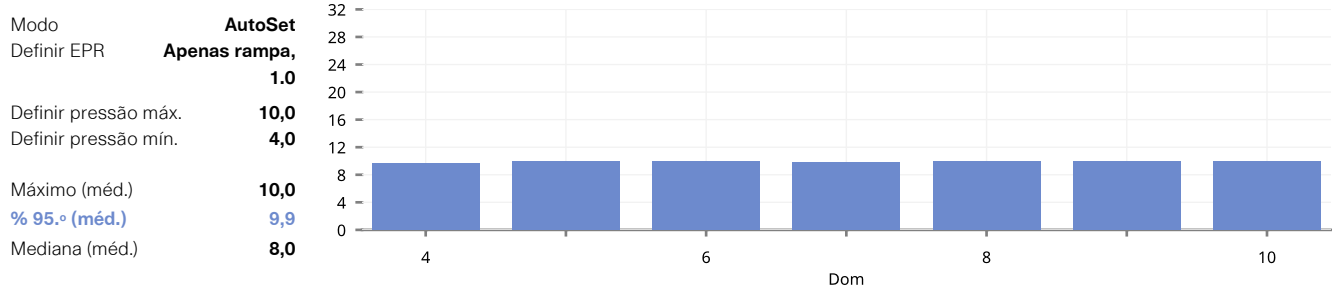

IAH (eventos/hora)

