


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/09/2025 - 09/09/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	44 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/09/2025)	2,298 horas	

AirMini AutoSet	
Número de série	22181998627
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.6	Máximo: 7.4	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.0	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

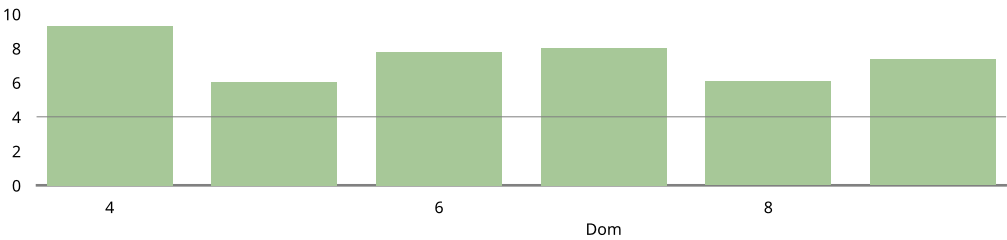


Relatório de terapia


AirMini AutoSet

NS: 22181998627


Utilização (horas)

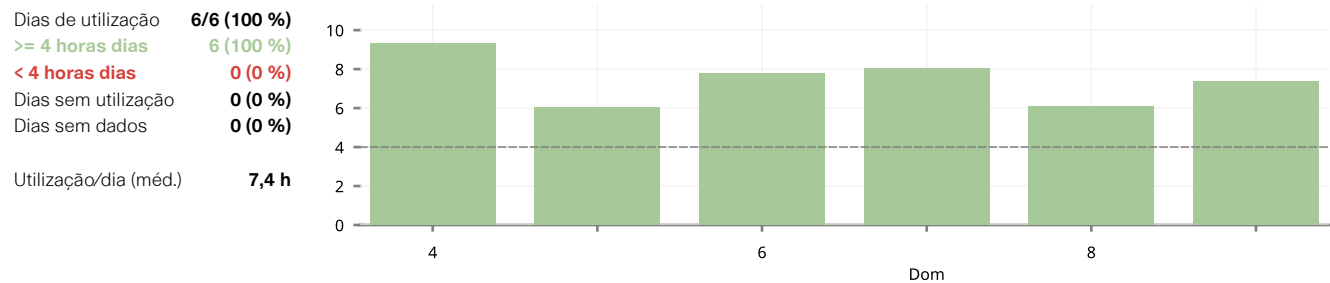

Fuga (l/min)

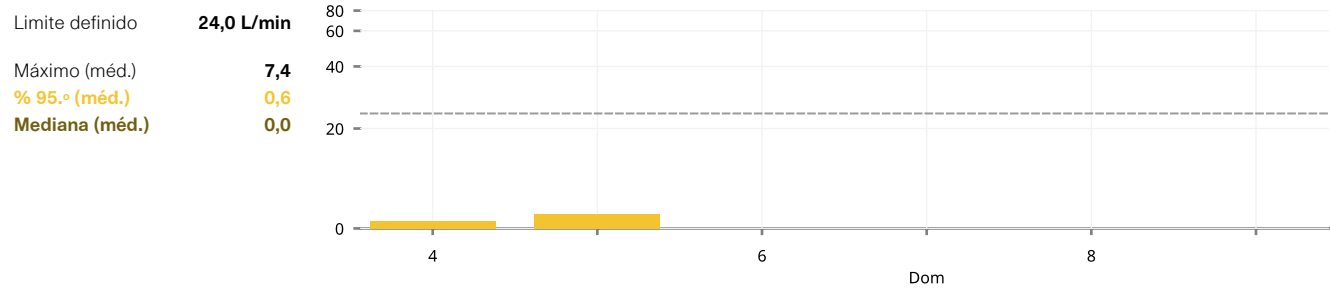

Pressão (cmH2O)

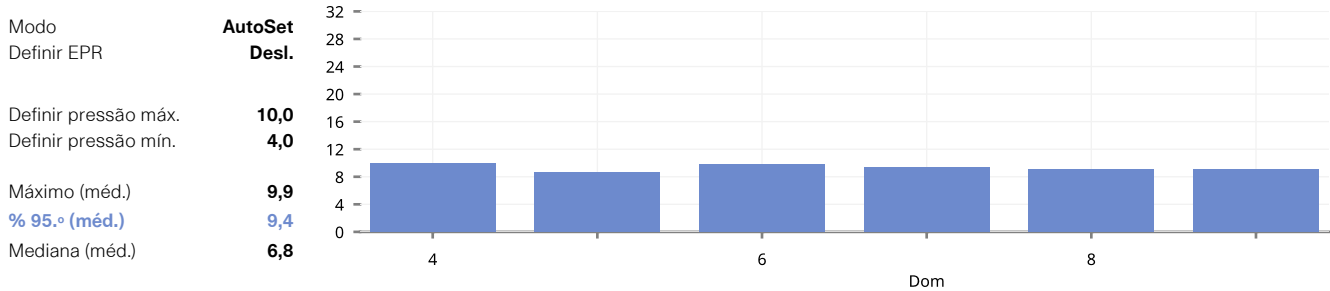

IAH (eventos/hora)

