

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. SILVIO CARVALHO**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **5 julho 1971** Idade: **54**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **05/05/2026**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

02/01/2026 - 02/03/2026

Dispositivo: AirSense 10 CPAP (S/N: 22161303440)

Parâmetros do dispositivo

Modo de terapia: **CPAP**

Nível APE: **2,0 cmH2O**

Activação subida: **AUTO**

Pressão programada: **9,0 cmH2O**

Activar APE: **ON**

Tempo de rampa: **45,0 Minutos**

APE: **FULL_TIME**

Activação paciente APE: **ON**

Acesso: **LIGADO**

Fuga - l/min

Percentil 95: **0,6**

Índices respiratórios - eventos/hora

AHI: **0,6**

Utilização Total

Dias de Uso >= 4 horas : **35**

Dias de não utilização: **11**

Mediana do uso diário: **6:23**

Dias de Uso < 4 horas : **14**

Totalidade de dias: **60**

Média de uso diário: **4:26**

% Dias de Uso >= 4 horas : **58**

Horas de utilização: **266:14**


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


02/01/2026 - 02/03/2026

Dispositivo: AirSense 10 CPAP (S/N: 22161303440)


Fuga

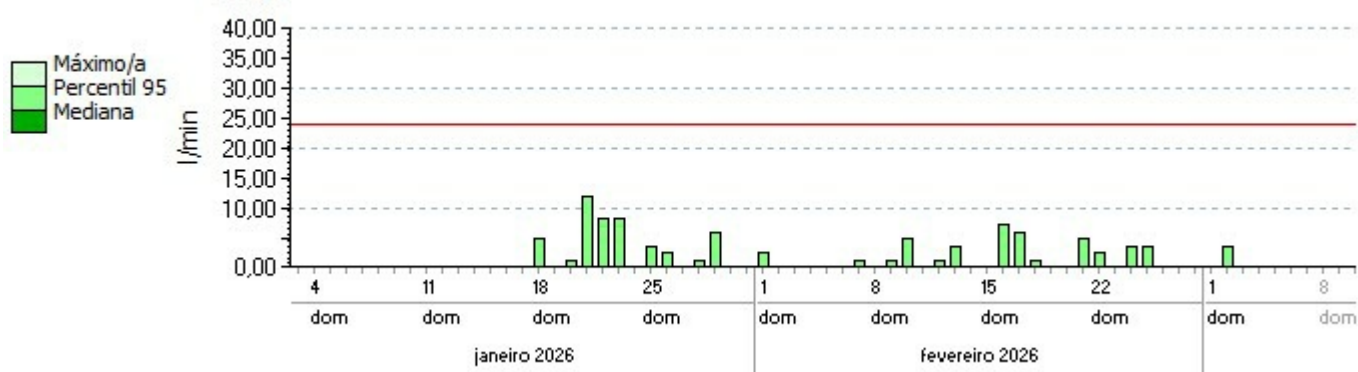

IAH & IA

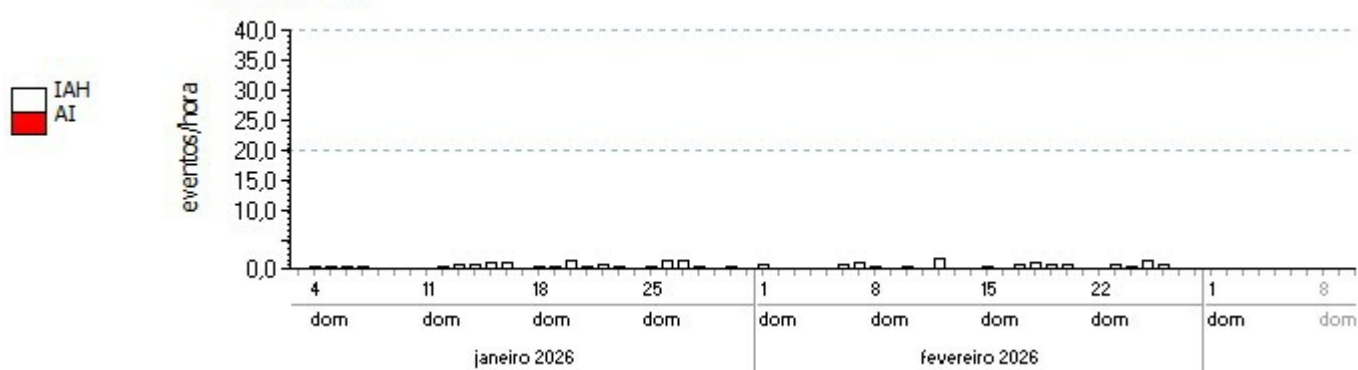

Uso

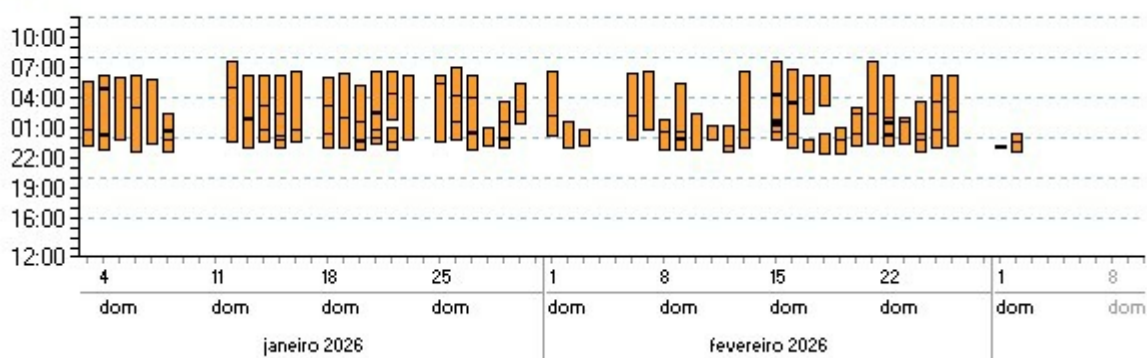

Utilização Total

