

PAGOTTO, LUIS FERNANDO

Relatório de resumo

Data de nasc: 11/10/1957 Organização: FARIA E MATOS COMERCIO DE... Intervalo de datas: 11/04/2026 - 10/05/2026
Referência: Morada: RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA Data de configuração: 28/10/2024
ID do paciente: LUIS FERNANDO PAG... Máscara:
Telefone: App vinculado:
Telefone:
Dispositivos: DreamStation Auto BiPAP V1.1.8.3313 (700X180) J3526739516A0

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA FARIA E MATOS COMERCIO DE RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
CLAUDIA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 11/04/2026 - 10/05/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/04/2026 - 10/05/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	5 dias 21horas. 59 min. 54 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 49 min. 53 segundos.
Média de uso (todos os dias)	4horas. 43 min. 59 segundos.
Média de uso (dias de uso)	4horas. 43 min. 59 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 15 min. 43 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	66,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	33,3%
Tempo total com soprador	5 dias 22horas. 49 min. 7 segundos.

Resumo de Bi-Level Automático

Titulação máxima da pressão IPAP	16,0 cmH2O
Da pressão IPAP do aparelho <= 90% do tempo	16,0 cmH2O
Titulação máxima da pressão EPAP	13,0 cmH2O
Da pressão EPAP do aparelho <= 90% do tempo	13,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	1horas. 47 min. 20 segundos.
Média de IAH	3,0




Definições do Dispositivo a partir de 10/05/2026

Modo do aparelho Auto Bi-Level - Bi-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
IPAP máx.	16 cmH ₂ O
EPAP mín.	12 cmH ₂ O
Suporte pressórico máx.	3 cmH ₂ O
Suporte pressórico mín.	3 cmH ₂ O
Configuração Bi-Flex	1
Bloqueio Bi-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	8,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso

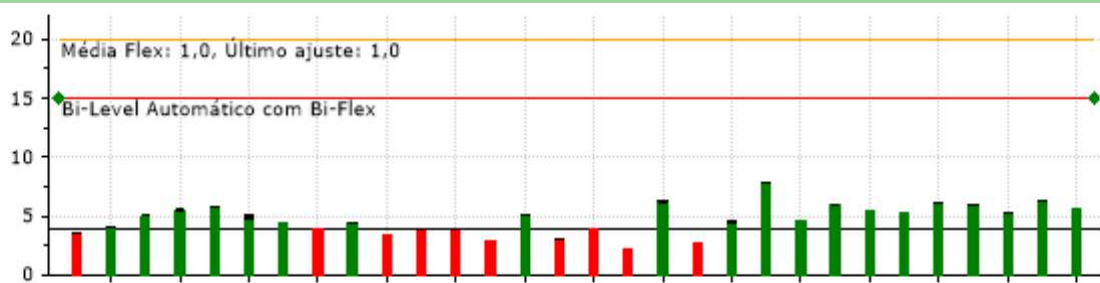

Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

