


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/09/2025 - 10/09/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		6 dias (86%)
< 4 horas		1 dias (14%)
Horas de utilização		42 horas 48 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 7 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 7 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 0 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/09/2025)		2,793 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191678992
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 8.2	
Fugas — l/min	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 26.4	Máximo: 97.0	
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.3	IAH: 1.8	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.3	
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

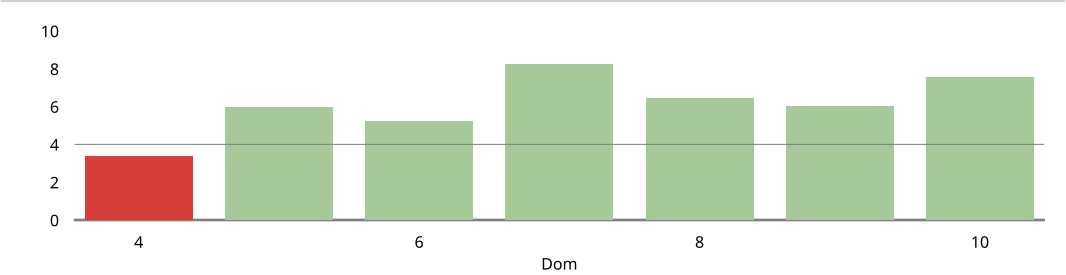


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191678992


Utilização (horas)

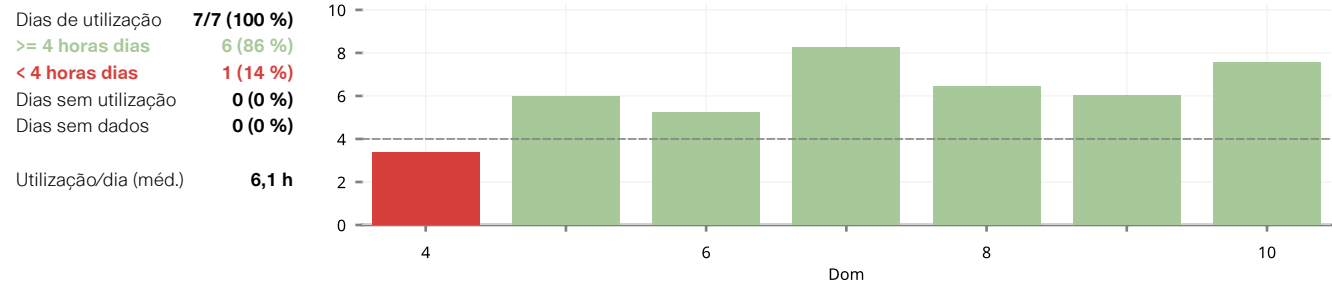

Fuga (l/min)

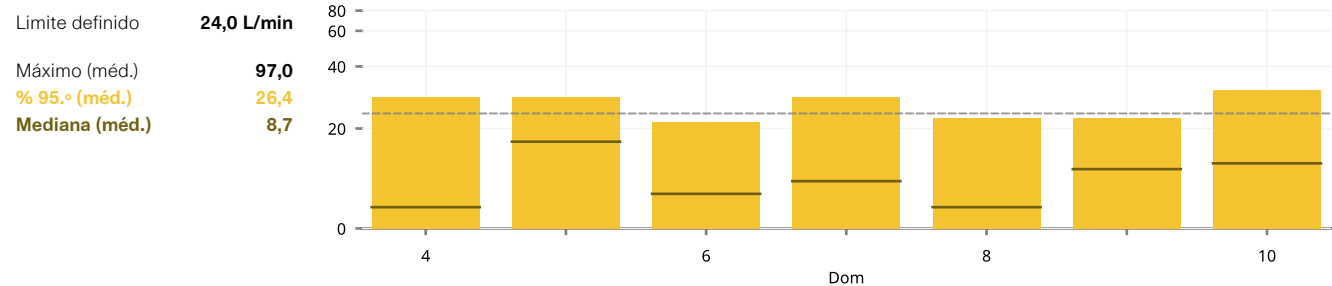

Pressão (cmH2O)

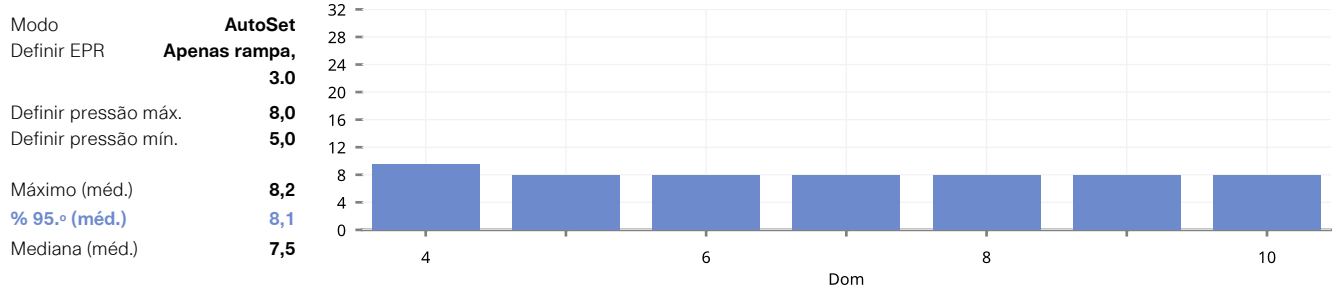

IAH (eventos/hora)

