


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	225 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)	12,116 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191740867
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	8.3	Percentil 95.º:	8.9	Máximo:	9.0
Fugas — l/min	Mediana:	0.0	Percentil 95.º:	2.3	Máximo:	28.6
Eventos por hora	IA:	1.4	IH:	0.8	IAH:	2.2
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	1.0	Desconhecid	0.2
Índice RERA						1.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

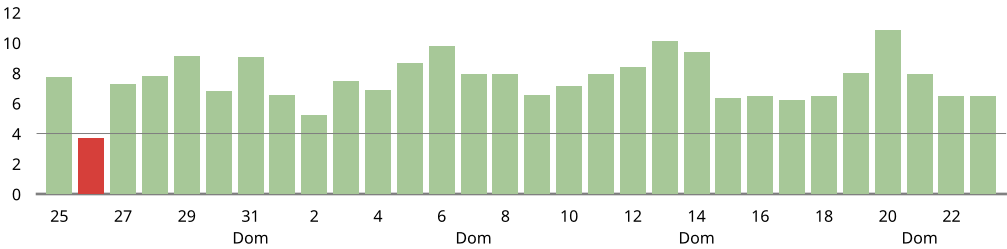


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191740867


Utilização (horas)

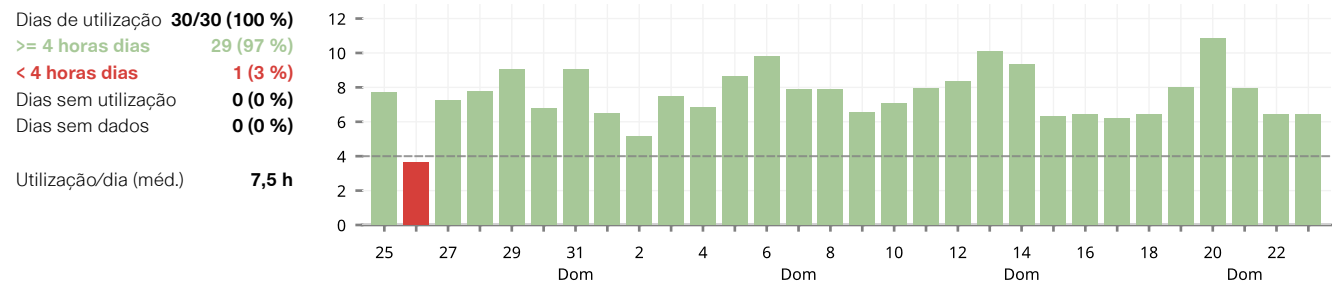

Fuga (l/min)

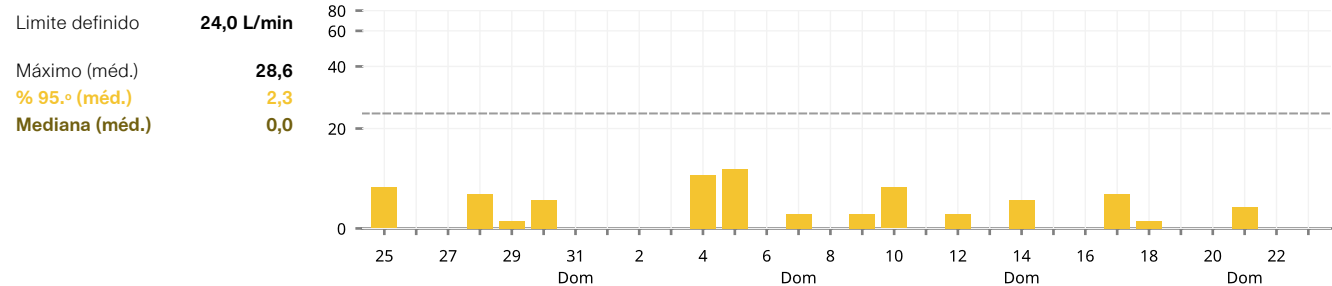

Pressão (cmH2O)

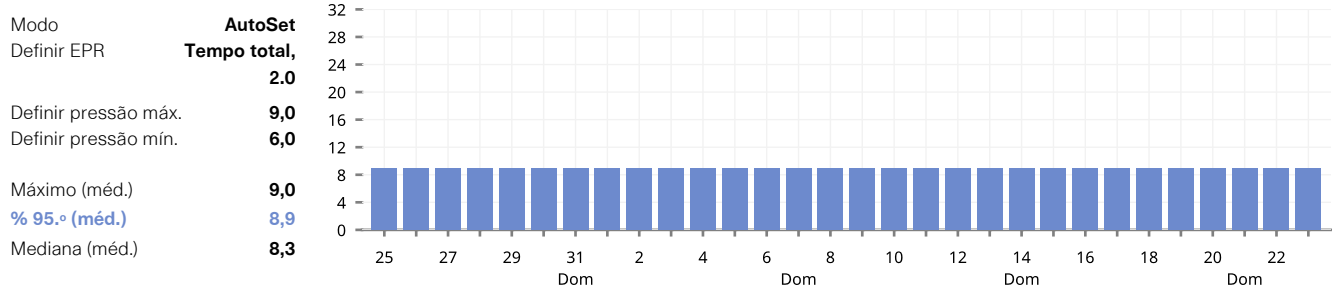

IAH (eventos/hora)

