


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/10/2025 - 23/11/2025
Dias de utilização	22/30 dias (73%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	134 horas 16 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 6 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 28 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/11/2025)	270 horas	

AirCurve 10 VAuto	
Número de série	22201596263
Modo	VAuto
IPAP máx.	14 cmH2O
EPAP mín.	8 cmH2O
Pressão de suporte	6 cmH2O

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 17.5	Percentil 95.º: 39.2	Máximo: 59.3	
Eventos por hora	IA: 4.7	IH: 0.1	IAH: 4.8	
Índice de apneia	Central: 2.1	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid	0.9

Horas de utilização

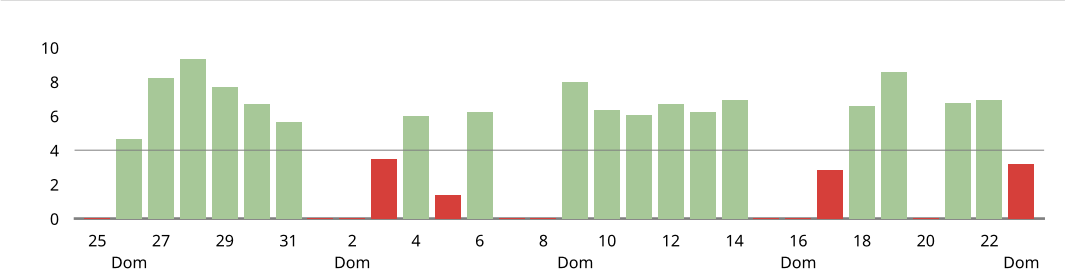


Relatório de terapia


AirCurve 10 VAuto

NS: 22201596263


Utilização (horas)

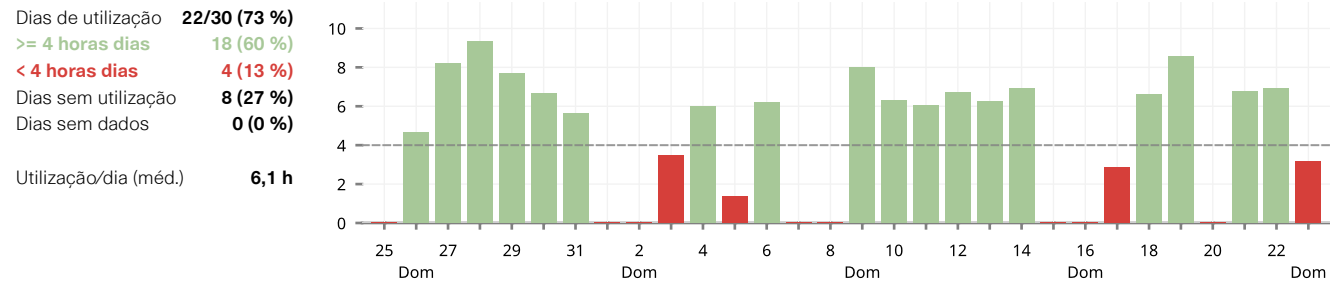


Fuga (l/min)

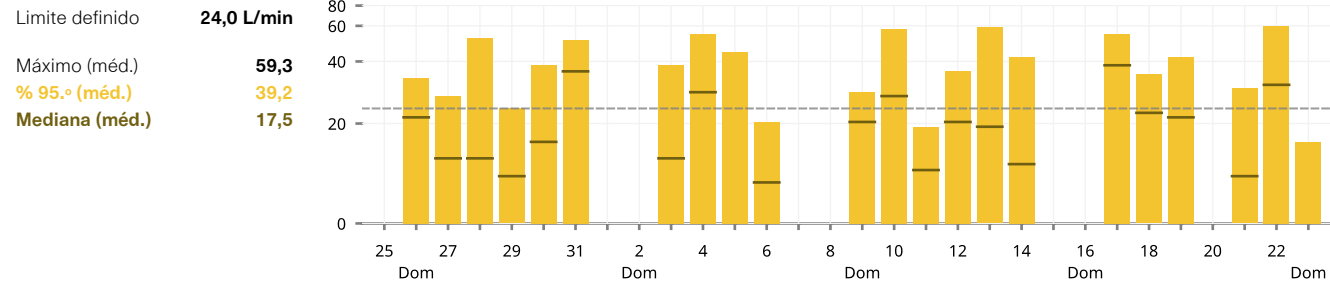

Pressão (cmH2O)

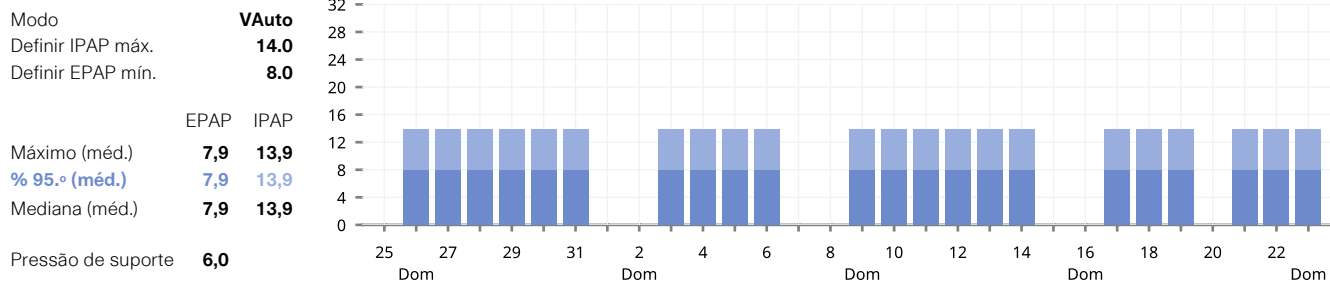

IAH (eventos/hora)

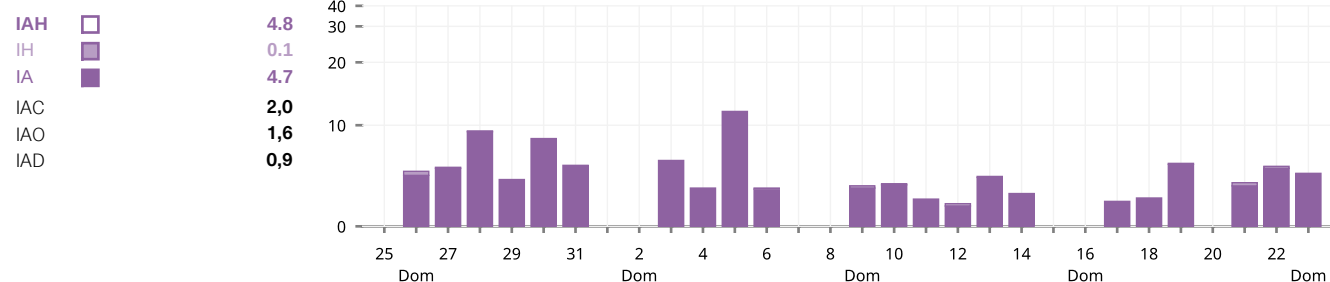


Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22201596263

Volume corrente (ml)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

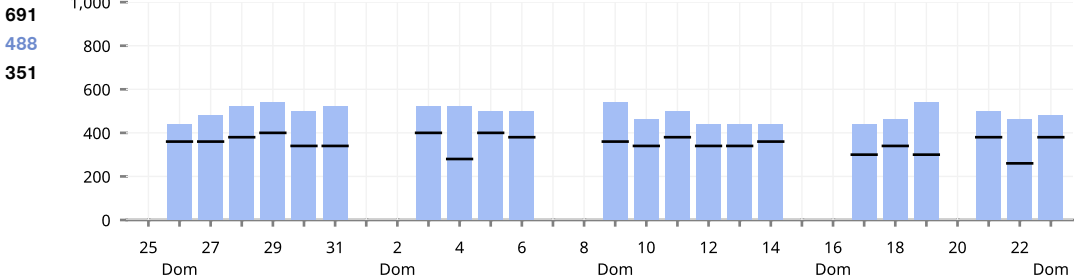


Frequência respiratória (respirações/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)


Respirações espontâneas

Ciclado

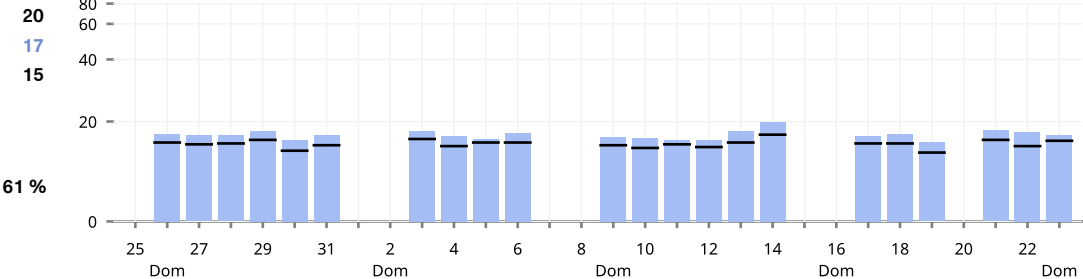

Ventilação por minuto (l/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

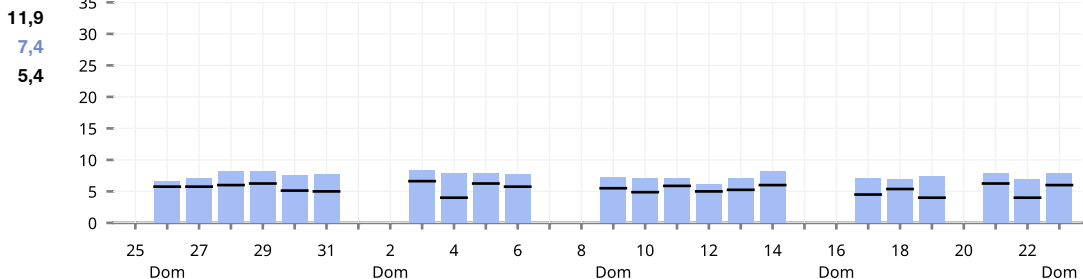

Relação I:E (mediana em %)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

%E
%I

