


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/12/2025 - 25/01/2026
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	24 dias (80%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	180 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/01/2026)	573 horas	

AirCurve 10 VAuto	
Número de série	22201596263
Modo	VAuto
IPAP máx.	14 cmH2O
EPAP mín.	8 cmH2O
Pressão de suporte	6 cmH2O

Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 14.3	Percentil 95.º: 36.9	Máximo: 47.1
Eventos por hora	IA: 5.1	IH: 0.1	IAH: 5.2
Índice de apneia	Central: 3.3	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid 0.4

Horas de utilização

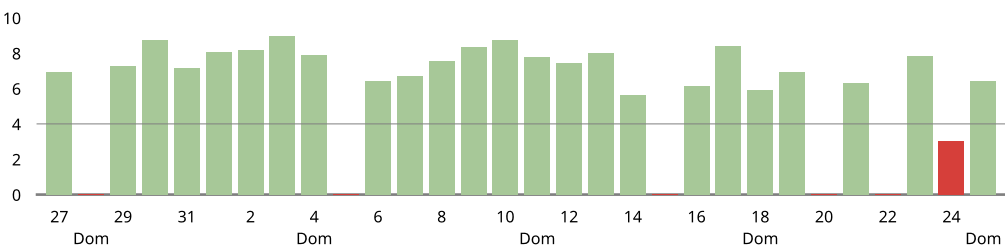


Relatório de terapia


AirCurve 10 VAuto

NS: 22201596263


Utilização (horas)

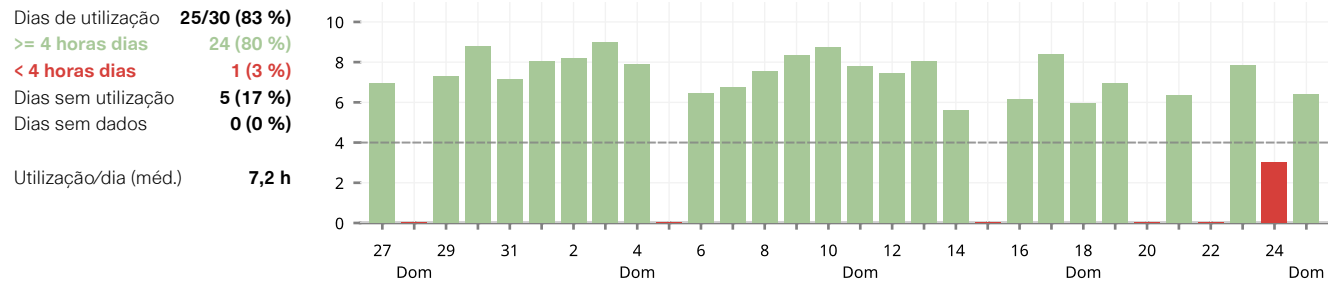

Fuga (l/min)

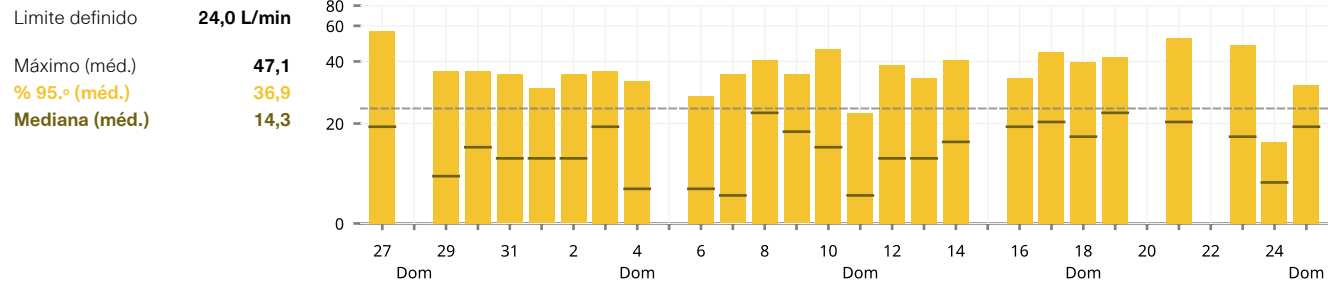

Pressão (cmH2O)

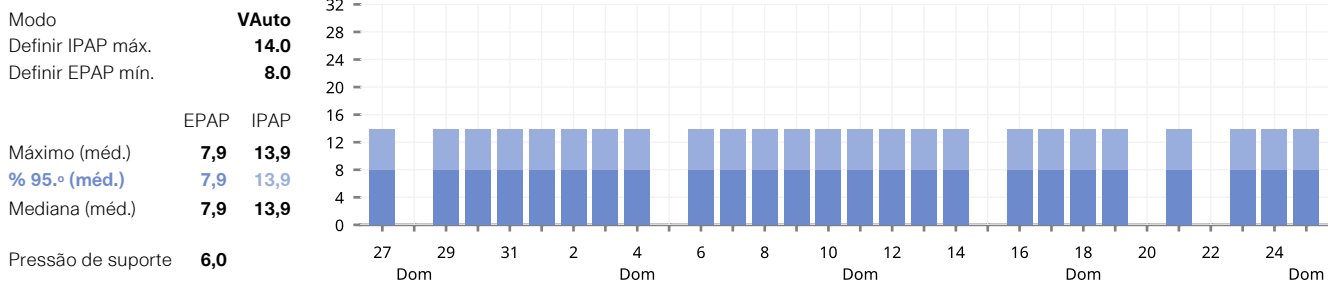


Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22201596263

Volume corrente (ml)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

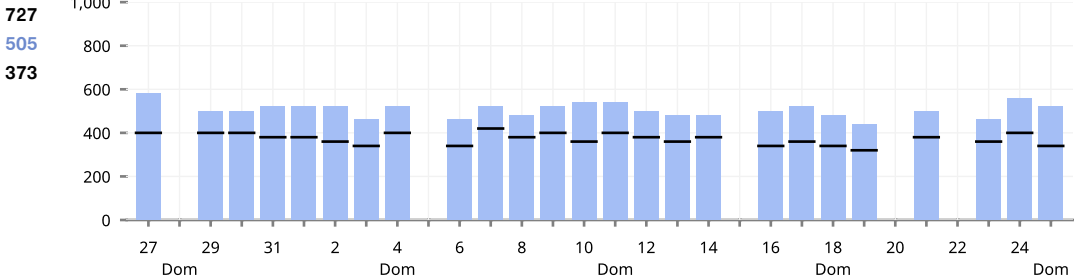


Frequência respiratória (respirações/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)


Respirações espontâneas

Ciclado

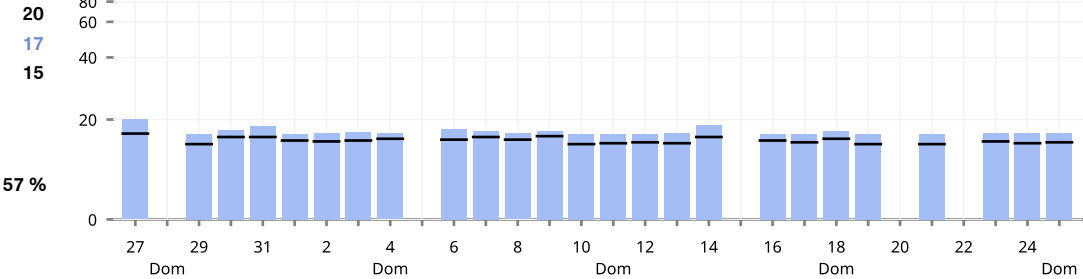

Ventilação por minuto (l/min)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

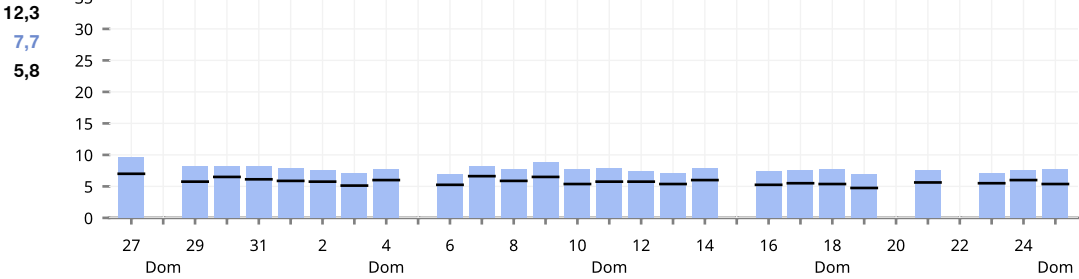

Relação I:E (mediana em %)

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

%E
%I

