


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/09/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	40 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 53 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)	171 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881530
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.6	
Fugas — l/min	Mediana: 23.7	Percentil 95.º: 32.4	Máximo: 48.9	
Eventos por hora	IA: 4.7	IH: 1.2	IAH: 5.9	
Índice de apneia	Central: 2.5	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	1.5
Índice RERA	1.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	3 minutos (1%)			

Horas de utilização

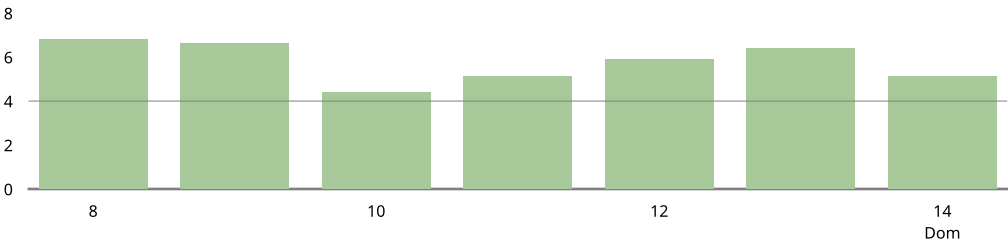


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881530


Utilização (horas)

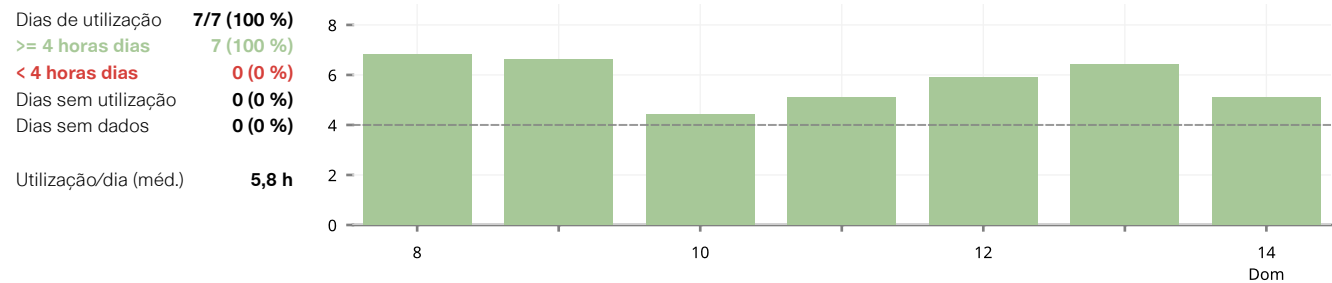

Fuga (l/min)

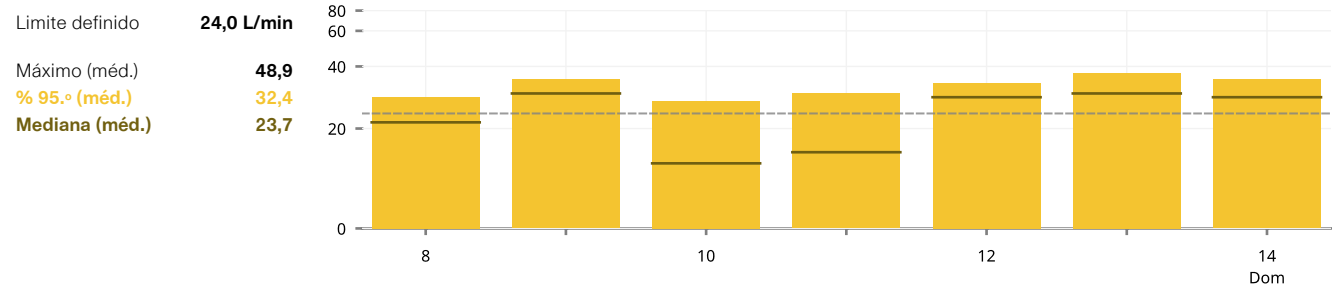

Pressão (cmH2O)

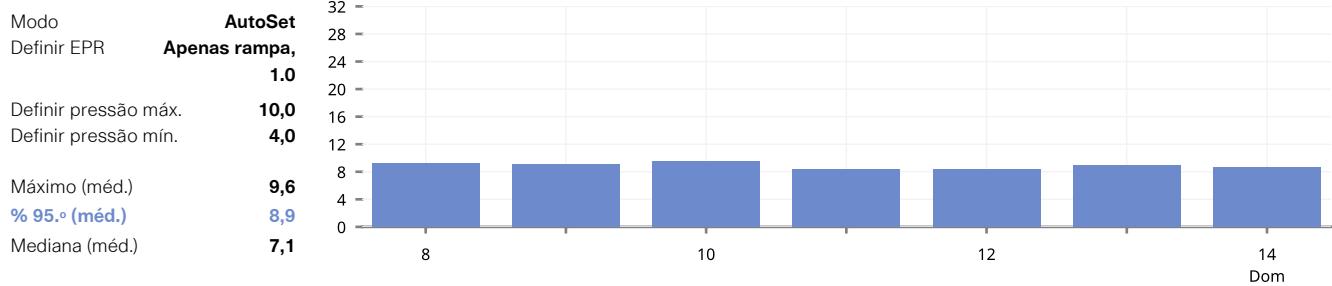

IAH (eventos/hora)

