


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/09/2025 - 27/09/2025
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	35 horas 7 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/09/2025)	5,486 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549748
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 8.4	Máximo: 8.6	
Fugas — l/min	Mediana: 14.9	Percentil 95.º: 36.5	Máximo: 51.6	
Eventos por hora	IA: 2.8	IH: 0.0	IAH: 2.8	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 2.2	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

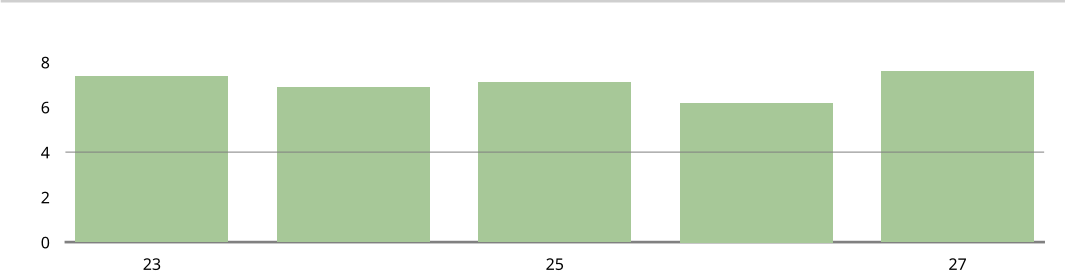


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748


Utilização (horas)

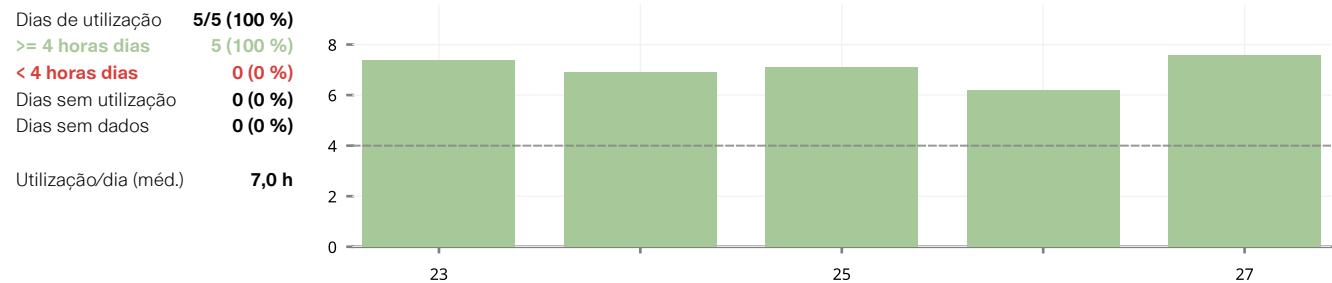

Fuga (l/min)

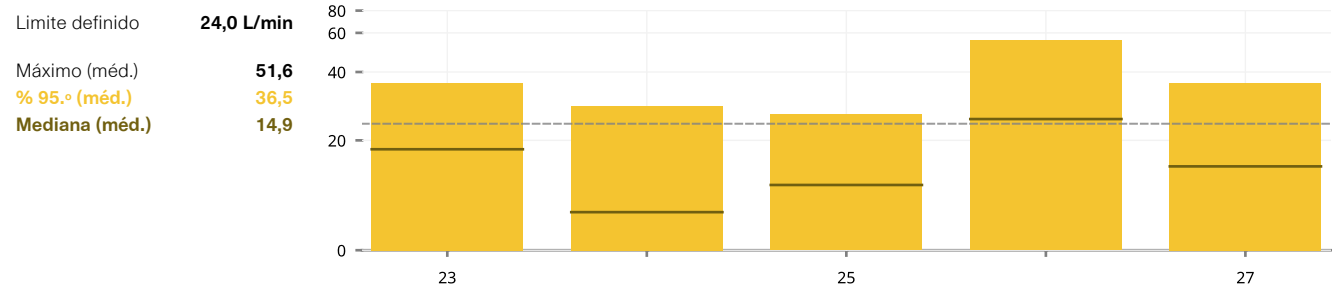

Pressão (cmH2O)

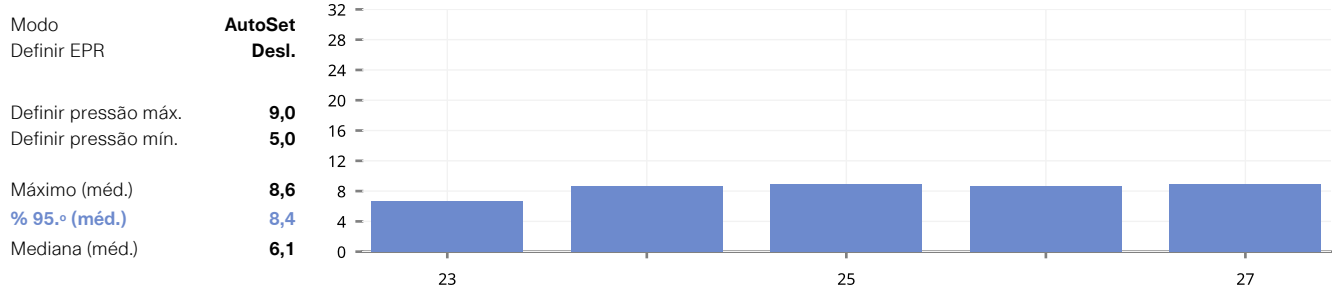

IAH (eventos/hora)

