


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/09/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização		6/7 dias (86%)
>= 4 horas		6 dias (86%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		45 horas 17 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 28 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 33 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 47 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)		1,377 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.1	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.0	
Fugas — l/min	Mediana: 4.8	Percentil 95.º: 28.4	Máximo: 78.8	
Eventos por hora	IA: 4.0	IH: 0.1	IAH: 4.1	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 2.4	Desconhecid	1.4
Índice RERA				0.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

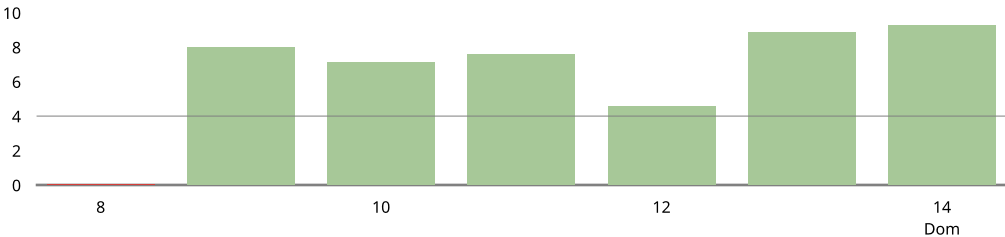

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)

Dias de utilização
>= 4 horas dias
< 4 horas dias
Dias sem utilização
Dias sem dados

Utilização/dia (méd.)

6/7 (86 %)
6 (86 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (14 %)

7,5 h

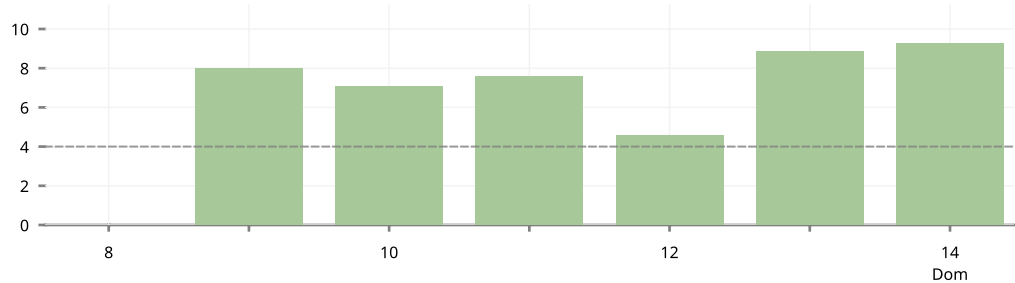


Fuga (l/min)

Limite definido

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

24,0 L/min

78,8
28,4
4,8

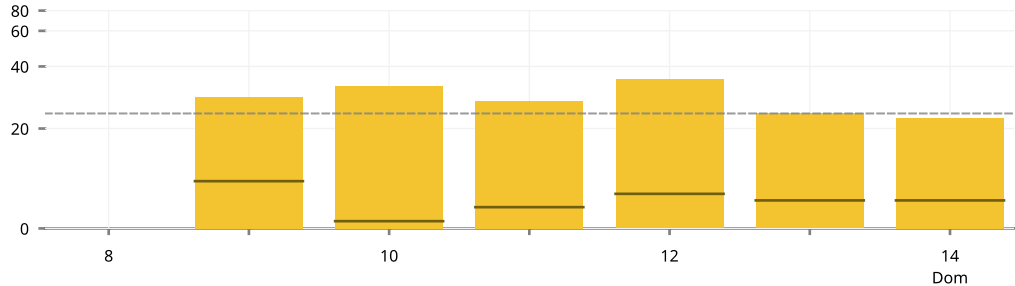

Pressão (cmH2O)

Modo
Definir EPR


Definir pressão máx.
Definir pressão mín.

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

AutoSet
Apenas rampa,
1.0

9,0
6,0

9,0
8,9
8,1

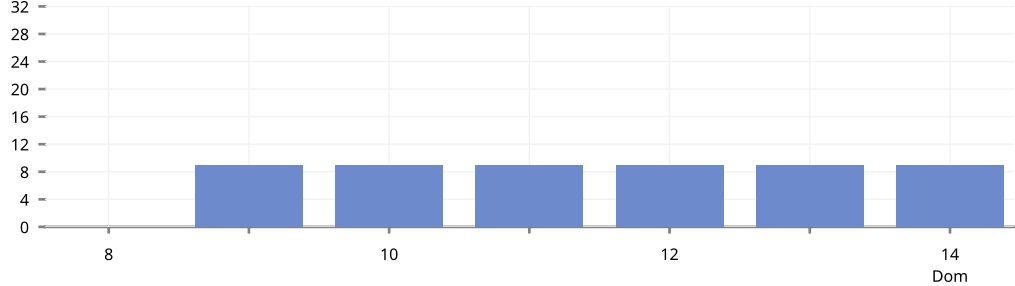

IAH (eventos/hora)

IAH
IH
IA
IAC
IAO
IAD
RERA
%RCS (méd.)

4.1
0.1
4.0
0.2
2.4
1.4
0.4
0.0

