

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 04 nov 1949

Sexo: —

Médico: —

Telefone: —

Média de IAHL: **1,2**

Média de Utilização (h:min): **5:44**

Adesão Tto.*: **77 %**

* Últimos 30 Dias

% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 11 out 2025

EQUIPAMENTOS

EM 09 nov 2025

Modelo: SleepStyle Auto

Nº de Série: 201132T8B

Modo: Auto

Pressão Mín. Ajustada: 6,0 cmH₂O

Pressão Máx. Ajustada: 9,0 cmH₂O

Umidif.: 4,0

Alívio Expiratório: 2 cmH₂O

SensAwake: Desligado



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS

11 out 2025 - 09 nov 2025

INÍCIO DA TERAPIA

05 out 2021 - 09 nov 2025

Total de Dias:

Utilização: 28 (93 %)

Utilização ≥ 4 horas: 23 (77 %)

Não Utilizado: 2 (7 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia): 6:09

Média de Utilização (Todos os Dias): 5:44

Total Func.: 172:12

7:18

4:58

7438:06

EFICÁCIA**

IAH: 1,2

Pressão: 6 cmH₂O

Vazamento do Sistema: 22 L/min

Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite

Duração das Apneias: 12 s

Pressão de 90º Percentil: 6,5 cmH₂O

Vazamento no 90º Percentil: 31 L/min

SensAwake Ligado: 0 %

IAC: 0,1

À Pressão Máxima: 0 %

Vazamento Alto: 0 %

AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 23 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 5:44


Dias de Utilização: 93 %

■ Total Func.

■ Total de Utilização

■ Utilização <4 h

..... Umidif.

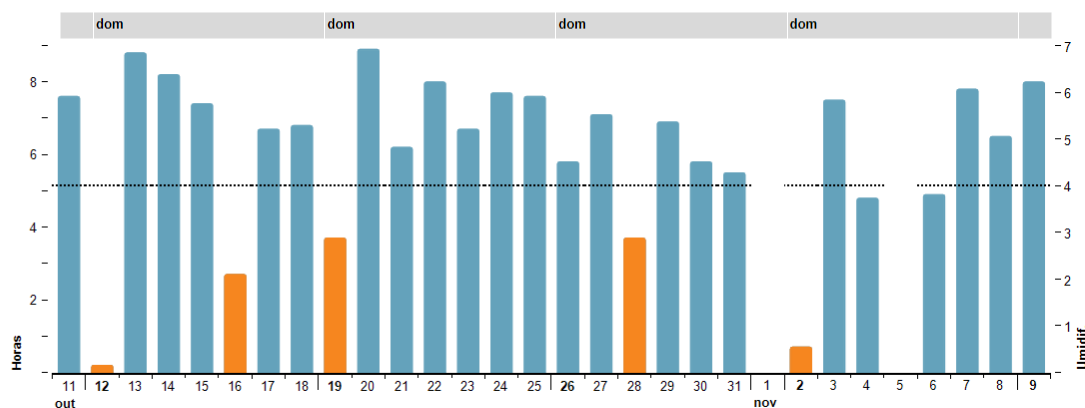

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 1,2
IAC: 0,1
IAO: 0,1
IH: 1,0

IAH Total

IAH = 5

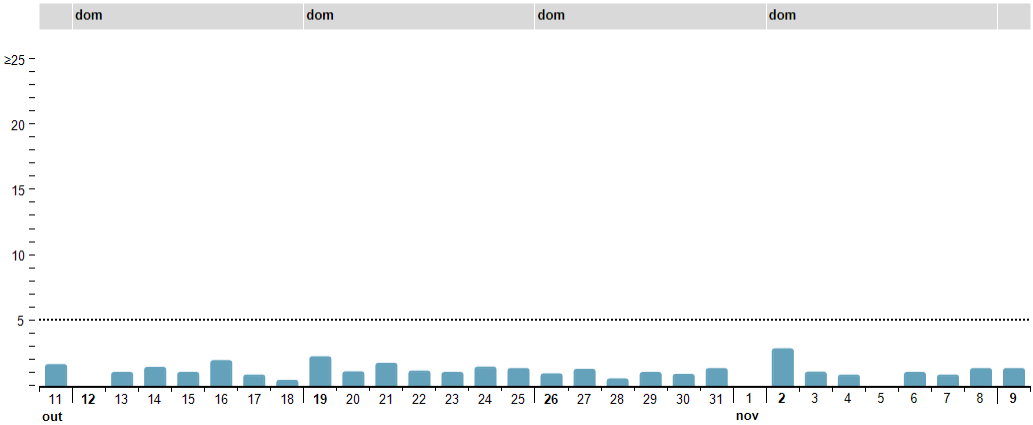

PRESSÃO

cmH₂O


Média: 6,0
90º Percentil: 6,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx

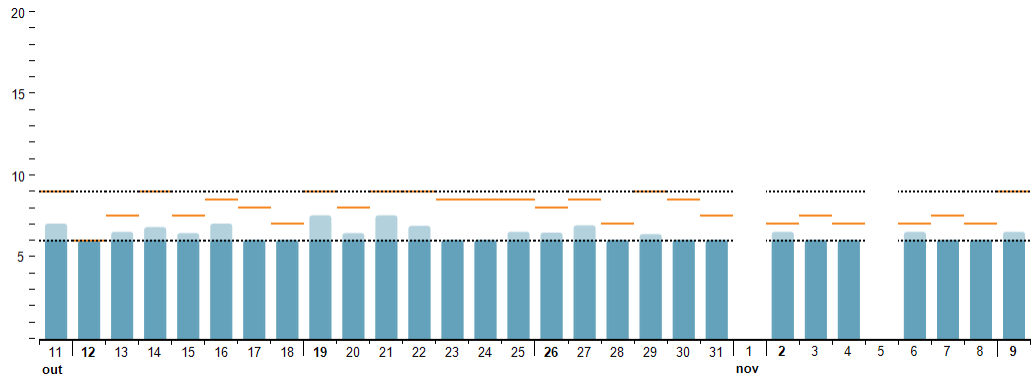

VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 22
90º Percentil: 31

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

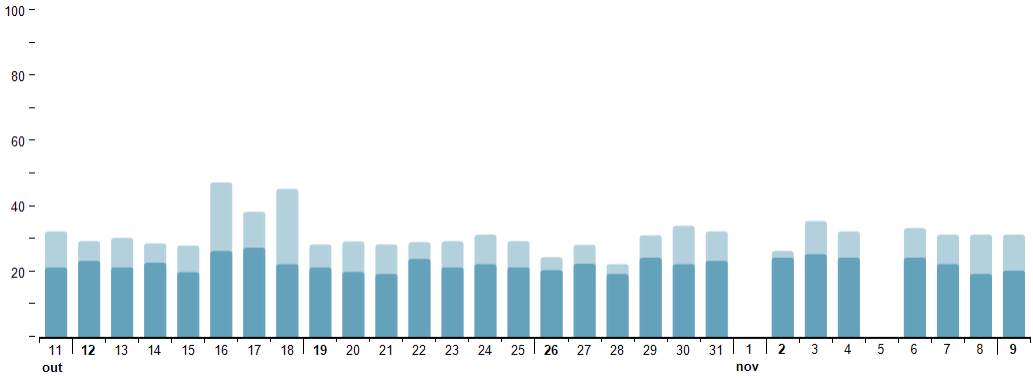

UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 5:44
Dias de Utilização: 93 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h


Umidif.

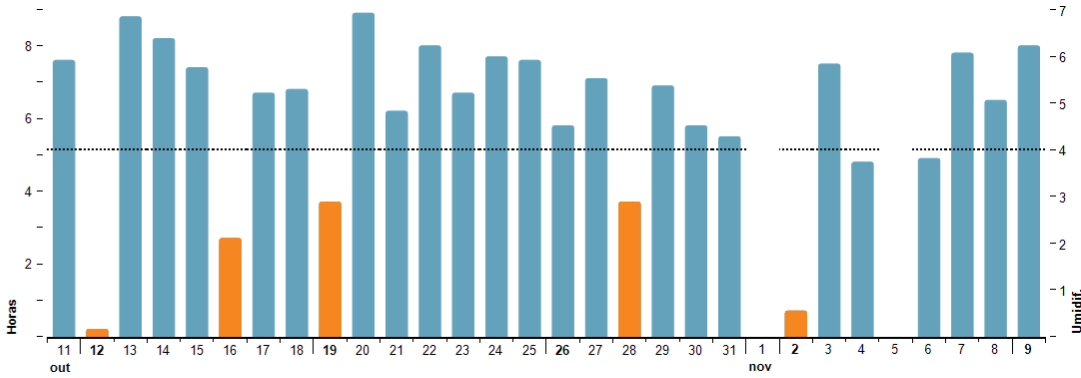

RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: JOSE FREDERICO Carvalho De Bacigalupo Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949 Sexo: —

Histórico de Prescrições

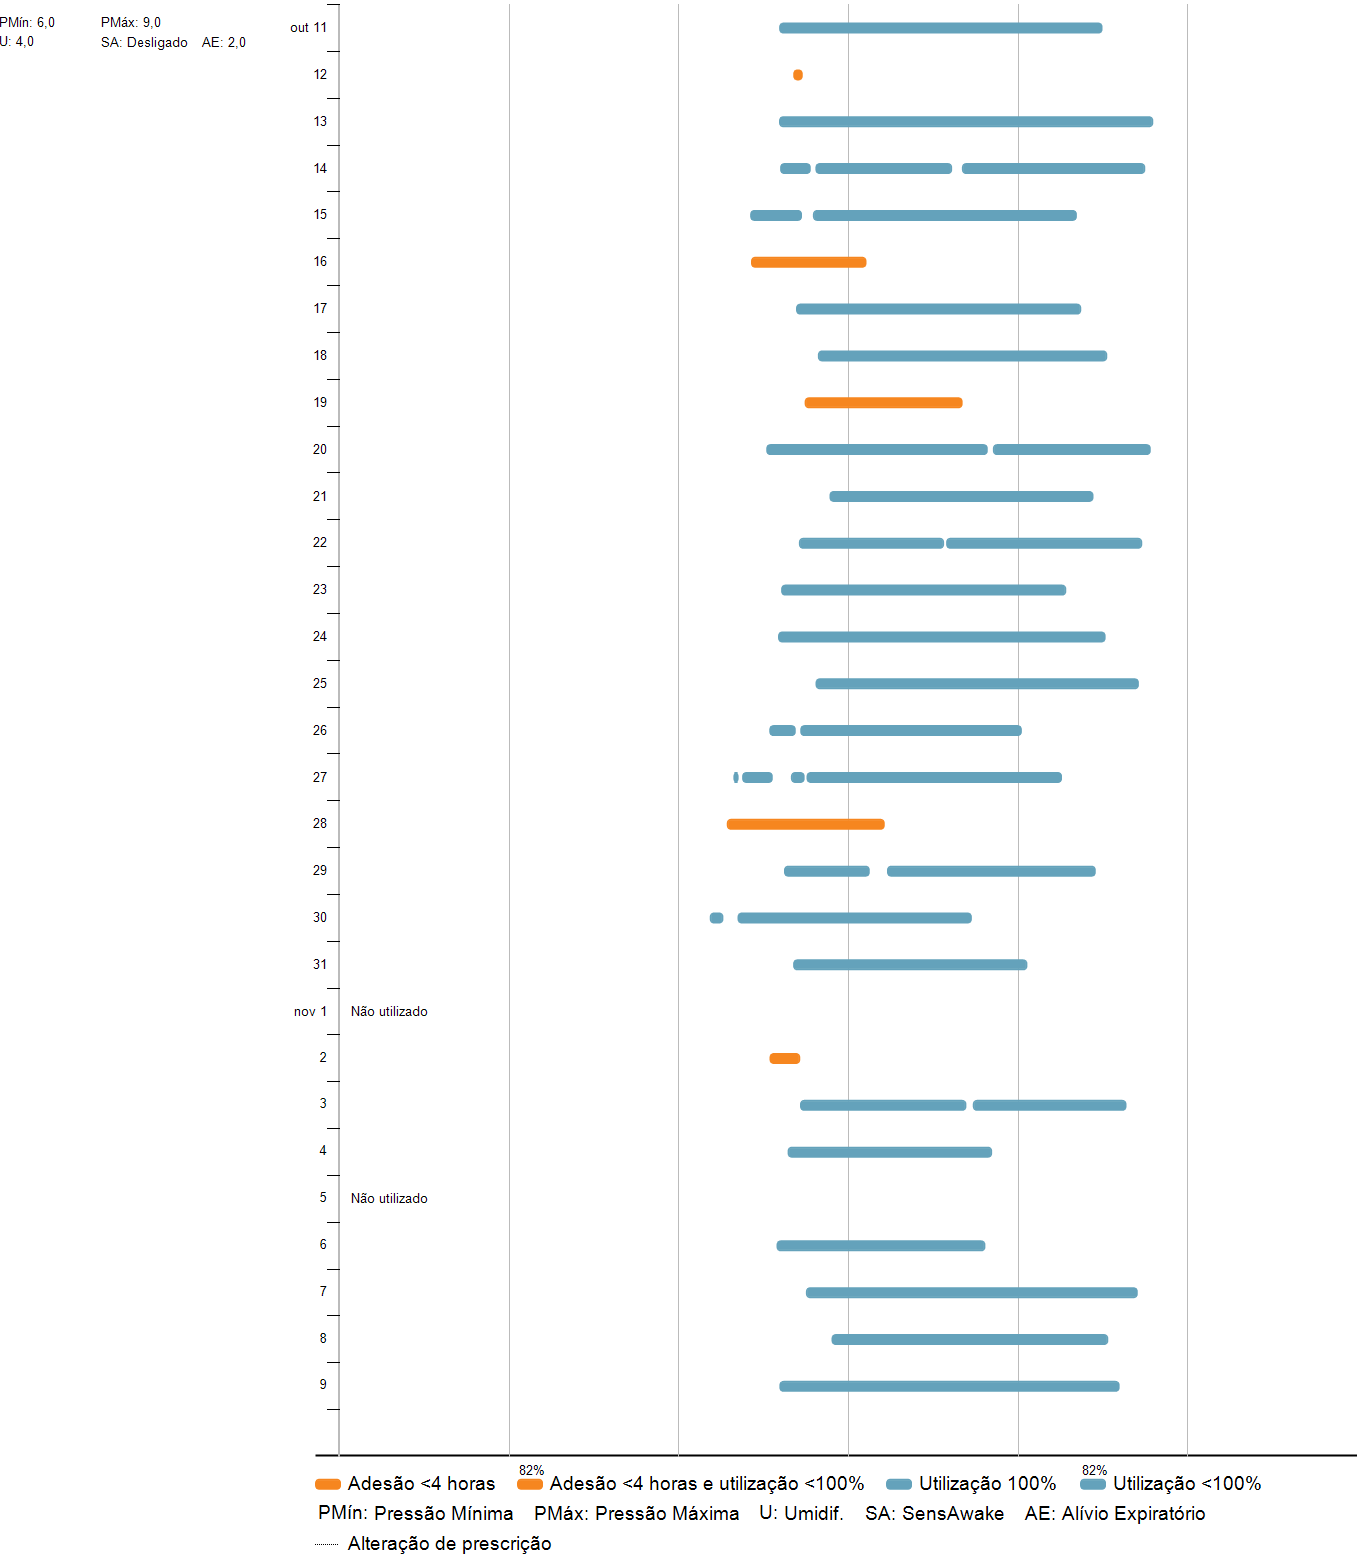

ANÁLISE DE 28 DIAS

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
11 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	1,6	0,3	----	----	2	7,0	9,0	32
12 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	0:12	0:12	0,0	0,0	----	----	2	6,0	6,0	29
13 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:48	8:48	1,0	0,1	----	----	2	6,5	7,5	30
14 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:12	8:12	1,4	0,3	----	----	2	7,0	9,0	28
15 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:24	7:24	1,0	0,0	----	----	2	6,5	7,5	28
16 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	2:42	2:42	1,9	0,4	----	----	2	7,0	8,5	47
17 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:42	6:42	0,8	0,1	----	----	2	6,0	8,0	38
18 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:48	6:48	0,4	0,0	----	----	2	6,0	7,0	45
19 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	3:42	3:42	2,2	0,0	----	----	2	7,5	9,0	28
20 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:54	8:54	1,0	0,1	----	----	2	6,5	8,0	29
21 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:12	6:12	1,7	0,0	----	----	2	7,5	9,0	28
22 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:00	8:00	1,1	0,1	----	----	2	7,0	9,0	29
23 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:42	6:42	1,0	0,0	----	----	2	6,0	8,5	29
24 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:42	7:42	1,4	0,3	----	----	2	6,0	8,5	31
25 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	1,3	0,0	----	----	2	6,5	8,5	29
26 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:48	5:48	0,9	0,0	----	----	2	6,5	8,0	24
27 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:06	7:06	1,2	0,0	----	----	2	7,0	8,5	28
28 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	3:42	3:42	0,5	0,0	----	----	2	6,0	7,0	22
29 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:54	6:54	1,0	0,1	----	----	2	6,5	9,0	31
30 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:48	5:48	0,9	0,0	----	----	2	6,0	8,5	34
31 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:30	5:30	1,3	0,2	----	----	2	6,0	7,5	32
02 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	0:42	0:42	2,8	0,0	----	----	2	6,5	7,0	26
03 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:30	7:30	1,0	0,3	----	----	2	6,0	7,5	35
04 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:48	4:48	0,8	0,2	----	----	2	6,0	7,0	32
06 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:54	4:54	1,0	0,2	----	----	2	6,5	7,0	33
07 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:48	7:48	0,8	0,1	----	----	2	6,0	7,5	31
08 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:30	6:30	1,3	0,2	----	----	2	6,0	7,0	31
09 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:00	8:00	1,3	0,0	----	----	2	6,5	9,0	31