

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 04 nov 1949

Sexo: —

Médico: —

Telefone: —

Média de IAH: **1,3**

Média de Utilização (h:min): **6:31**

Adesão Tto.*: **90 %**

* Últimos 30 Dias

% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 14 jan 2026

EQUIPAMENTOS

EM 12 fev 2026

Modelo: SleepStyle Auto

Umidif.: 4,0

Nº de Série: 201132T8B

Alívio Expiratório: 2 cmH₂O

Modo: Auto

SensAwake: Desligado

Pressão Mín. Ajustada: 6,0 cmH₂O

Pressão Máx. Ajustada: 9,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS
14 jan 2026 - 12 fev 2026

INÍCIO DA TERAPIA
05 out 2021 - 12 fev 2026

Total de Dias:

Utilização: 28 (93 %)

Utilização ≥ 4 horas: 27 (90 %)

Não Utilizado: 2 (7 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia): 6:58

Média de Utilização (Todos os Dias): 6:31

Total Func.: 195:30

7:16

5:03

8060:06

EFICÁCIA**

IAH: 1,3

Duração das Apneias: 12 s

IAC: 0,1

Pressão: 6 cmH₂O

Pressão de 90º Percentil: 6,5 cmH₂O

À Pressão Máxima: 0 %

Vazamento do Sistema: 23 L/min

Vazamento no 90º Percentil: 33 L/min

Vazamento Alto: 0 %

Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite

SensAwake Ligado: 0 %

AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 25 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 6:31


Dias de Utilização: 93 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.

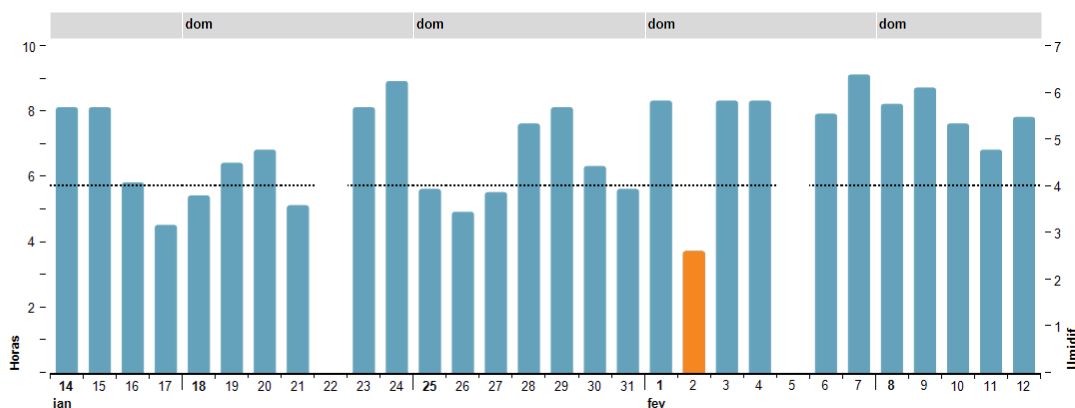

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 04 nov 1949

Sexo: —

IAH

Eventos por hora

IAH: 1,3


IAC: 0,1

IAO: 0,1

IH: 1,1

IAH Total

IAH = 5

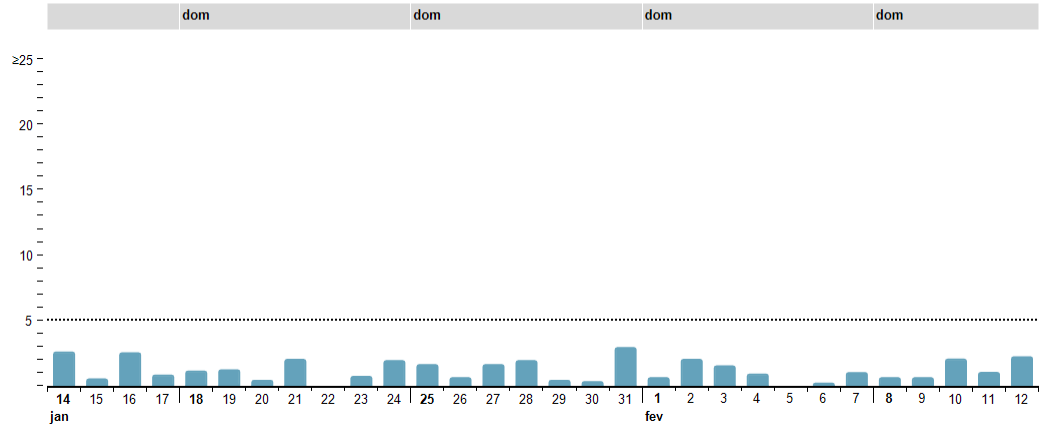

PRESSÃO

cmH₂O

Média: 6,0


90º Percentil: 6,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx

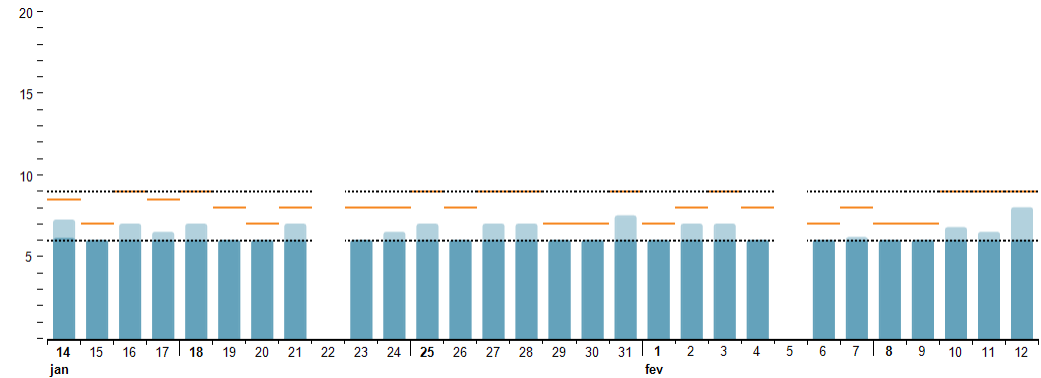

VAZAMENTO SIST.

l/min


Média: 23

90º Percentil: 33

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

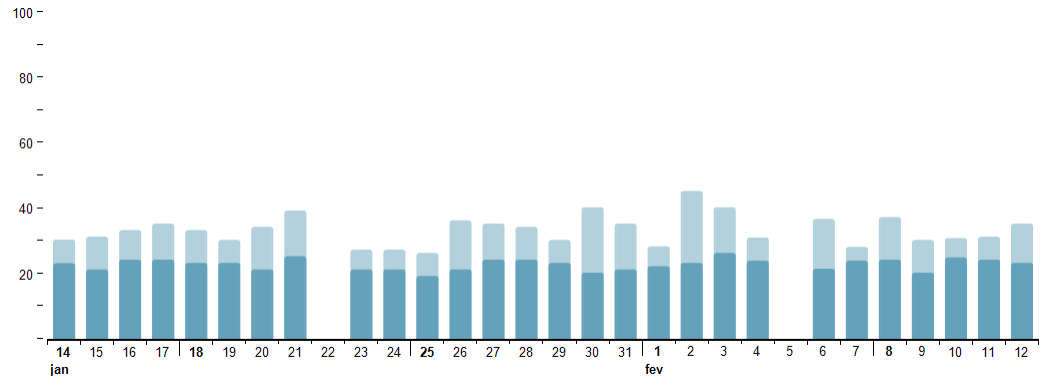

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 6:31


Dias de Utilização: 93 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.

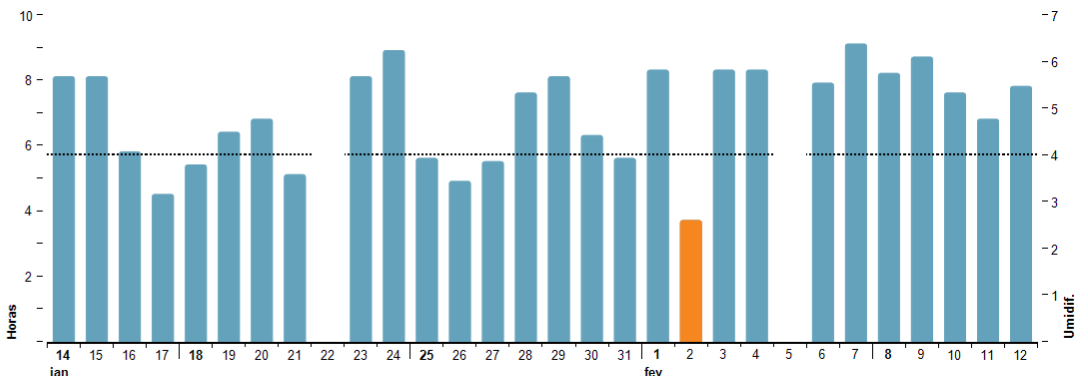


RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: JOSE FREDERICO Carvalho De Bacigalupo Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949 Sexo: —

Histórico de Prescrições

PMín: 6,0 PMáx: 9,0
U: 4,0 SA: Desligado AE: 2,0

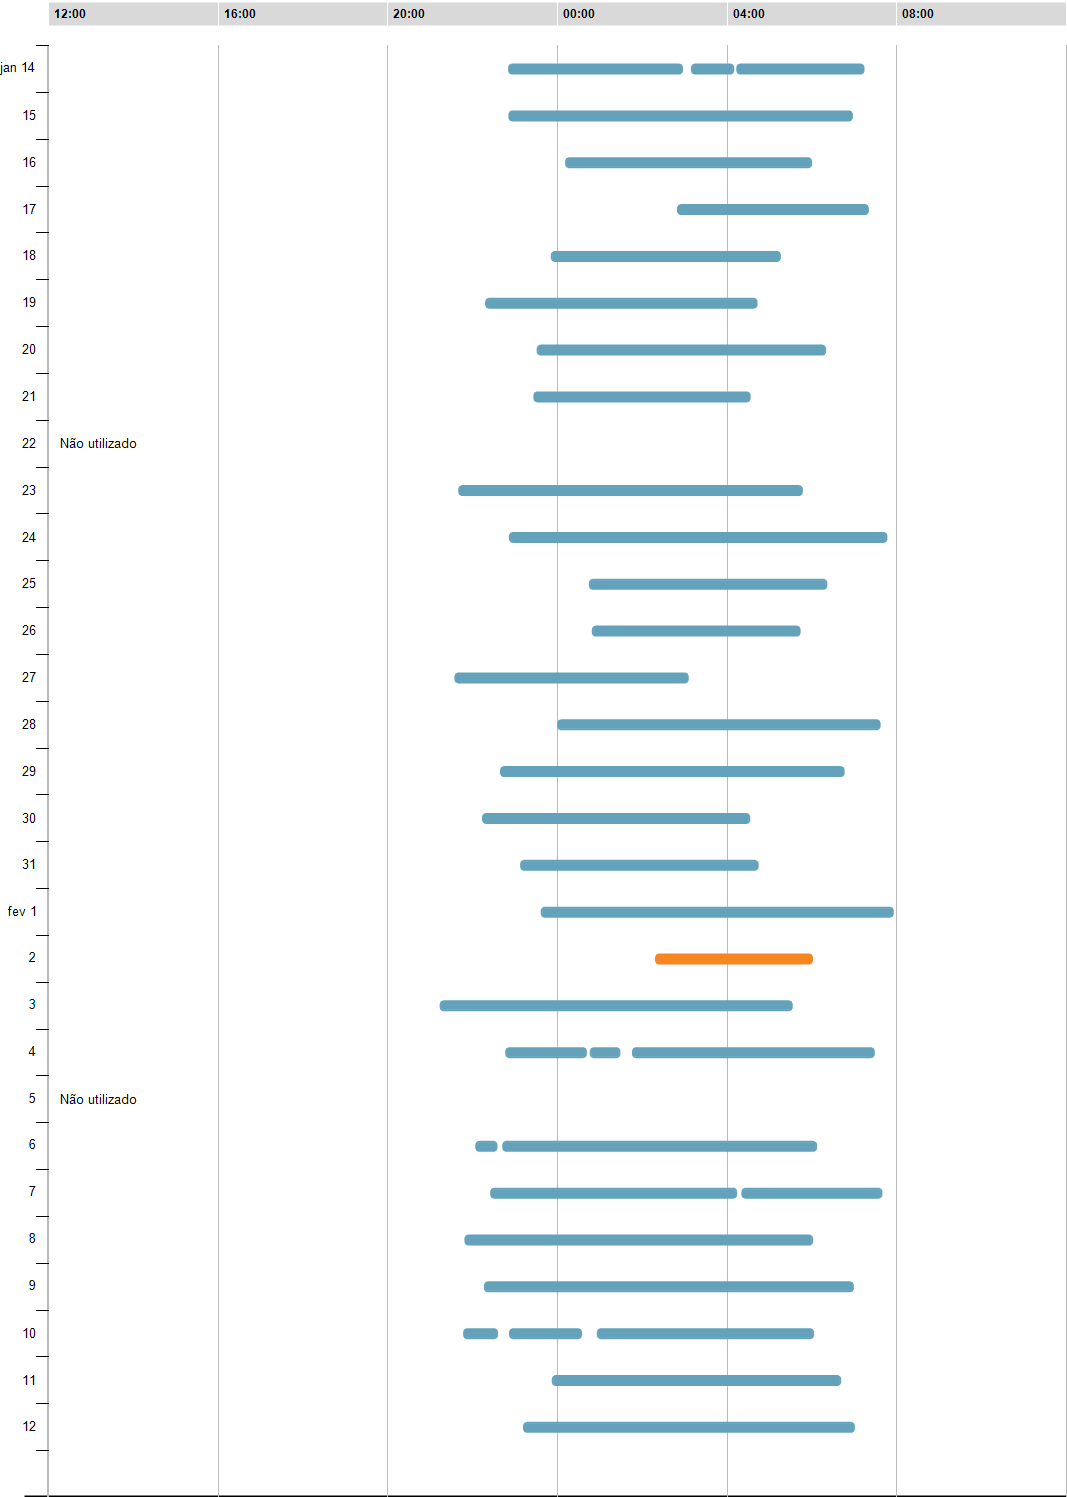

06 fev 2026


sex 06 fev 2026 22:04 -
sáb 07 fev 2026 06:06

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:54
% de Utilização: 100 %

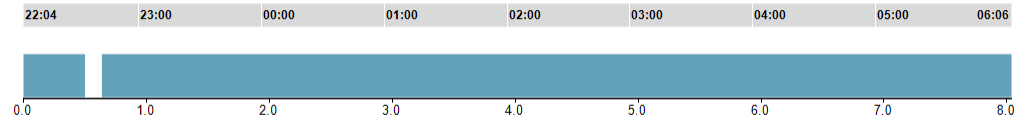

EVENTOS


IAH: 0,2
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 1
IH: 0,1
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

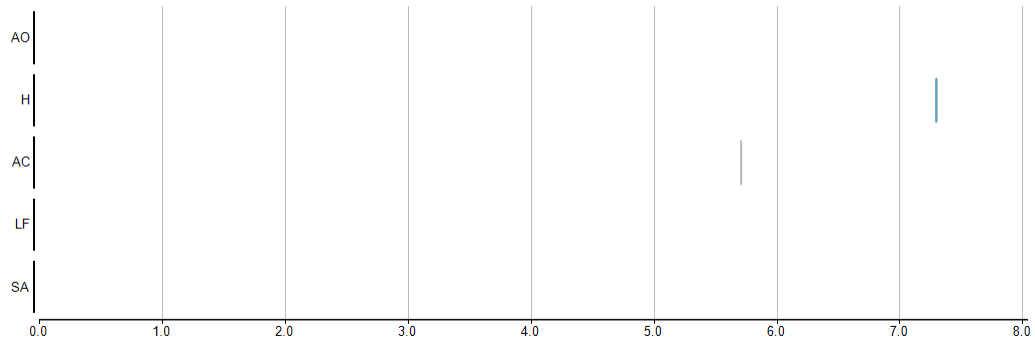

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx

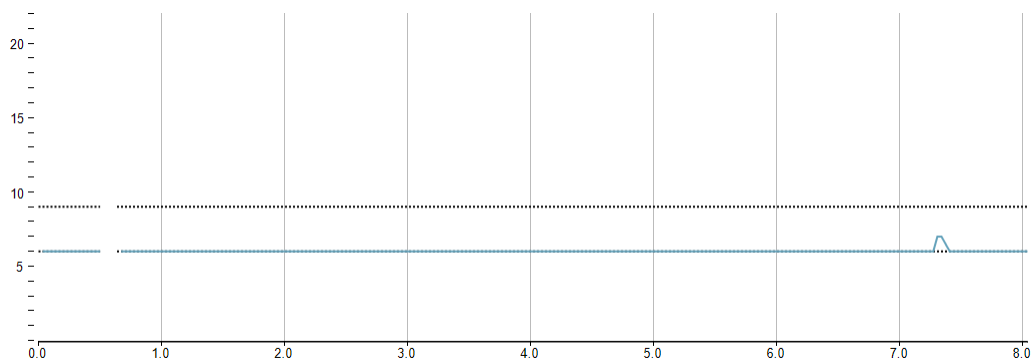

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 22
90° Percentil: 36
Vazamento Alto*: 0 %

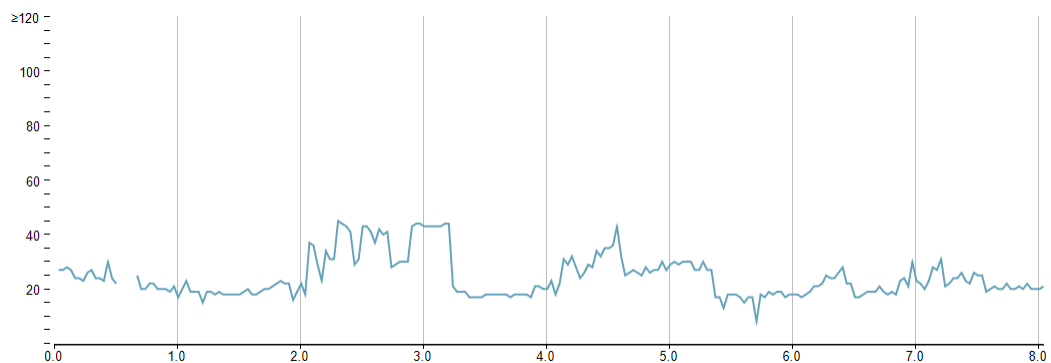

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	468	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07 fev 2026


sáb 07 fev 2026 22:25 -
dom 08 fev 2026 07:38

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 9:06
% de Utilização: 100 %

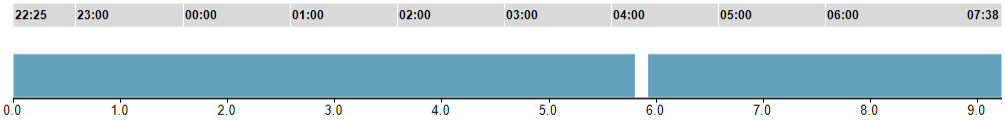

EVENTOS


IAH: 1,0
Apneia obstrutiva: 2
IAO: 0,2
Hipopneias: 6
IH: 0,6
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

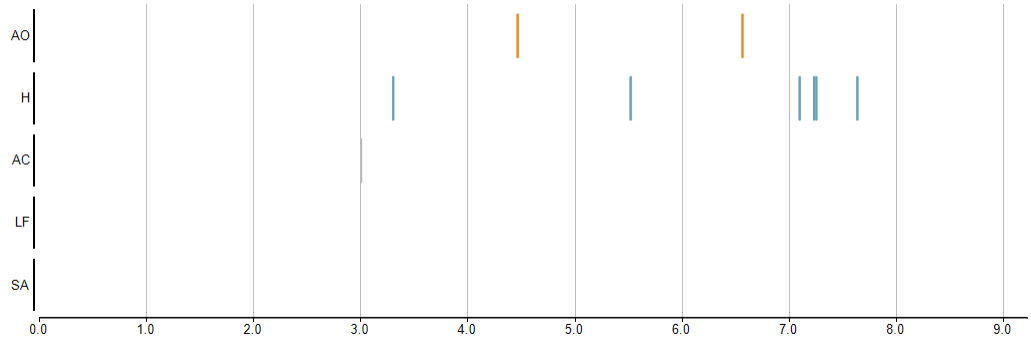

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx

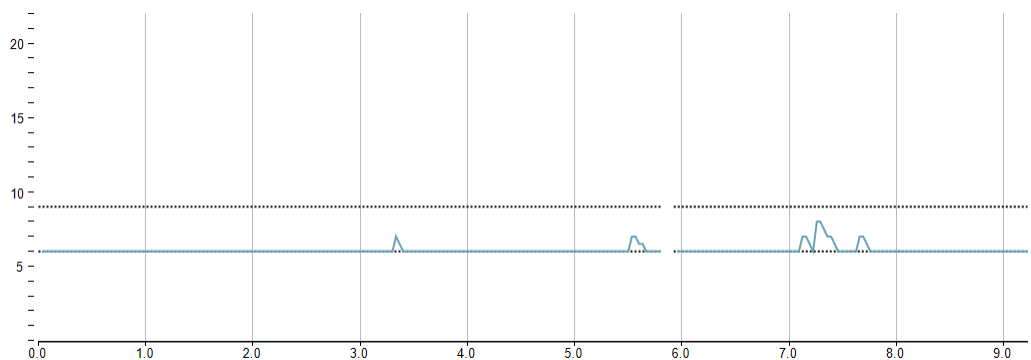

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 23
90° Percentil: 28
Vazamento Alto*: 0 %

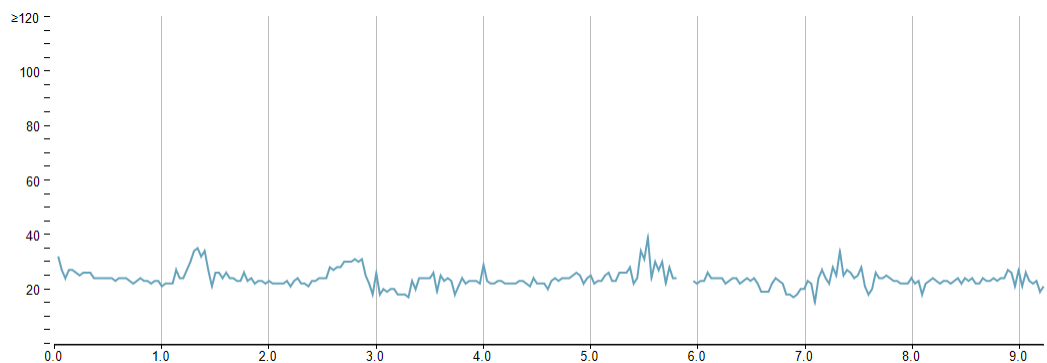

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	510	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 fev 2026


dom 08 fev 2026 21:48 -
seg 09 fev 2026 06:00

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 8:12
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 0,6
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 5
IH: 0,6
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

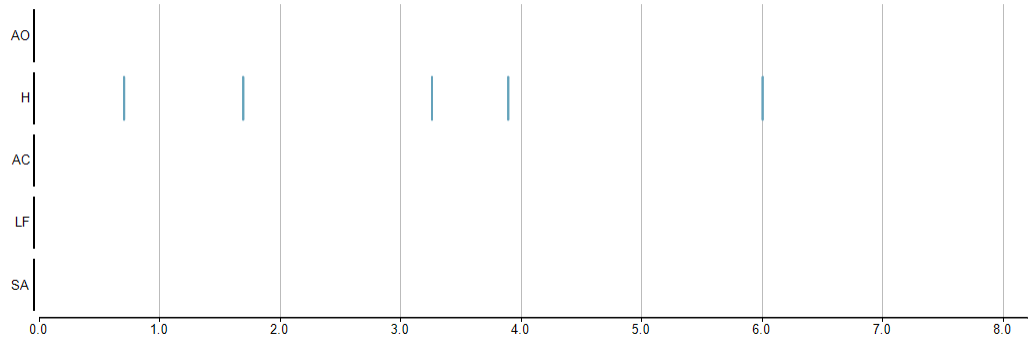

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx

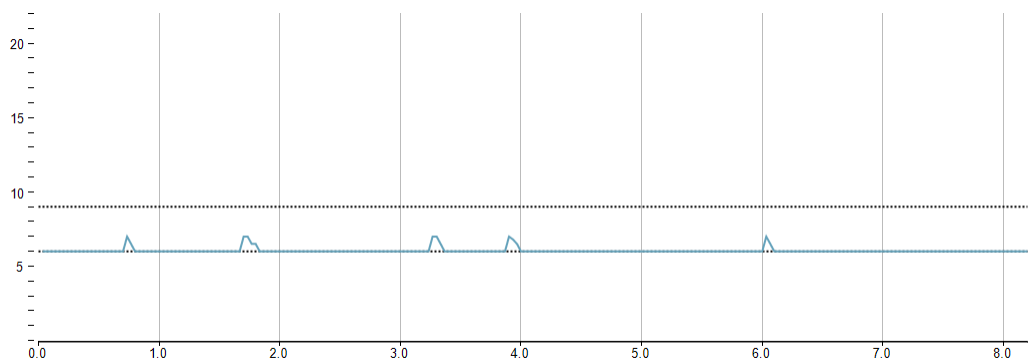

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 24
90° Percentil: 37
Vazamento Alto*: 0 %

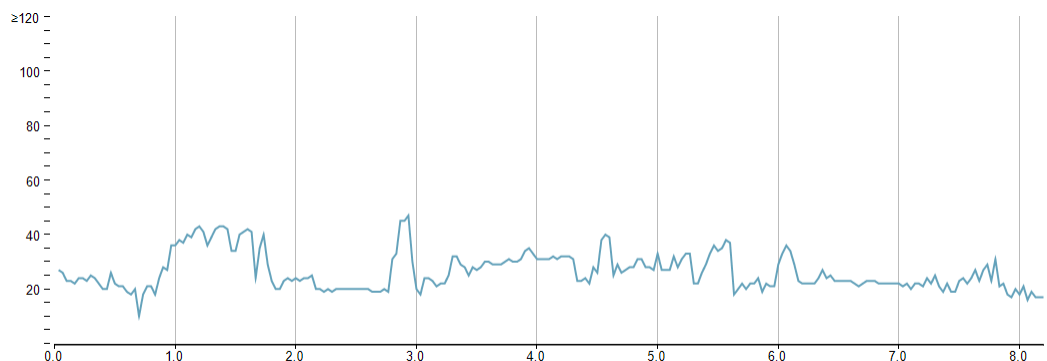

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	464	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 fev 2026


seg 09 fev 2026 22:16 -
ter 10 fev 2026 06:58

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 8:42
% de Utilização: 100 %

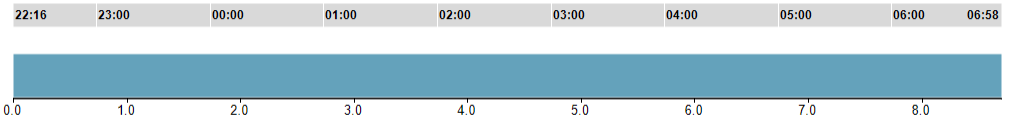

EVENTOS


IAH: 0,6
Apneia obstrutiva: 3
IAO: 0,3
Hipopneias: 2
IH: 0,2
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

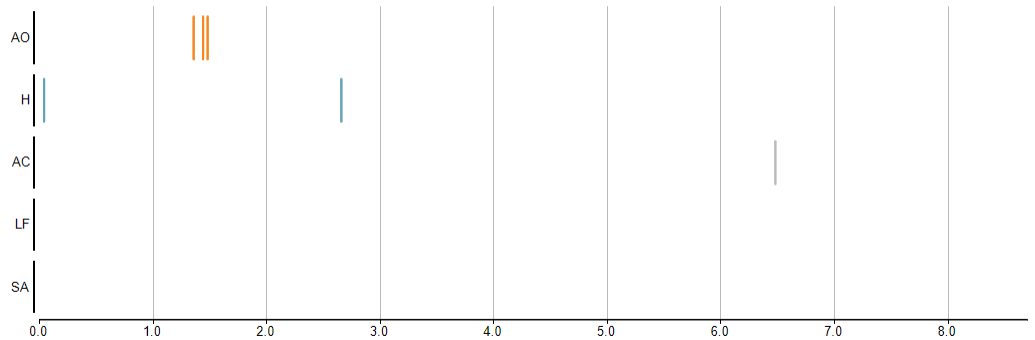

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx

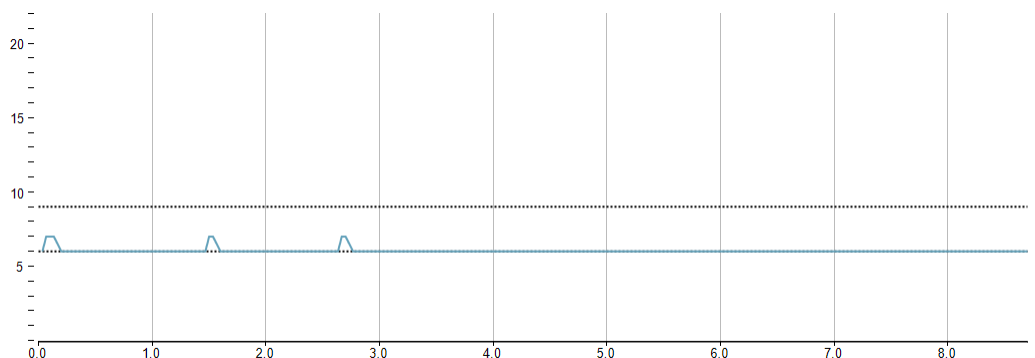

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 20
90° Percentil: 30
Vazamento Alto*: 0 %

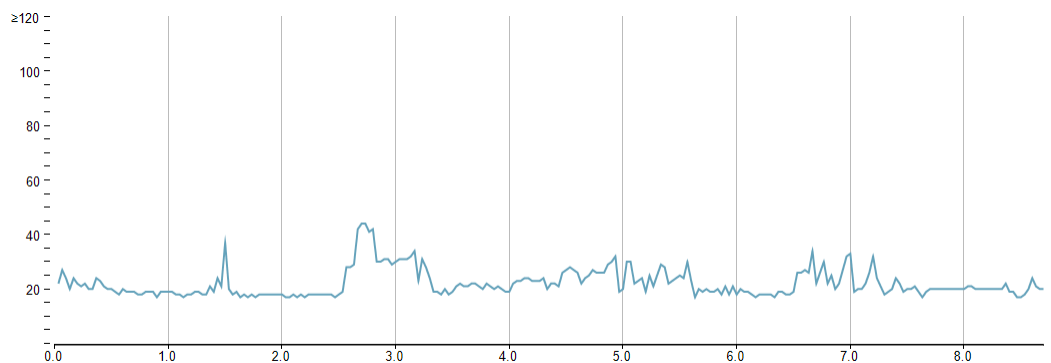

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	502	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 fev 2026


ter 10 fev 2026 21:47 -
qua 11 fev 2026 06:02

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:36
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 2,0
Apneia obstrutiva: 4
IAO: 0,5
Hipopneias: 10
IH: 1,3
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

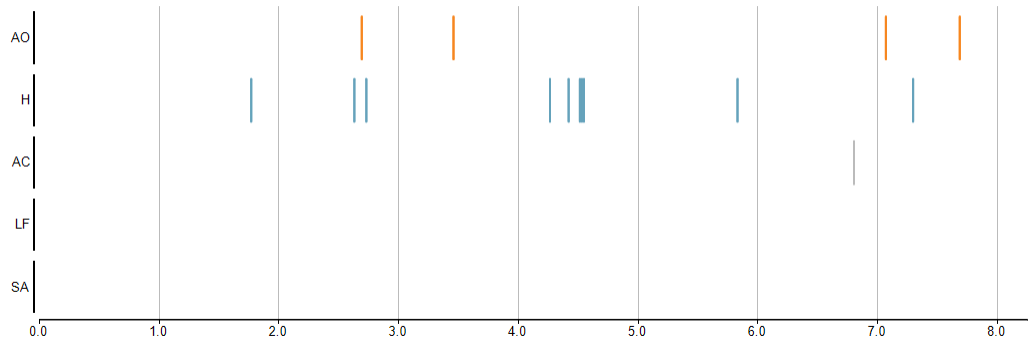

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 7,0
Tempo de Rampa
Min / Máx

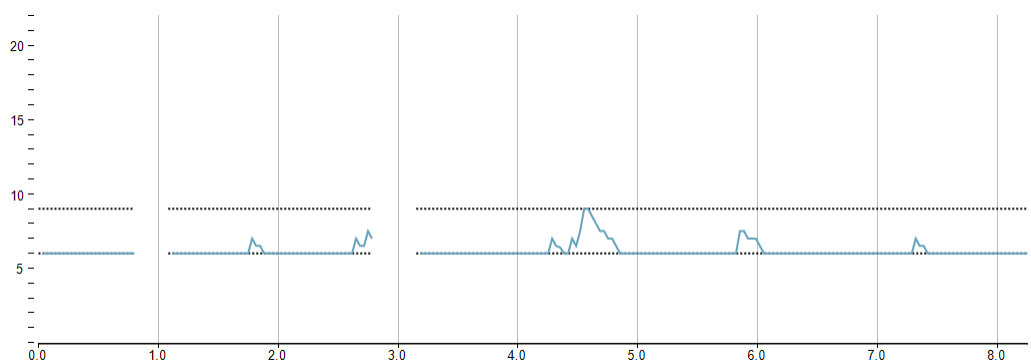

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 25
90° Percentil: 31
Vazamento Alto*: 0 %

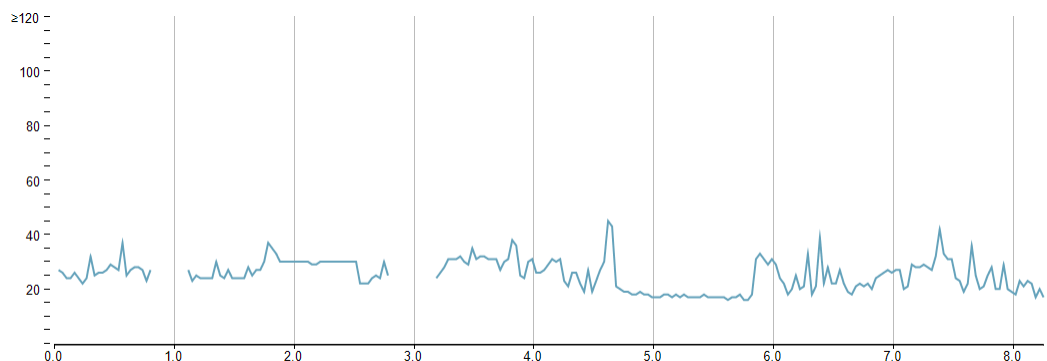

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	394	42	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 fev 2026


qua 11 fev 2026 23:52 -
qui 12 fev 2026 06:40

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 6:48
% de Utilização: 100 %

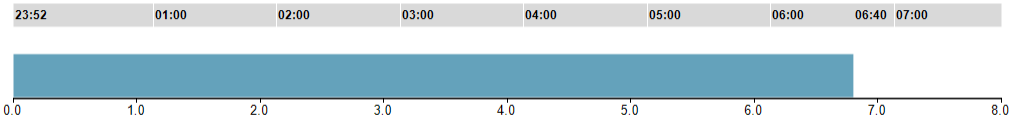

EVENTOS


IAH: 1,0
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 7
IH: 1,0
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

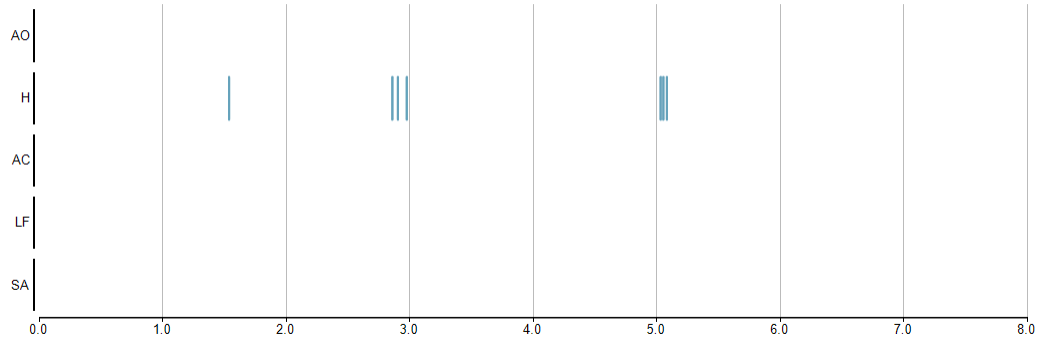

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,5
Tempo de Rampa
Min / Máx

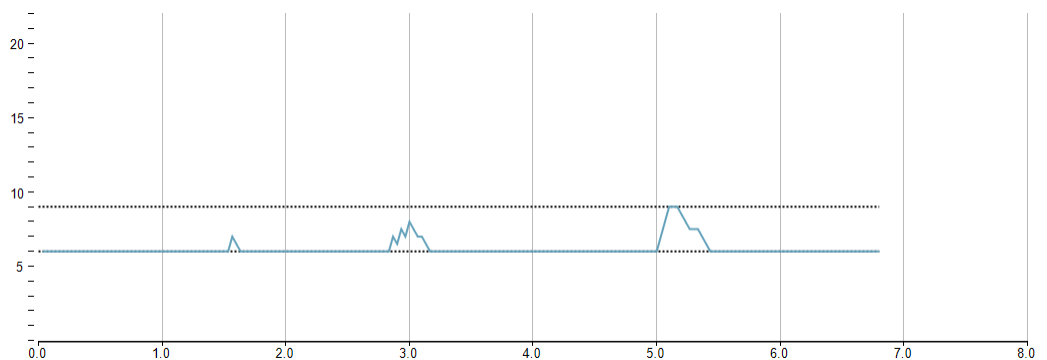

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 24
90° Percentil: 31
Vazamento Alto*: 0 %

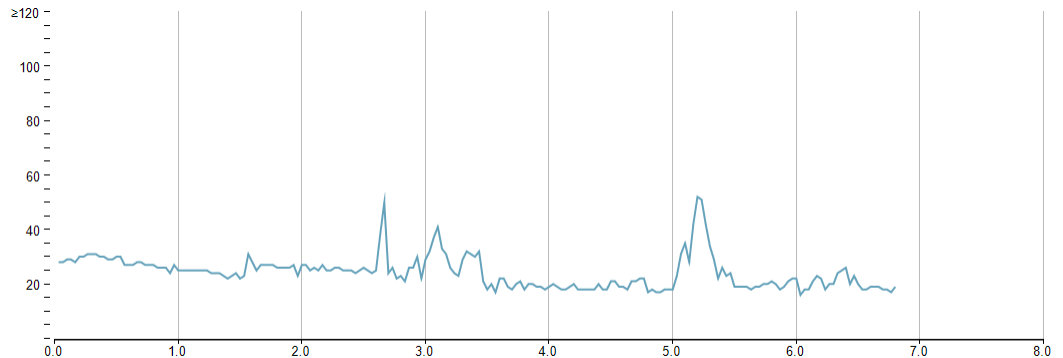

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	362	22	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 fev 2026


qui 12 fev 2026 23:11 -
sex 13 fev 2026 06:59

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:48
% de Utilização: 100 %

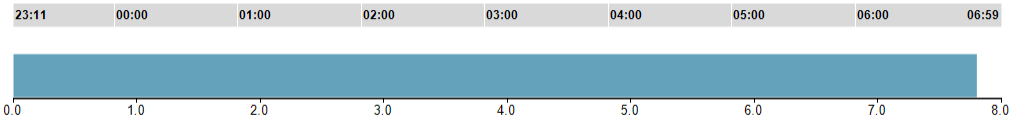

EVENTOS


IAH: 2,2
Apneia obstrutiva: 1
IAO: 0,1
Hipopneias: 16
IH: 2,0
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 2
Limitações de Fluxo (/h): 0,4
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0

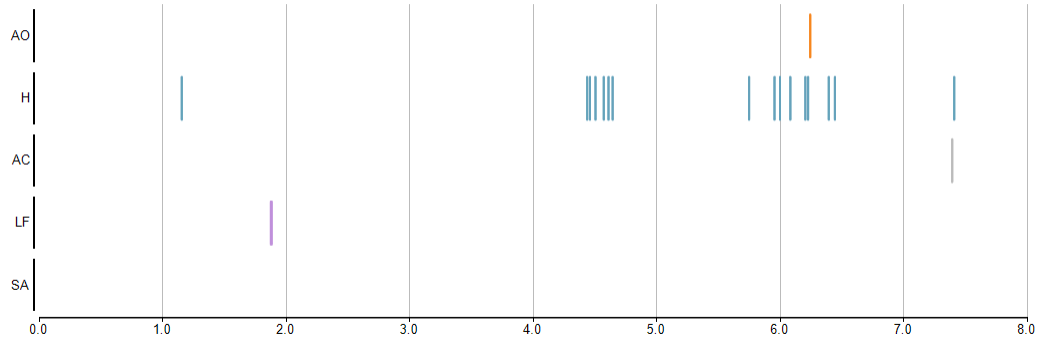

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 8,0
Tempo de Rampa
Min / Máx

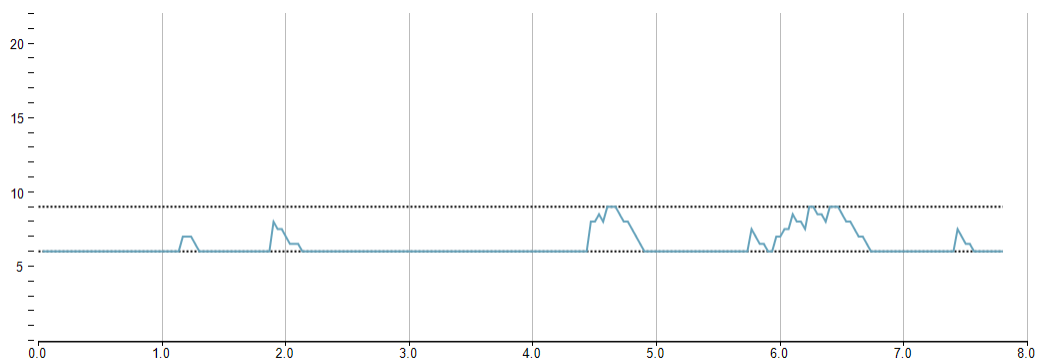

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 23
90° Percentil: 35
Vazamento Alto*: 0 %

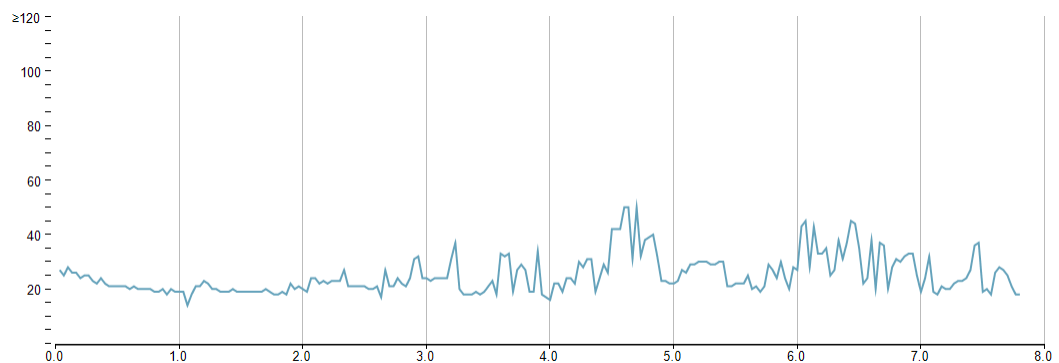

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	358	42	40	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	3	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 28 DIAS

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949 Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
14 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:06	8:06	2,6	0,1	----	----	2	7,0	8,5	30
15 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:06	8:06	0,5	0,1	----	----	2	6,0	7,0	31
16 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:48	5:48	2,5	0,0	----	----	2	7,0	9,0	33
17 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:30	4:30	0,8	0,0	----	----	2	6,5	8,5	35
18 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:24	5:24	1,1	0,0	----	----	2	7,0	9,0	33
19 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:24	6:24	1,2	0,2	----	----	2	6,0	8,0	30
20 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:48	6:48	0,4	0,0	----	----	2	6,0	7,0	34
21 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:06	5:06	2,0	0,2	----	----	2	7,0	8,0	39
23 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:06	8:06	0,7	0,0	----	----	2	6,0	8,0	27
24 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:54	8:54	1,9	0,1	----	----	2	6,5	8,0	27
25 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:36	5:36	1,6	0,0	----	----	2	7,0	9,0	26
26 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:54	4:54	0,6	0,0	----	----	2	6,0	8,0	36
27 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:30	5:30	1,6	0,2	----	----	2	7,0	9,0	35
28 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	1,9	0,1	----	----	2	7,0	9,0	34
29 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:06	8:06	0,4	0,0	----	----	2	6,0	7,0	30
30 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:18	6:18	0,3	0,0	----	----	2	6,0	7,0	40
31 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:36	5:36	2,9	0,0	----	----	2	7,5	9,0	35
01 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:18	8:18	0,6	0,1	----	----	2	6,0	7,0	28
02 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	3:42	3:42	2,0	0,3	----	----	2	7,0	8,0	45
03 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:18	8:18	1,5	0,0	----	----	2	7,0	9,0	40
04 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:18	8:18	0,9	0,1	----	----	2	6,0	8,0	31
06 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:54	7:54	0,2	0,1	----	----	2	6,0	7,0	36
07 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	9:06	9:06	1,0	0,1	----	----	2	6,0	8,0	28
08 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:12	8:12	0,6	0,0	----	----	2	6,0	7,0	37
09 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:42	8:42	0,6	0,1	----	----	2	6,0	7,0	30
10 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	2,0	0,1	----	----	2	7,0	9,0	31
11 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:48	6:48	1,0	0,0	----	----	2	6,5	9,0	31
12 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:48	7:48	2,2	0,1	----	----	2	8,0	9,0	35