

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 04 nov 1949

Sexo: —

Médico: —

Telefone: —

Média de IAHL

1,6

Média de Utilização
(h:min):

4:29

Adesão Tto.*:

63 %

* Últimos 30 Dias

% noites de utilização
CPAP ≥4 horas a partir de
13 set 2025

EQUIPAMENTOS

EM 12 out 2025

Modelo: SleepStyle Auto

Umidif.: 4,0

Nº de Série: 201132T8B

Alívio Expiratório: 2 cmH₂O

Modo: Auto

SensAwake: Desligado

Pressão Mín.
Ajustada: 6,0 cmH₂O

Pressão Máx.
Ajustada: 9,0 cmH₂O

ADESÃO AO
TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS

13 set 2025 - 12 out 2025

INÍCIO DA TERAPIA

05 out 2021 - 12 out 2025

Total de Dias:

Utilização: 23 (77 %)

992 (68 %)

Utilização ≥ 4 horas: 19 (63 %)

962 (65 %)

Não Utilizado: 7 (23 %)

477 (32 %)

Média de Utilização (Dias em
Terapia):

5:51

7:19

Média de Utilização (Todos os
Dias):

4:29

4:57

Total Func.:

134:54

7273:42

EFICÁCIA**

IAH: 1,6

Duração das Apneias: 13 s

IAC: 0,1

Pressão: 6 cmH₂O

Pressão de 90º Percentil: 7 cmH₂O

À Pressão Máxima: 1 %

Vazamento do Sistema: 22 L/min

Vazamento no 90º Percentil: 30 L/min

Vazamento Alto: 0 %

Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite

SensAwake Ligado: 0 %

AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 24 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 4:29


Dias de Utilização: 77 %

■ Total Func.

■ Total de Utilização

■ Utilização <4 h

..... Umidif.

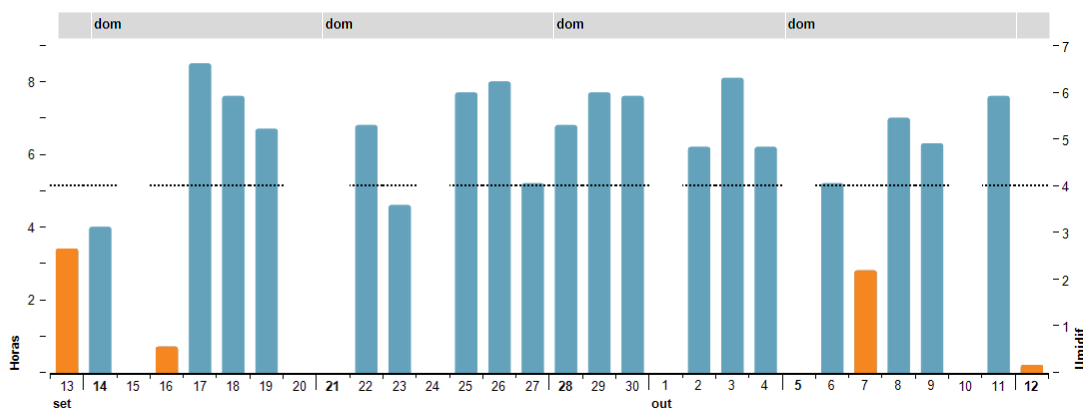

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 1,6
IAC: 0,1
IAO: 0,3
IH: 1,3

IAH Total

IAH = 5

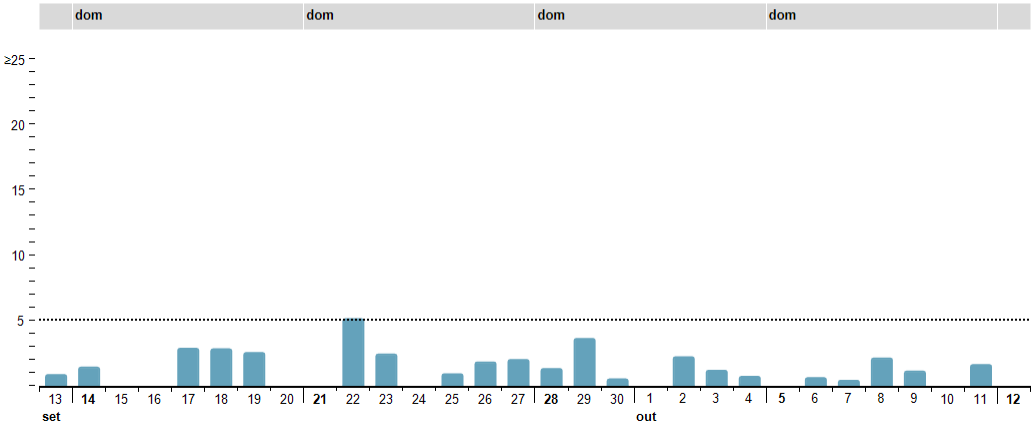

PRESSÃO

cmH₂O


Média: 6,0
90º Percentil: 7,0

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx

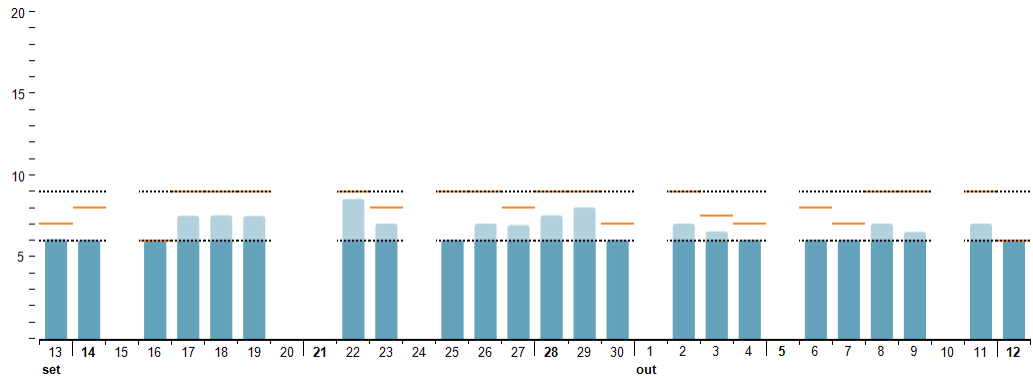

VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 22
90º Percentil: 30

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

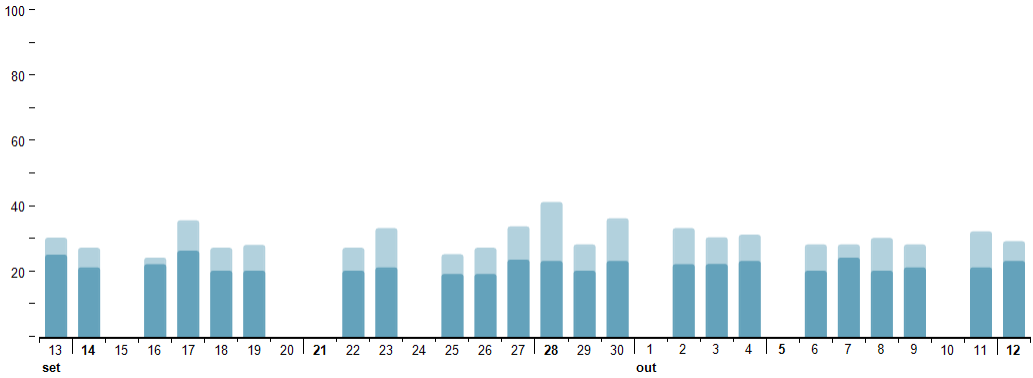

UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 4:29
Dias de Utilização: 77 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.

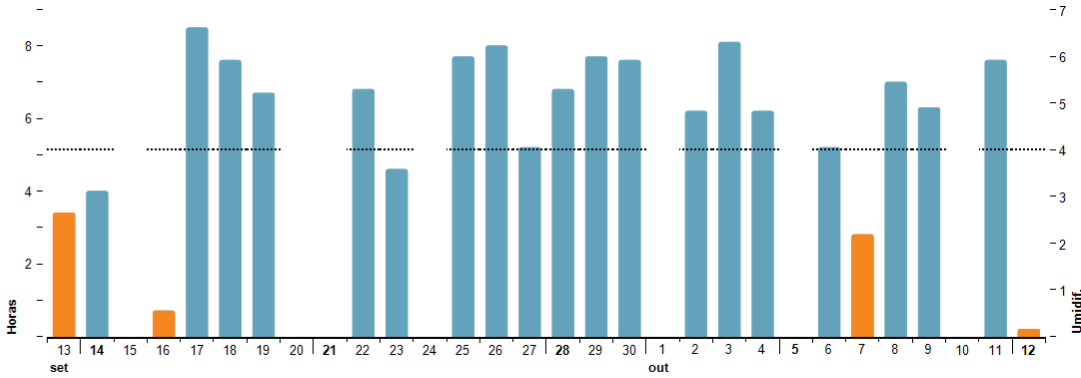

RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: JOSE FREDERICO Carvalho De Bacigalupo Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949 Sexo: —

Histórico de Prescrições



ANÁLISE DE 23 DIAS

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
13 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	3:24	3:24	0,8	0,0	----	----	2	6,0	7,0	30
14 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:00	4:00	1,4	0,3	----	----	2	6,0	8,0	27
16 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	0:42	0:42	0,0	0,0	----	----	2	6,0	6,0	24
17 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:30	8:30	2,8	0,2	----	----	2	7,5	9,0	35
18 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	2,8	0,5	----	----	2	7,5	9,0	27
19 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:42	6:42	2,5	0,0	----	----	2	7,5	9,0	28
22 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:48	6:48	5,1	0,3	----	----	2	8,5	9,0	27
23 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:36	4:36	2,4	0,0	----	----	2	7,0	8,0	33
25 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:42	7:42	0,9	0,0	----	----	2	6,0	9,0	25
26 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:00	8:00	1,8	0,0	----	----	2	7,0	9,0	27
27 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:12	5:12	2,0	0,0	----	----	2	7,0	8,0	34
28 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:48	6:48	1,3	0,0	----	----	2	7,5	9,0	41
29 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:42	7:42	3,6	0,4	----	----	2	8,0	9,0	28
30 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	0,5	0,0	----	----	2	6,0	7,0	36
02 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:12	6:12	2,2	0,3	----	----	2	7,0	9,0	33
03 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:06	8:06	1,2	0,1	----	----	2	6,5	7,5	30
04 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:12	6:12	0,7	0,0	----	----	2	6,0	7,0	31
06 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:12	5:12	0,6	0,0	----	----	2	6,0	8,0	28
07 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	2:48	2:48	0,4	0,0	----	----	2	6,0	7,0	28
08 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:00	7:00	2,1	0,0	----	----	2	7,0	9,0	30
09 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:18	6:18	1,1	0,0	----	----	2	6,5	9,0	28
11 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	1,6	0,3	----	----	2	7,0	9,0	32
12 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	0:12	0:12	0,0	0,0	----	----	2	6,0	6,0	29