


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/02/2026 - 16/03/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	25 dias (83%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	171 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/03/2026)	9,559 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201648900
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 7.4	Máximo: 7.5	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 5.1	Máximo: 17.9	
Eventos por hora	IA: 13.4	IH: 1.6	IAH: 15.0	
Índice de apneia	Central: 12.1	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	9 minutos (3%)			

Horas de utilização

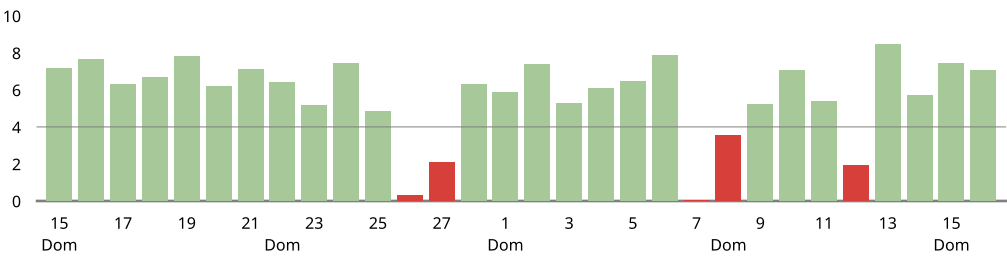


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201648900


Utilização (horas)

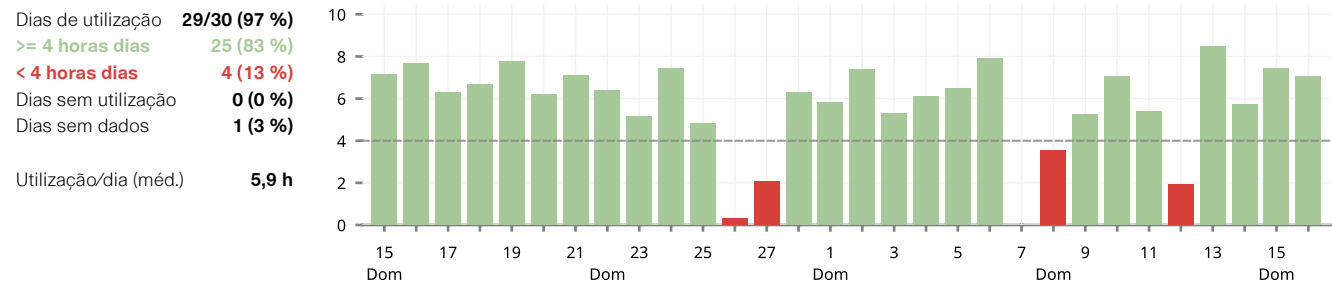

Fuga (l/min)

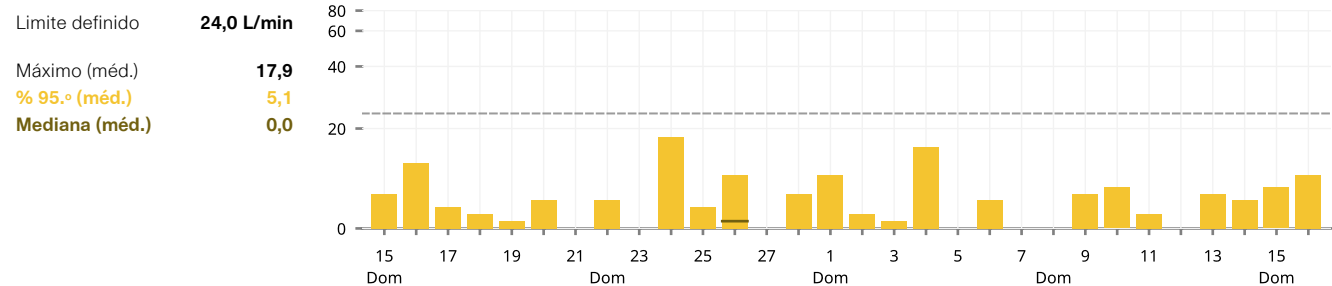

Pressão (cmH2O)

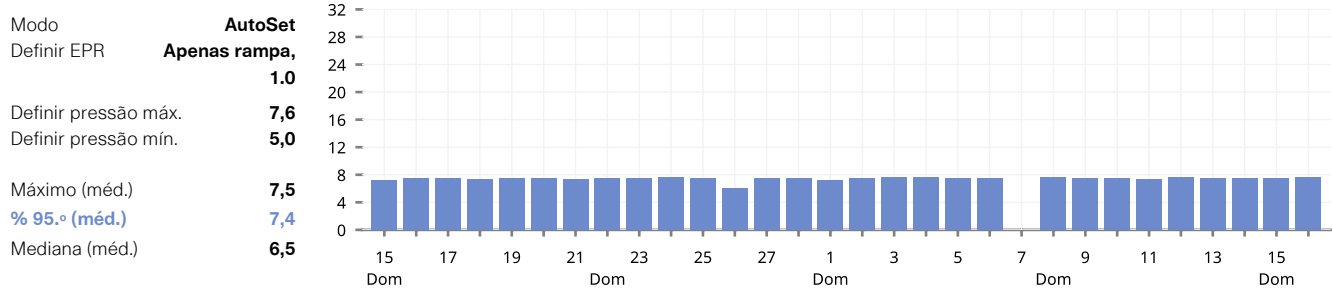

IAH (eventos/hora)

