


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/10/2025 - 24/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	23 dias (77%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	155 horas 14 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 10 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/11/2025)	8,867 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201648900
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 7.4	Máximo: 7.6	
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 5.7	Máximo: 15.2	
Eventos por hora	IA: 14.2	IH: 1.3	IAH: 15.5	
Índice de apneia	Central: 12.9	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	5 minutos (2%)			

Horas de utilização

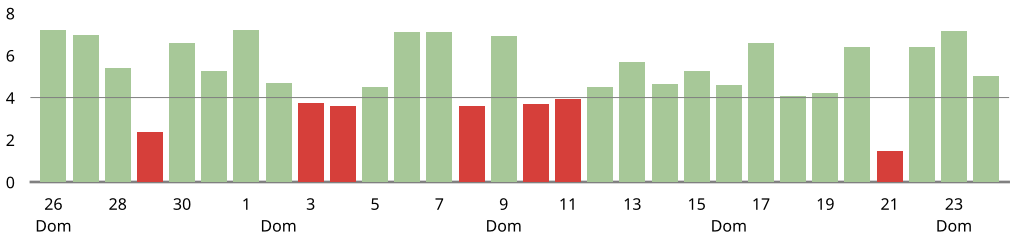


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201648900


Utilização (horas)

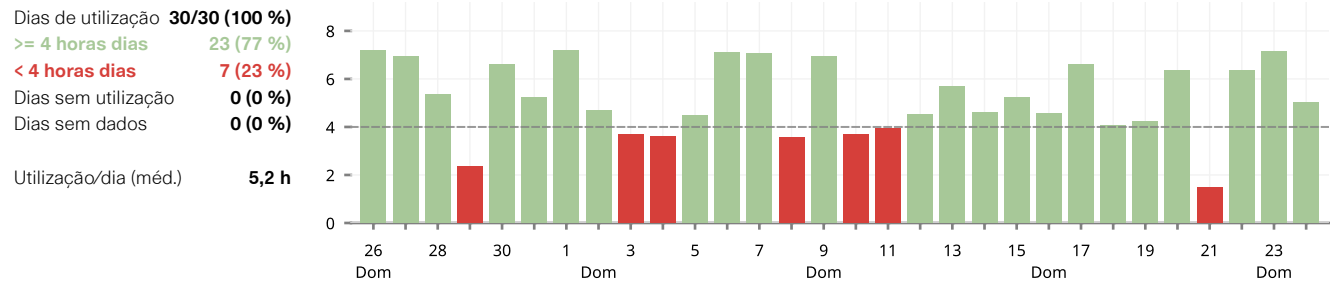

Fuga (l/min)

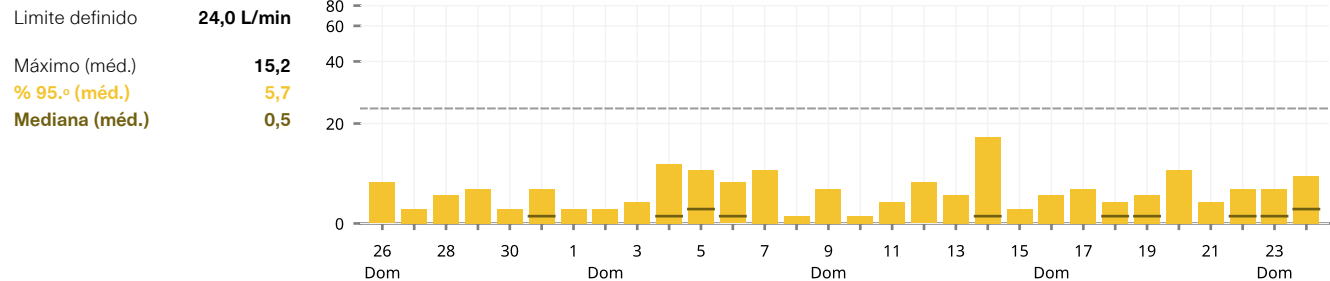

Pressão (cmH2O)

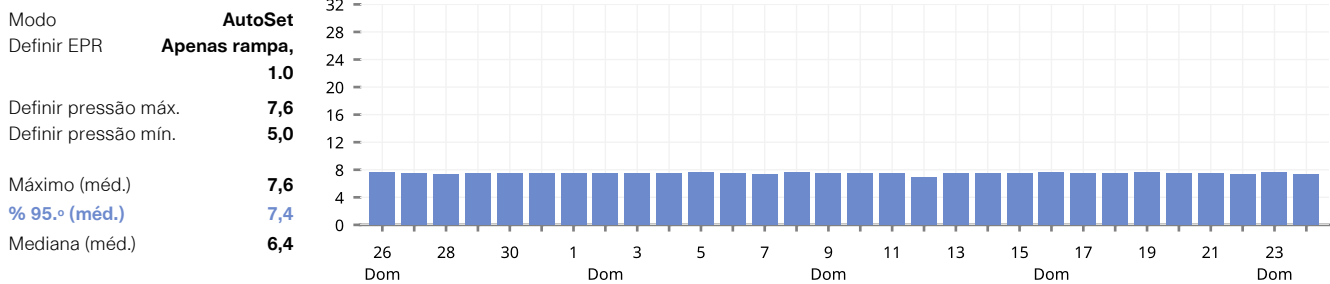

IAH (eventos/hora)

