

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

21/02/2026 - 22/03/2026

Dias de utilização		25/30 dias (83%)	
>= 4 horas		25 dias (83%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		165 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 38 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 40 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)		6,968 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22221550693	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 7.9
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 18.2	Máximo: 27.6
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.2	IAH: 0.7
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

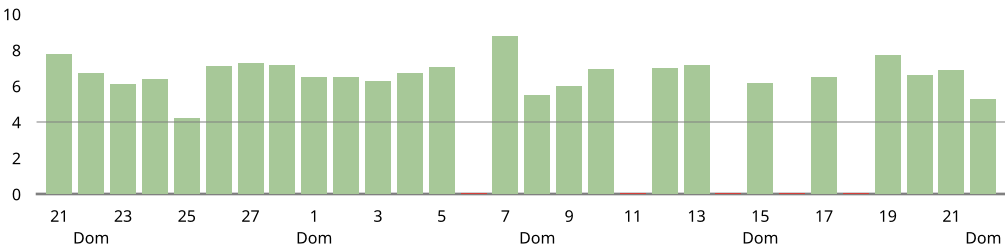


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221550693


Utilização (horas)

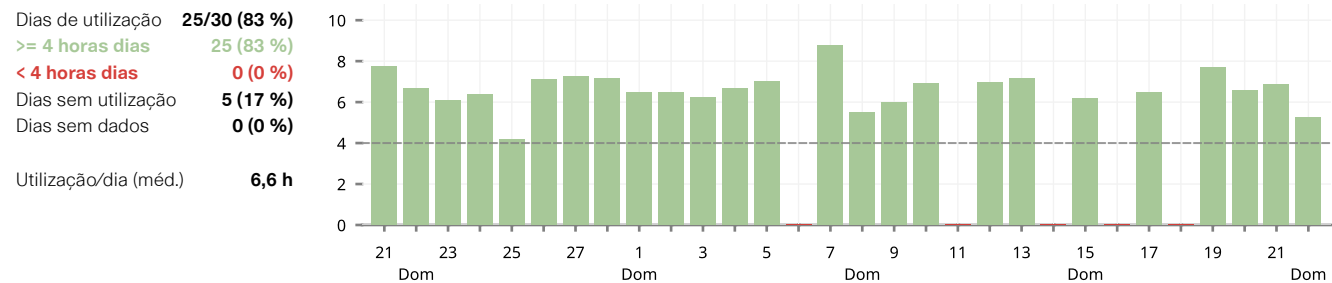

Fuga (l/min)

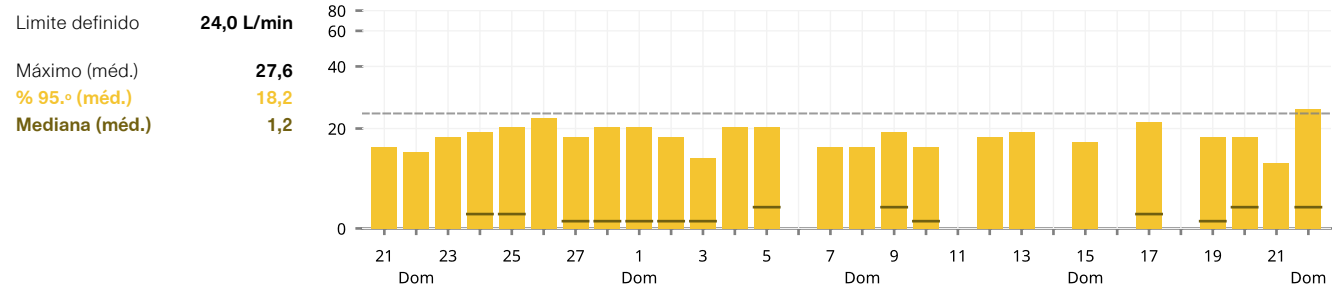

Pressão (cmH2O)

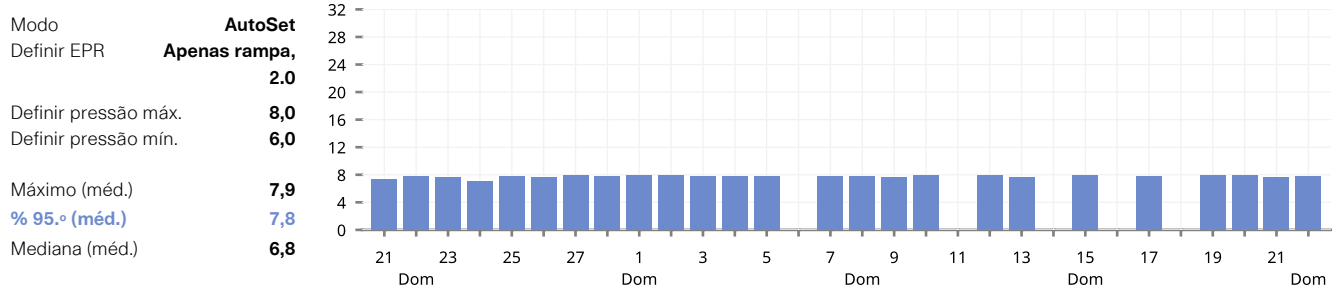

IAH (eventos/hora)

