

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

27/11/2025 - 29/11/2025

Dias de utilização

3/3 dias (100%)

>= 4 horas

3 dias (100%)

< 4 horas

0 dias (0%)

Horas de utilização

16 horas 12 minutos

Utilização média (total de dias)

5 horas 24 minutos

Utilização média (dias de utilização)

5 horas 24 minutos

Utilização mediana (dias de utilização)

5 horas 15 minutos

Total de horas de uso (último reset de valores - 29/11/2025)

16 horas

AirSense 10 AutoSet

Número de série

22242260584

Modo

AutoSet

Pressão mín.

4 cmH2O

Pressão máx.

10 cmH2O

EPR

Apenas rampa

Nível de EPR

1

Resposta

Suave

Terapia

Pressão — cmH2O

Mediana: 5.6

Percentil 95.º: 7.7

Máximo: 9.0

Fugas — l/min

Mediana: 1.6

Percentil 95.º: 9.2

Máximo: 23.6

Eventos por hora

IA: 3.0

IH: 0.7

IAH: 3.7

Índice de apneia

Central: 2.1

Obstrutiva: 0.8

Desconhecid 0.0

Índice RERA

0.1

Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)

0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260584


Utilização (horas)

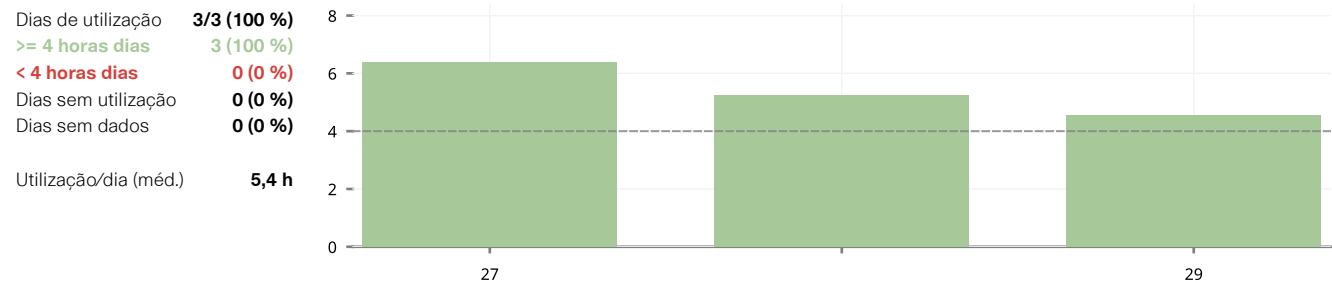

Fuga (l/min)

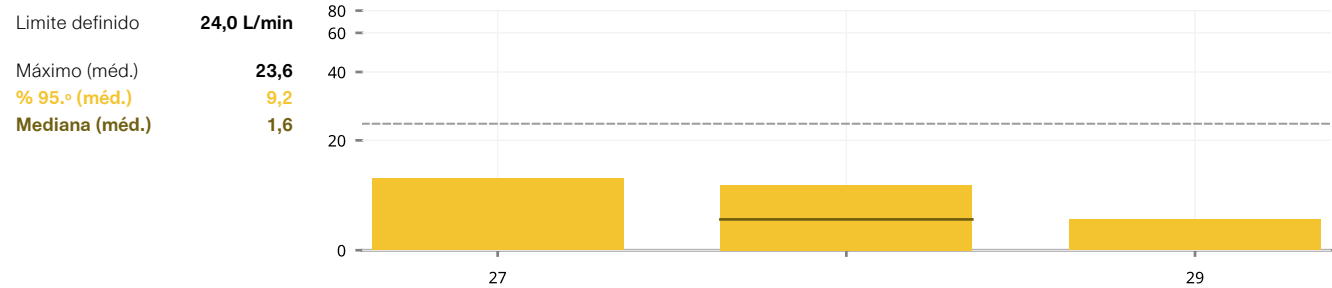

Pressão (cmH2O)

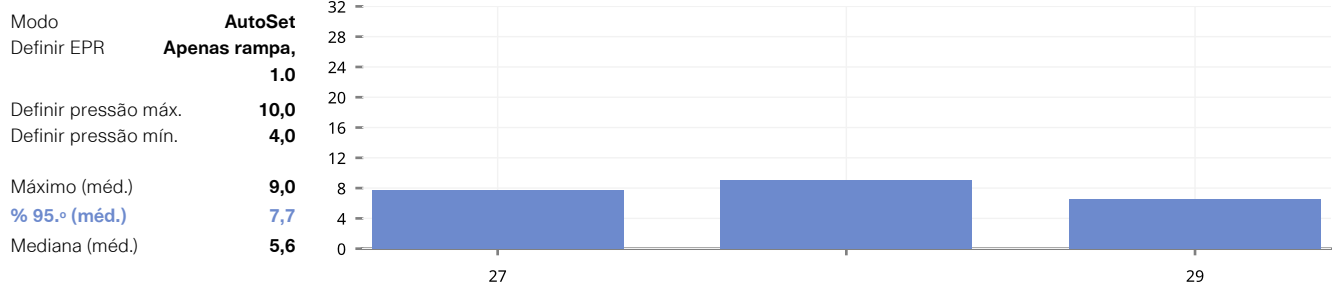

IAH (eventos/hora)

