


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 04/01/2026 - 02/02/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 30/30 dias (100%)   |                         |
| >= 4 horas                                                   | 27 dias (90%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 3 dias (10%)        |                         |
| Horas de utilização                                          | 190 horas 6 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 6 horas 20 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 20 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 40 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 02/02/2026) | 2,031 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22232346918  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 9 cmH2O      |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 2            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 4.9   | Percentil 95.º: 18.1 | Máximo: 26.0 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.8        | IH: 0.4              | IAH: 1.2     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.5   | Obstrutiva: 0.2      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 0.6            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

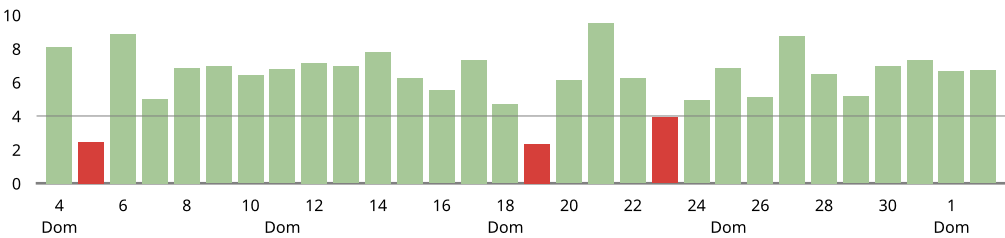


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232346918


## Utilização (horas)

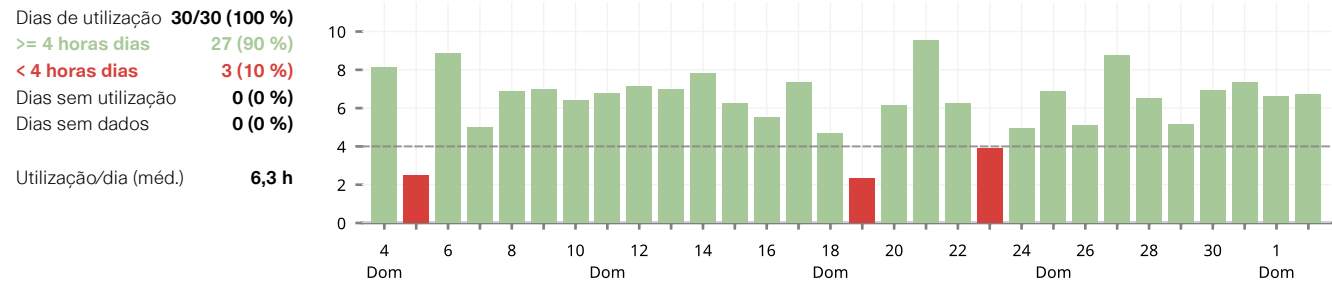

## Fuga (l/min)

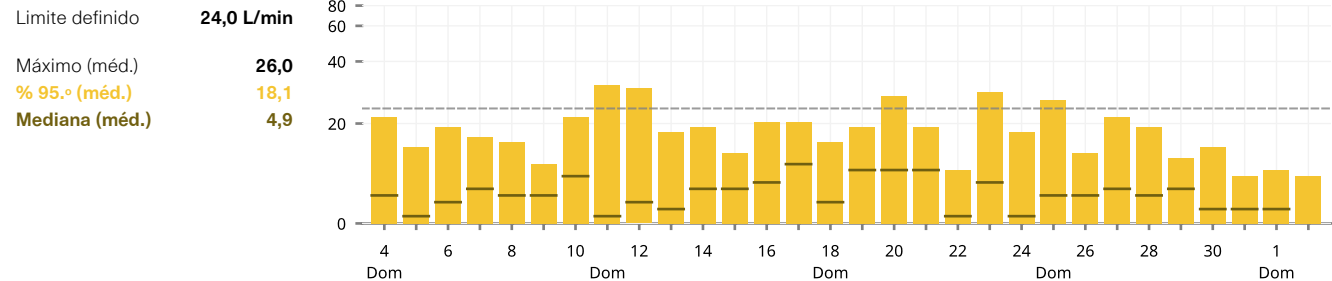

## Pressão (cmH2O)

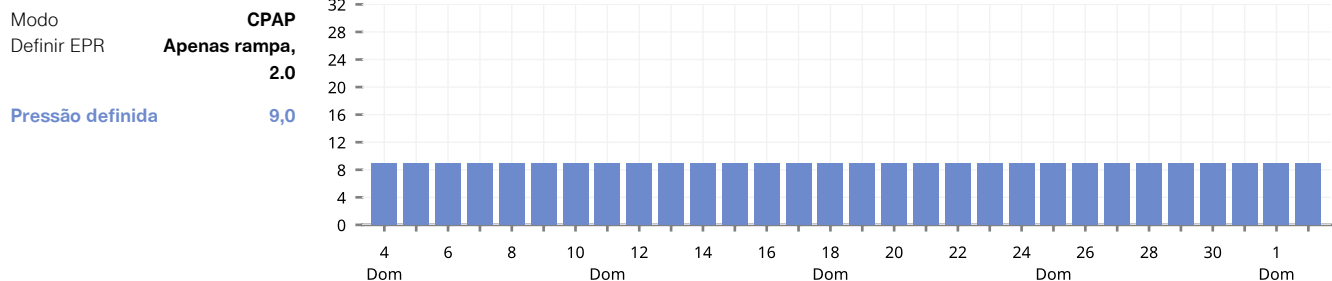

## IAH (eventos/hora)

