

DADOS DO PACIENTE

Nome: ROSANA CAVALI Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 12 jun 1963 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAHL: **2,5** Média de Utilização (h:min): **7:08** Adesão Tto.*: **97 %** * Últimos 30 Dias
% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 06 jan 2026

EQUIPAMENTOS

EM 04 fev 2026

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 5,0
Nº de Série: 211224P3P Alívio Expiratório: Desligado
Modo: Auto SensAwake: Desligado
Pressão Mín. Ajustada: 6,0 cmH₂O
Pressão Máx. Ajustada: 7,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS
06 jan 2026 - 04 fev 2026

INÍCIO DA TERAPIA
31 jan 2023 - 04 fev 2026

Total de Dias:
Utilização: 29 (97 %) 1057 (96 %)
Utilização ≥ 4 horas: 29 (97 %) 1025 (93 %)
Não Utilizado: 1 (3 %) 44 (4 %)
Média de Utilização (Dias em Terapia): 7:23 7:21
Média de Utilização (Todos os Dias): 7:08 7:03
Total Func.: 215:30 8003:00

EFICÁCIA**

IAH: 2,5 Duração das Apnéias: 13 s IAC: 0,4
Pressão: 6 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 6,5 cmH₂O À Pressão Máxima: 9 %
Vazamento do Sistema: 26 L/min Vazamento no 90º Percentil: 35 L/min Vazamento Alto: 1 %
Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite SensAwake Ligado: 0 %


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 25 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 7:08
Dias de Utilização: 97 %
Total Func.
Total de Utilização
Utilização <4 h
Umídif.

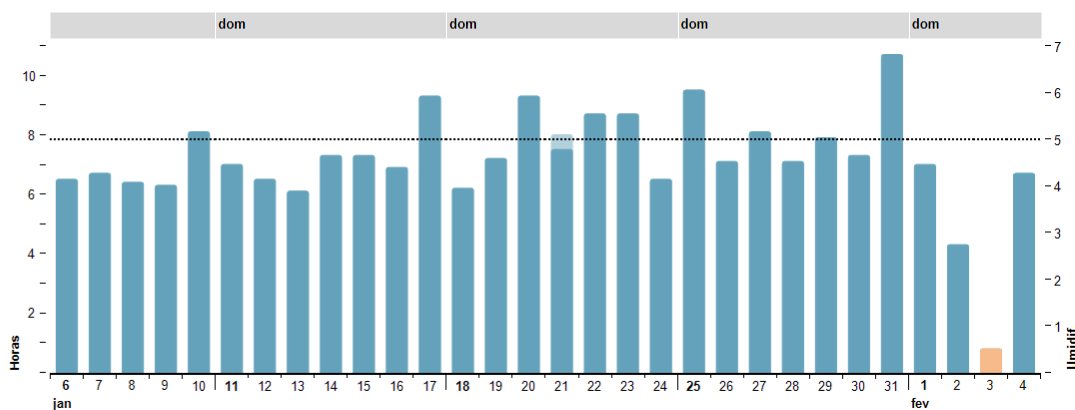

DADOS DO PACIENTE

Nome: ROSANA CAVALI Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 12 jun 1963 Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 2,5
 IAC: 0,4
 IAO: 0,3
 IH: 1,8

IAH Total

IAH = 5

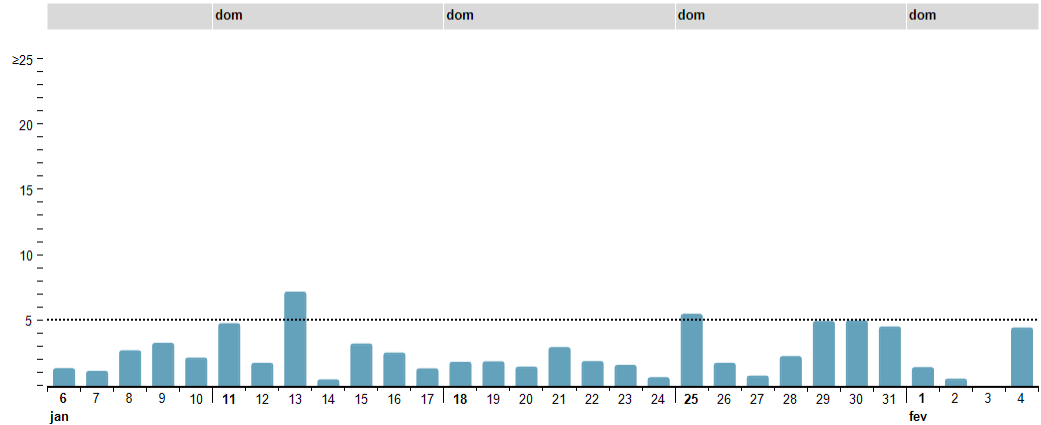

PRESSÃO

cmH₂O


Média: 6,0
 90º Percentil: 6,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx

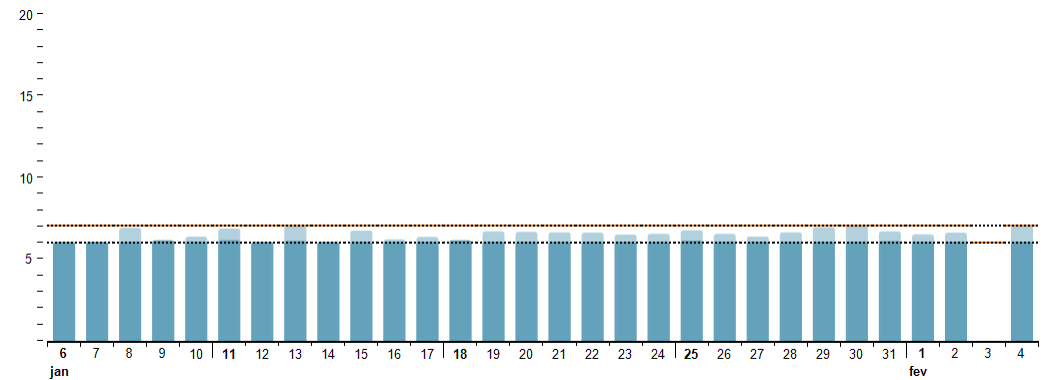

VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 26
 90º Percentil: 35

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

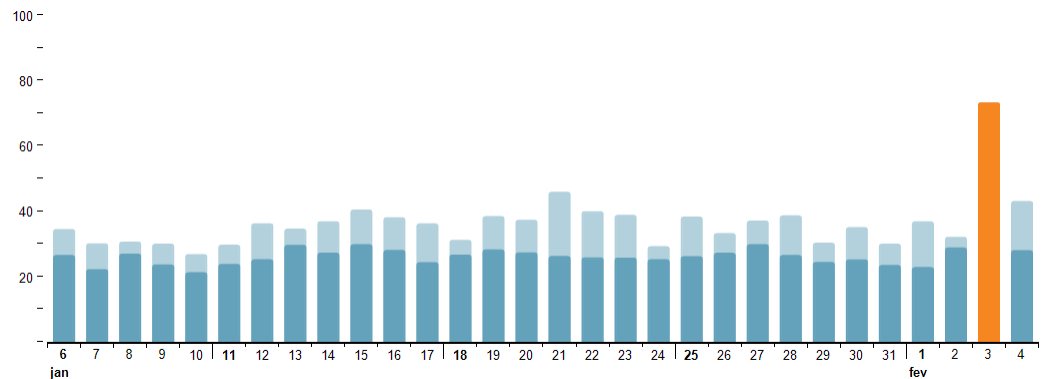

UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 7:08
 Dias de Utilização: 97 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.

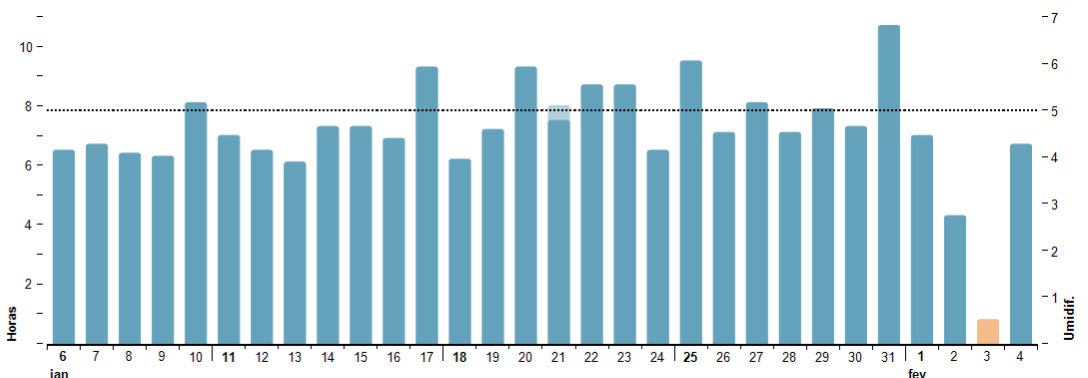


RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: ROSANA CAVALI Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 12 jun 1963 Sexo: —

Histórico de Prescrições

PMín: 6,0 PMáx: 7,0
U: 5,0 SA: Desligado AE: 0,0

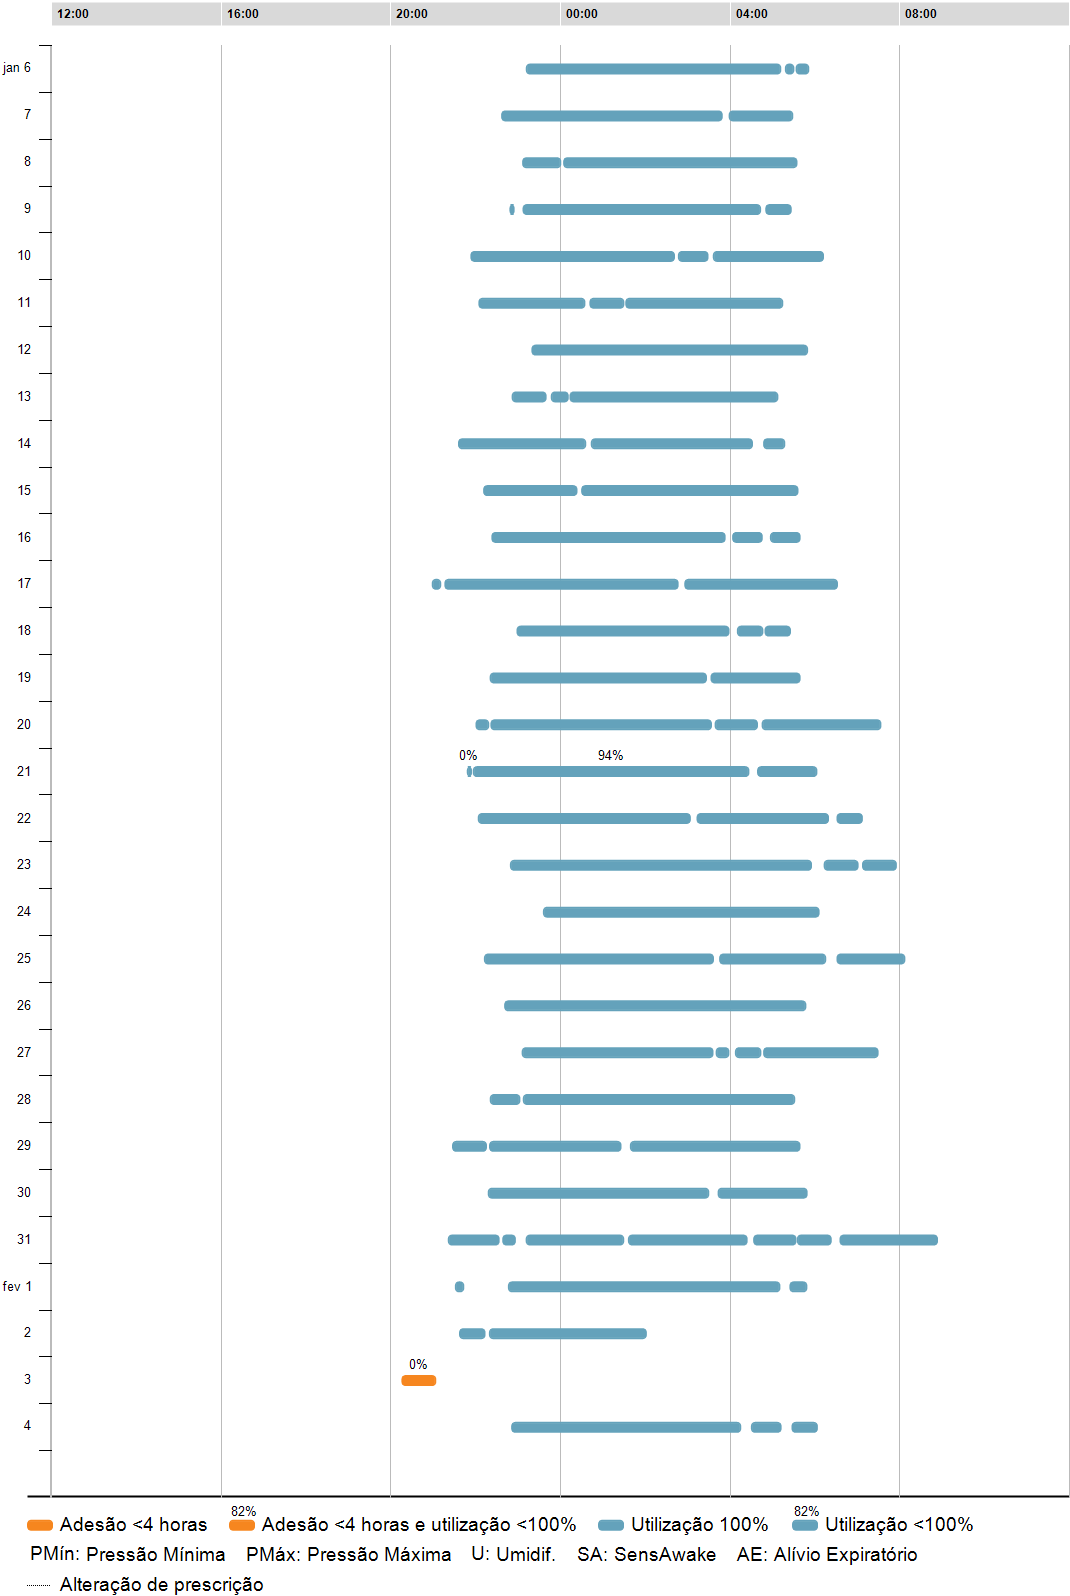

ANÁLISE DE 30 DIAS

Nome: ROSANA CAVALI

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 12 jun 1963

Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
06 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:30	6:30	1,3	0,0	----	----	Desligado	6,0	7,0	34
07 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:42	6:42	1,1	0,3	----	----	Desligado	6,0	7,0	30
08 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:24	6:24	2,7	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	30
09 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:18	6:18	3,2	1,6	----	----	Desligado	6,0	7,0	30
10 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:06	8:06	2,1	0,1	----	----	Desligado	6,5	7,0	27
11 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:00	7:00	4,7	0,7	----	----	Desligado	7,0	7,0	29
12 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:30	6:30	1,7	0,0	----	----	Desligado	6,0	7,0	36
13 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:06	6:06	7,2	3,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	34
14 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:18	7:18	0,4	0,3	----	----	Desligado	6,0	7,0	37
15 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:18	7:18	3,2	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	40
16 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:54	6:54	2,5	0,0	----	----	Desligado	6,0	7,0	38
17 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	9:18	9:18	1,3	0,0	----	----	Desligado	6,5	7,0	36
18 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:12	6:12	1,8	0,2	----	----	Desligado	6,0	7,0	31
19 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:12	7:12	1,8	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	38
20 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	9:18	9:18	1,4	0,2	----	----	Desligado	7,0	7,0	37
21 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:00	7:30	2,9	0,0	----	----	Desligado	7,0	7,0	46
22 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:42	8:42	1,8	0,7	----	----	Desligado	7,0	7,0	40
23 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:42	8:42	1,5	0,4	----	----	Desligado	6,5	7,0	39
24 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:30	6:30	0,6	0,3	----	----	Desligado	6,5	7,0	29
25 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	9:30	9:30	5,4	1,4	----	----	Desligado	7,0	7,0	38
26 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:06	7:06	1,7	0,6	----	----	Desligado	6,5	7,0	33
27 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:06	8:06	0,7	0,2	----	----	Desligado	6,5	7,0	37
28 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:06	7:06	2,2	0,2	----	----	Desligado	7,0	7,0	38
29 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:54	7:54	4,9	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	30
30 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:18	7:18	4,9	0,0	----	----	Desligado	7,0	7,0	35
31 jan 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	10:42	10:42	4,5	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	30
01 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:00	7:00	1,4	0,2	----	----	Desligado	6,5	7,0	37
02 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	4:18	4:18	0,5	0,0	----	----	Desligado	7,0	7,0	32
03 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	0:48	0:00	0,0	0,0	----	----	Desligado	0,0	6,0	73
04 fev 2026	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:42	6:42	4,4	0,5	----	----	Desligado	7,0	7,0	43