

DADOS DO PACIENTE

Nome: ROSANA CAVALI Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 12 jun 1963 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAHL: **2,9** Média de Utilização (h:min): **7:17** Adesão Tto.*: **100 %** * Últimos 30 Dias
% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 26 ago 2025

EQUIPAMENTOS

EM 24 set 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 5,0
Nº de Série: 211224P3P Alívio Expiratório: Desligado
Modo: Auto SensAwake: Desligado
Pressão Mín. Ajustada: 6,0 cmH₂O
Pressão Máx. Ajustada: 7,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS
26 ago 2025 - 24 set 2025

INÍCIO DA TERAPIA
31 jan 2023 - 24 set 2025

Total de Dias:
Utilização: 30 (100 %) 925 (96 %)
Utilização ≥ 4 horas: 30 (100 %) 894 (92 %)
Não Utilizado: 0 (0 %) 43 (4 %)
Média de Utilização (Dias em Terapia): 7:17 7:21
Média de Utilização (Todos os Dias): 7:17 7:01
Total Func.: 228:06 7015:00

EFICÁCIA**

IAH: 2,9 Duração das Apnéias: 13 s IAC: 0,5
Pressão: 6 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 6,5 cmH₂O À Pressão Máxima: 9 %
Vazamento do Sistema: 30 L/min Vazamento no 90º Percentil: 40 L/min Vazamento Alto: 6 %
Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite SensAwake Ligado: 0 %


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 24 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 7:17
Dias de Utilização: 100 %
Total Func.
Total de Utilização
Utilização <4 h
Umídif.

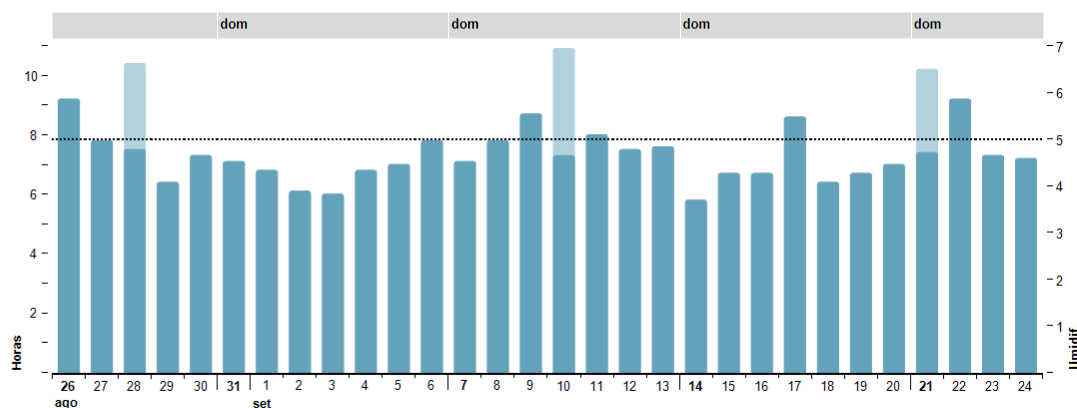

DADOS DO PACIENTE

Nome: ROSANA CAVALI Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 12 jun 1963 Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 2,9
 IAC: 0,5
 IAO: 0,4
 IH: 2,0

IAH Total

IAH = 5

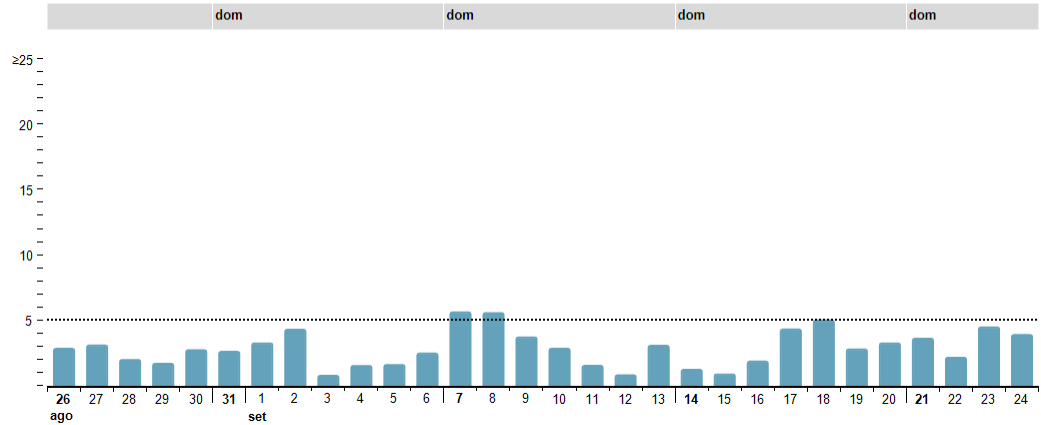

PRESSÃO

cmH₂O


Média: 6,0
 90º Percentil: 6,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx

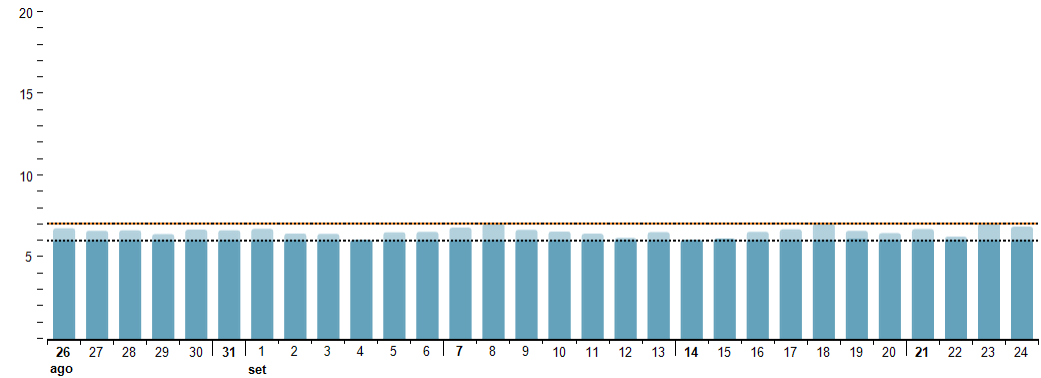

VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 30
 90º Percentil: 40

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

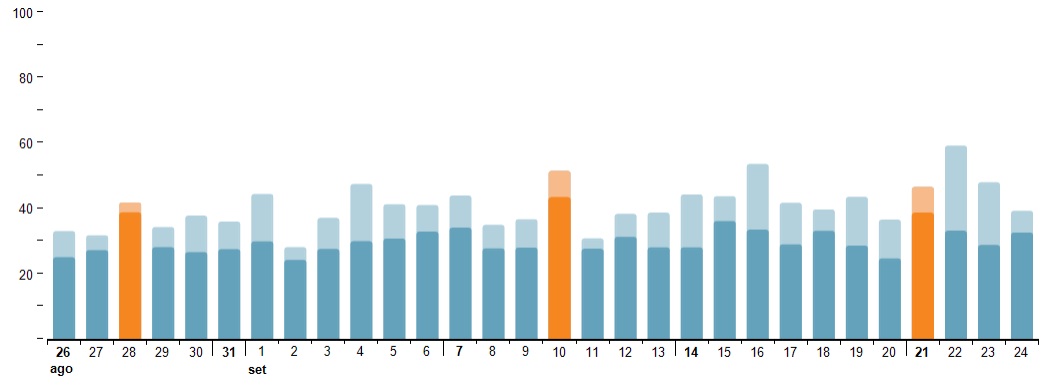

UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 7:17
 Dias de Utilização: 100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.

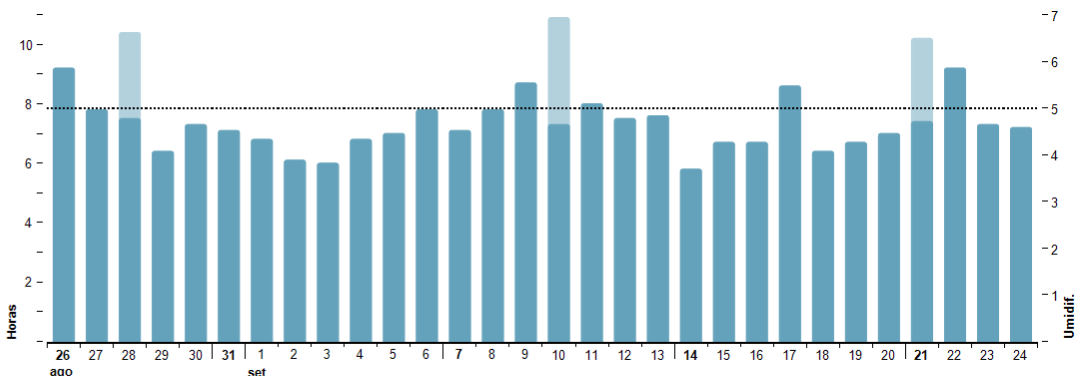

RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome:	ROSANA CAVALI	Telefone:	—
Identificação Paciente:	—	E-mail:	—
Data de Nascimento:	12 jun 1963	Sexo:	—

Histórico de Prescrições



ANÁLISE DE 30 DIAS

Nome: ROSANA CAVALI Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 12 jun 1963 Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
26 ago 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	9:12	9:12	2,8	0,6	----	----	Desligado	7,0	7,0	33
27 ago 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:48	7:48	3,1	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	31
28 ago 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	10:24	7:30	2,0	0,7	----	----	Desligado	7,0	7,0	41
29 ago 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:24	6:24	1,7	0,0	----	----	Desligado	6,5	7,0	34
30 ago 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:18	7:18	2,7	0,7	----	----	Desligado	7,0	7,0	37
31 ago 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:06	7:06	2,6	0,2	----	----	Desligado	7,0	7,0	36
01 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:48	6:48	3,3	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	44
02 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:06	6:06	4,3	0,8	----	----	Desligado	6,5	7,0	28
03 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:00	6:00	0,8	0,0	----	----	Desligado	6,5	7,0	37
04 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:48	6:48	1,5	0,0	----	----	Desligado	6,0	7,0	47
05 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:00	7:00	1,6	0,0	----	----	Desligado	6,5	7,0	41
06 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:48	7:48	2,5	0,9	----	----	Desligado	6,5	7,0	41
07 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:06	7:06	5,6	1,5	----	----	Desligado	7,0	7,0	44
08 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:48	7:48	5,6	1,2	----	----	Desligado	7,0	7,0	35
09 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:42	8:42	3,7	0,7	----	----	Desligado	7,0	7,0	36
10 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	10:54	7:18	2,8	0,9	----	----	Desligado	6,5	7,0	51
11 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:00	8:00	1,5	0,3	----	----	Desligado	6,5	7,0	30
12 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:30	7:30	0,8	0,0	----	----	Desligado	6,0	7,0	38
13 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:36	7:36	3,1	0,4	----	----	Desligado	6,5	7,0	38
14 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	5:48	5:48	1,2	0,2	----	----	Desligado	6,0	7,0	44
15 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:42	6:42	0,9	0,2	----	----	Desligado	6,0	7,0	43
16 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:42	6:42	1,9	0,8	----	----	Desligado	6,5	7,0	53
17 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	8:36	8:36	4,3	0,5	----	----	Desligado	7,0	7,0	41
18 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:24	6:24	5,0	0,6	----	----	Desligado	7,0	7,0	39
19 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	6:42	6:42	2,8	0,3	----	----	Desligado	7,0	7,0	43
20 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:00	7:00	3,3	0,3	----	----	Desligado	6,5	7,0	36
21 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	10:12	7:24	3,6	0,1	----	----	Desligado	7,0	7,0	46
22 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	9:12	9:12	2,2	0,1	----	----	Desligado	6,0	7,0	59
23 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:18	7:18	4,5	0,6	----	----	Desligado	7,0	7,0	48
24 set 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 7,0	5,0	0	7:12	7:12	3,9	0,5	----	----	Desligado	7,0	7,0	39