


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/02/2026 - 04/03/2026
Dias de utilização	28/28 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	191 horas 28 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 51 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/03/2026)	191 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032702
Modo	CPAP
Pressão definida	7.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 34.6	Máximo: 46.1	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.4	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

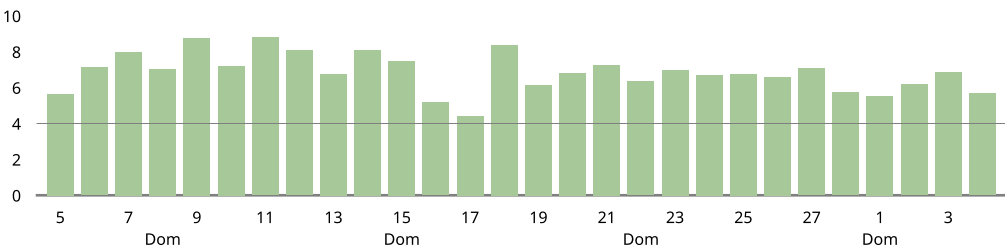

Relatório de terapia


AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032702

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/28 (100 %)**
>= 4 horas dias **28 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,8 h**

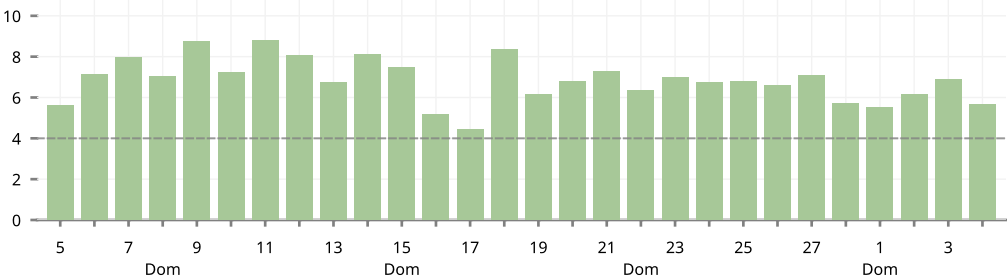

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **46,1**
% 95.º (méd.) **34,6**
Mediana (méd.) **8,8**

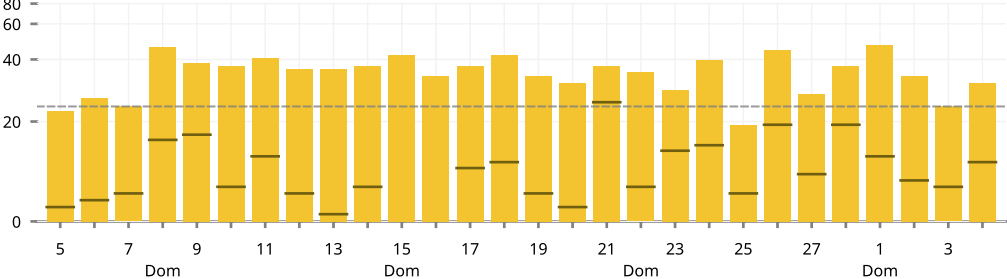

Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,2**

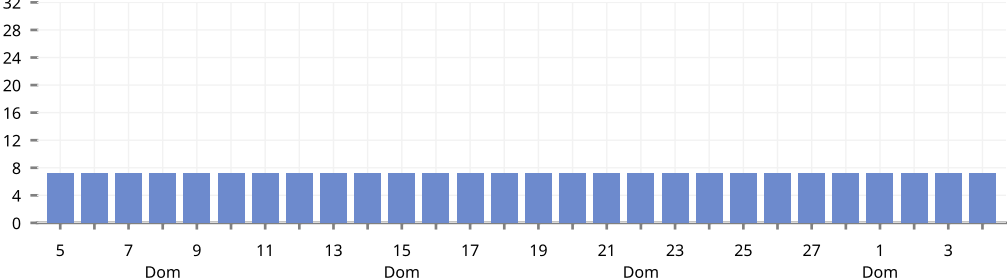

IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC ☐

IAO ☐

IAD ☐

RERA ☐

%RCS (méd.) ☐

0.8

0.4

0.4


0.2

0.2

0.0

0.1


0.0

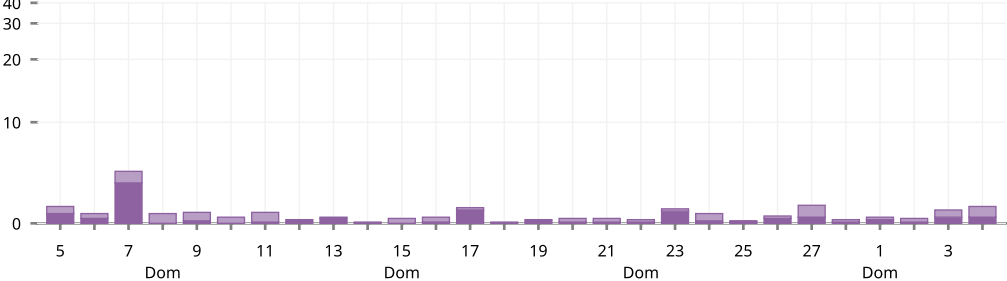

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032702

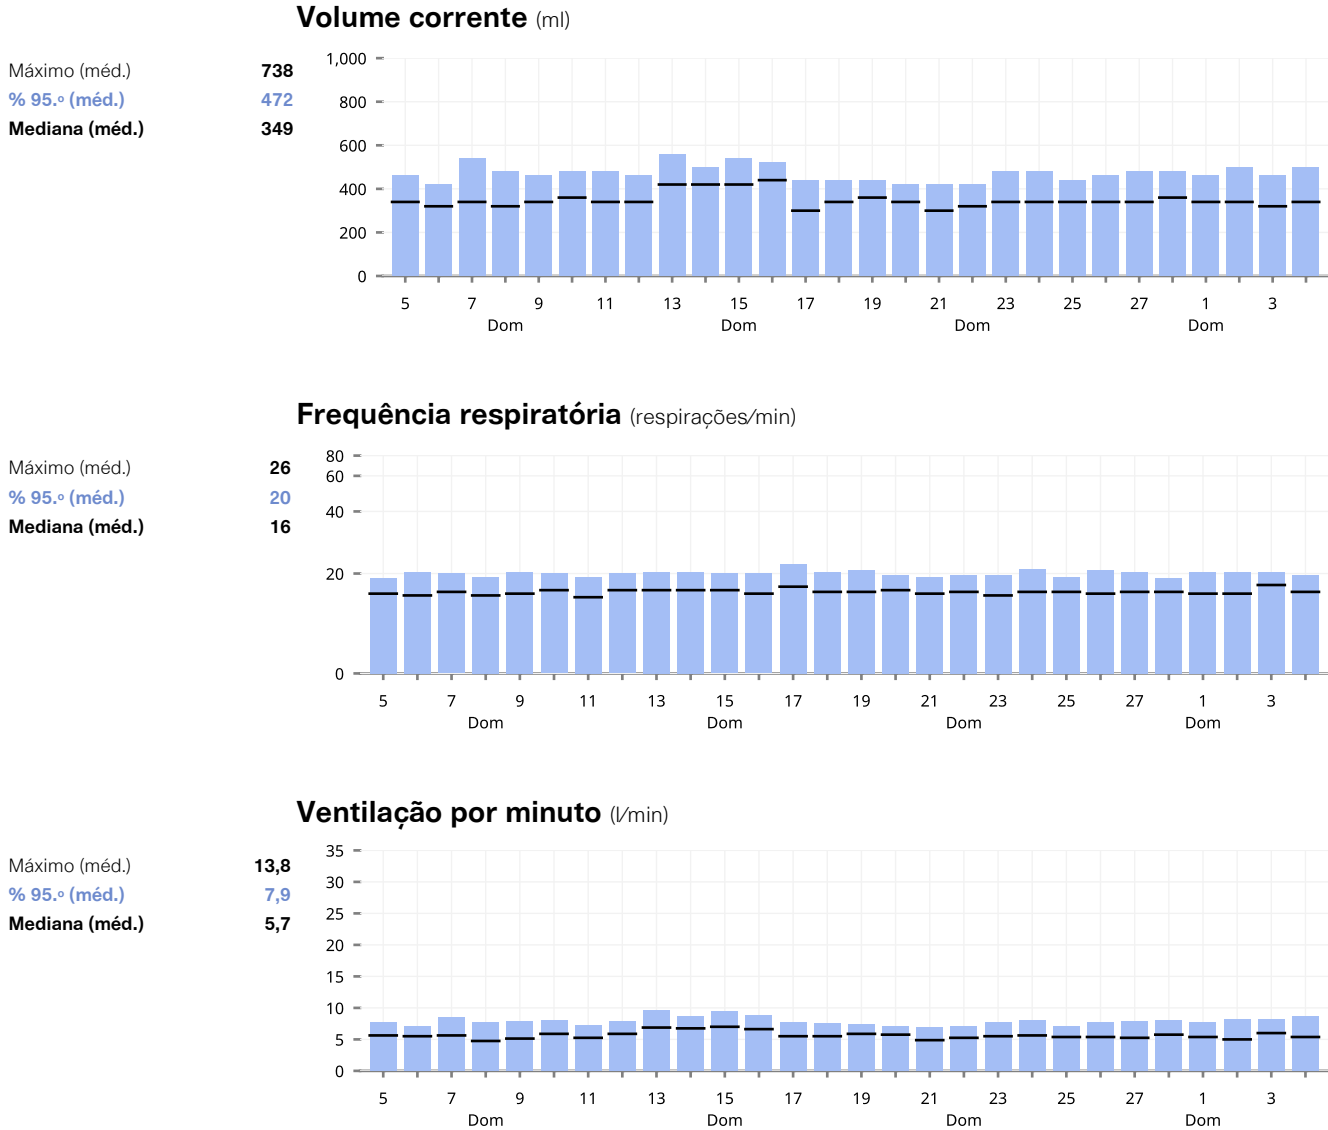

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032702

Care Check-In

Não há dados disponíveis porque o usuário se recusou a responder as perguntas de terapia, esse recurso foi desativado no dispositivo do usuário ou o usuário não autorizou compartilhar seus dados com o myAir.

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento