

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. RICARDO FAJARDO**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **27 outubro 1956** Idade: **68**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **31/03/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		





Estatísticas





01/09/2025 - 30/09/2025		Dispositivo: S9 VPAP Auto (S/N: 22121495025)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: VAuto	Apoio de pressão: 2,2 cmH20	EPAP mín: 10,4 cmH20	
IPAP máx: 13,0 cmH20			
IPAP - cmH20			
Mediana: 12,6	Percentil 95: 13,0	Máximo/a: 13,0	
EPAP - cmH20			
Mediana: 10,4	Percentil 95: 10,7	Máximo/a: 10,8	
Fuga - l/min			
Mediana: 40,8	Percentil 95: 75,6	Máximo/a: 116,4	
Volume corrente - ml			
Mediana: 220	Percentil 95: 320	Máximo/a: 1060	
Ventilação por minuto - l/min			
Mediana: 4,6	Percentil 95: 6,1	Máximo/a: 17,9	
Frequência respiratória - respirações/min			
Mediana: 19	Percentil 95: 23	Máximo/a: 32	
% de respirações espontâneas em ciclo: 0			
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,0	Índice de hipopneia: 0,1	AHI: 0,1	
Obstrutiva: 0,0	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0	
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 30	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 202:37	
Mediana do uso diário: 6:53	Média de uso diário: 6:45		
Relação I:E			
Mediana: 1:1,49	Percentil 95: 1:1,3	Máximo/a: 1,18:1	

Gráficos em sumário


01/09/2025 - 30/09/2025

Dispositivo: S9 VPAP Auto (S/N: 22121495025)

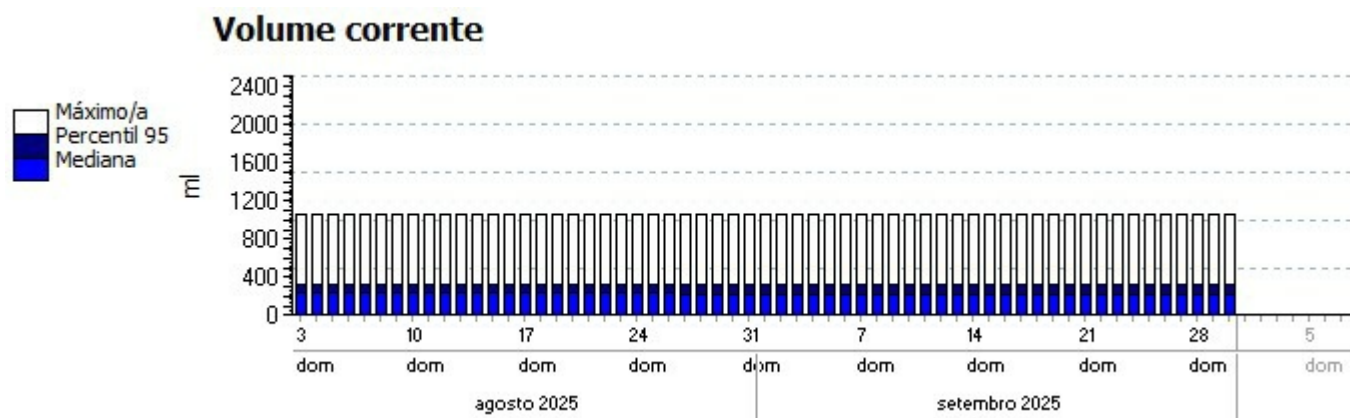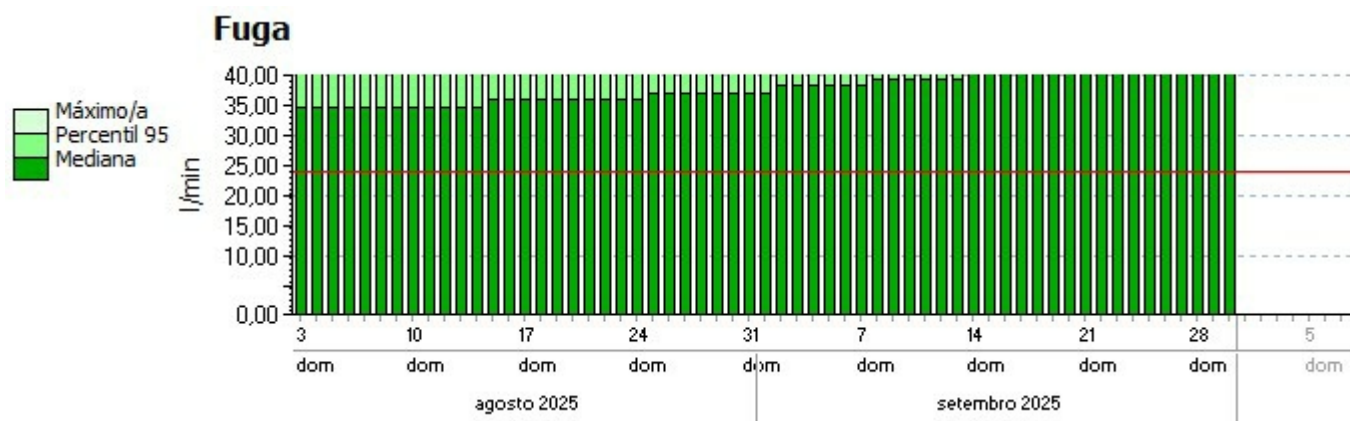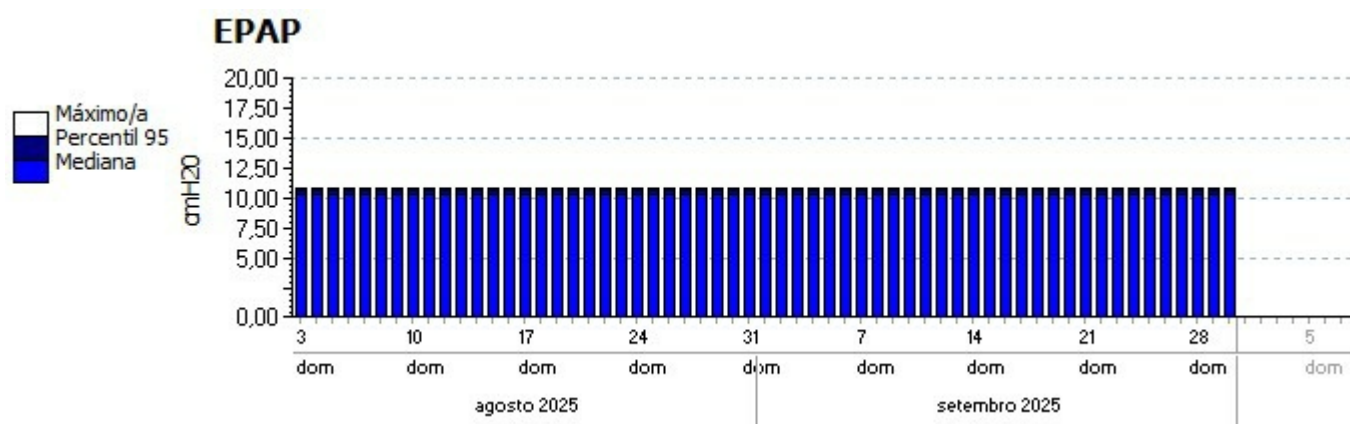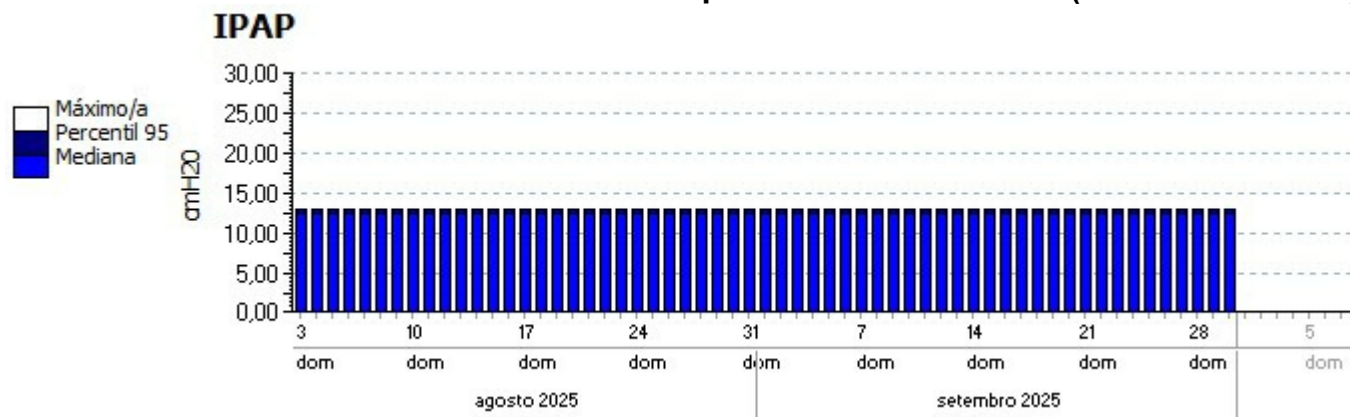


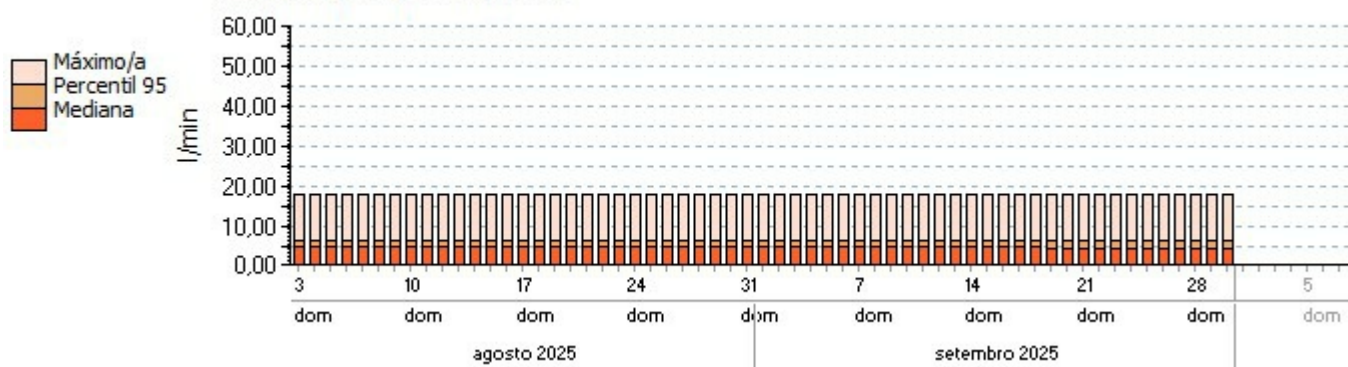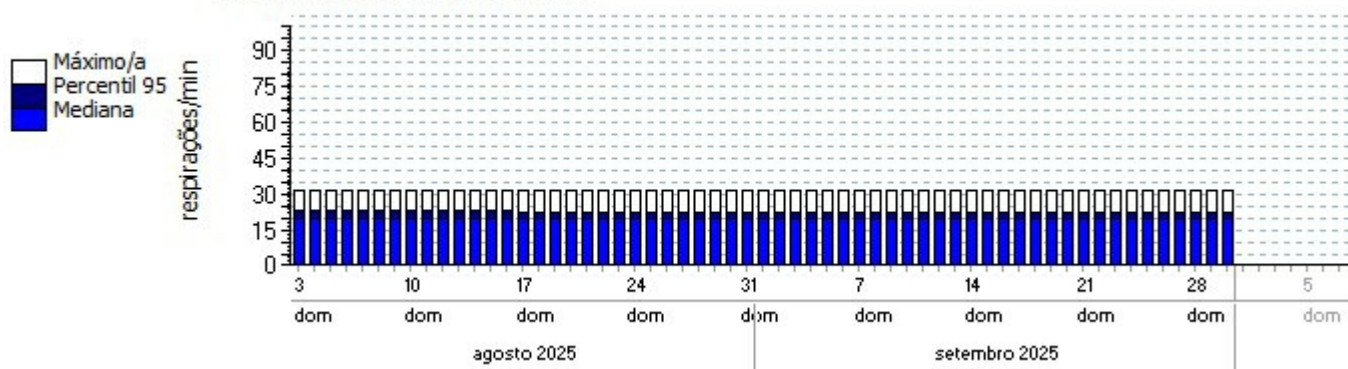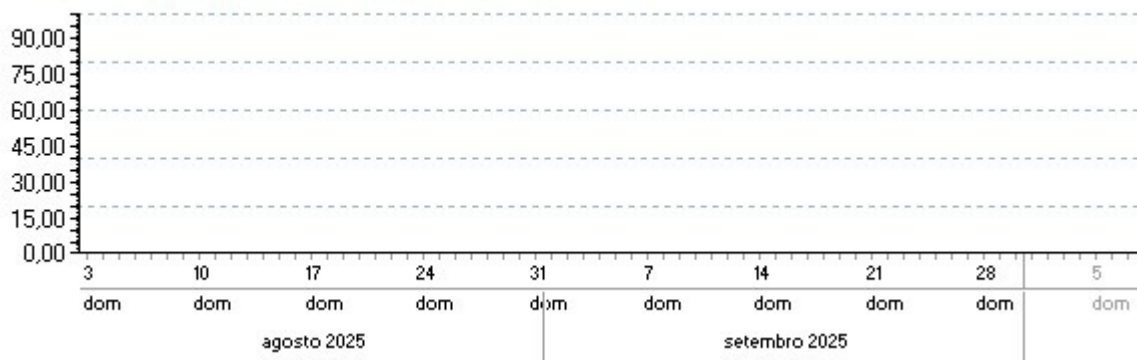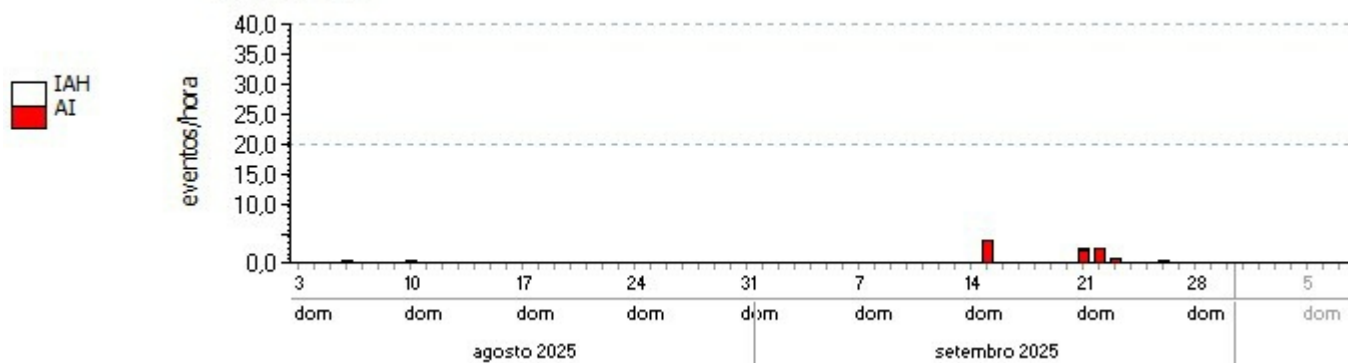Ventilação por minuto**Frequência respiratória****% de respirações espontâneas em ciclo****IAH & IA**

Uso

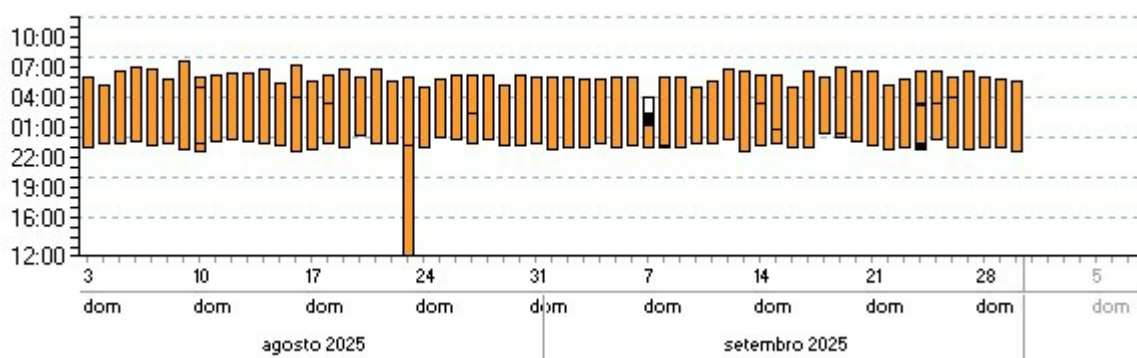

Utilização Total

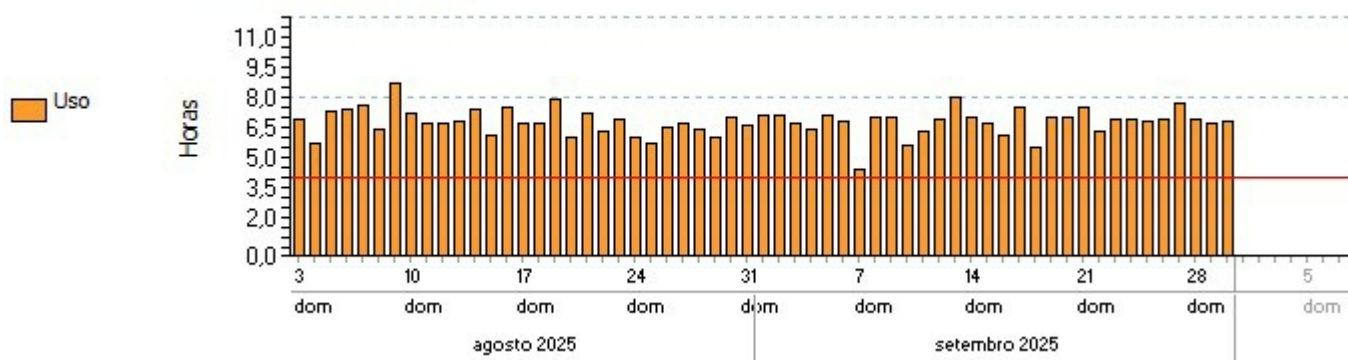

Relação I:E

