

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. RICARDO FAJARDO**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **27 outubro 1956** Idade: **69**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **31/03/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo: 22121495025	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
		Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

01/01/2026 - 30/01/2026

Dispositivo: S9 VPAP Auto (S/N: 22121495025)

Parâmetros do dispositivo

Modo de terapia: **VAuto**

Apoio de pressão: **2,2 cmH2O**

EPAP mín: **10,4 cmH2O**

IPAP máx: **13,0 cmH2O**

IPAP - cmH2O

Mediana: **12,6**

Percentil 95: **12,6**

Máximo/a: **12,6**

EPAP - cmH2O

Mediana: **10,4**

Percentil 95: **10,4**

Máximo/a: **10,4**

Fuga - l/min

Mediana: **72,0**

Percentil 95: **88,2**

Máximo/a: **99,6**

Volume corrente - ml

Mediana: **220**

Percentil 95: **300**

Máximo/a: **440**

Ventilação por minuto - l/min

Mediana: **4,8**

Percentil 95: **6,3**

Máximo/a: **8,7**

Frequência respiratória - respirações/min

Mediana: **21**

Percentil 95: **23**

Máximo/a: **25**

% de respirações espontâneas em ciclo: **80**

Índices respiratórios - eventos/hora

Índice de apneia: **0,0**

Índice de hipopneia: **0,1**

AHI: **0,1**

Obstrutiva: **0,0**

Central: **0,0**

Desconhecida: **0,0**

Utilização Total

Dias de Uso >= 4 horas : **27**

Dias de Uso < 4 horas : **1**

% Dias de Uso >= 4 horas : **90**

Dias de não utilização: **2**

Totalidade de dias: **30**

Horas de utilização: **173:18**

Mediana do uso diário: **6:17**

Média de uso diário: **5:46**

Relação I:E

Mediana: **1:1,44**

Percentil 95: **1:1,28**


Máximo/a: **1:1,05**

Gráficos em sumário


01/01/2026 - 30/01/2026

Dispositivo: S9 VPAP Auto (S/N: 22121495025)


Pressão prescrita

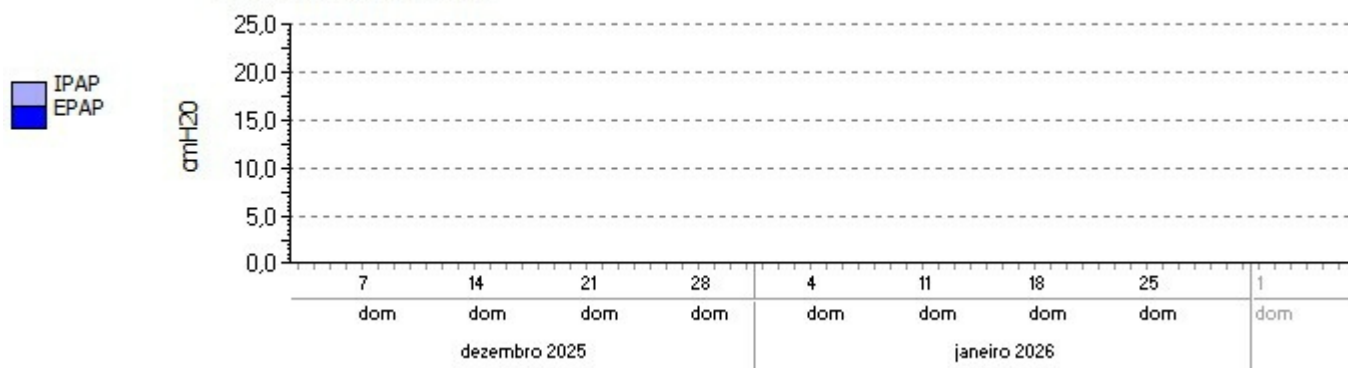


IPAP

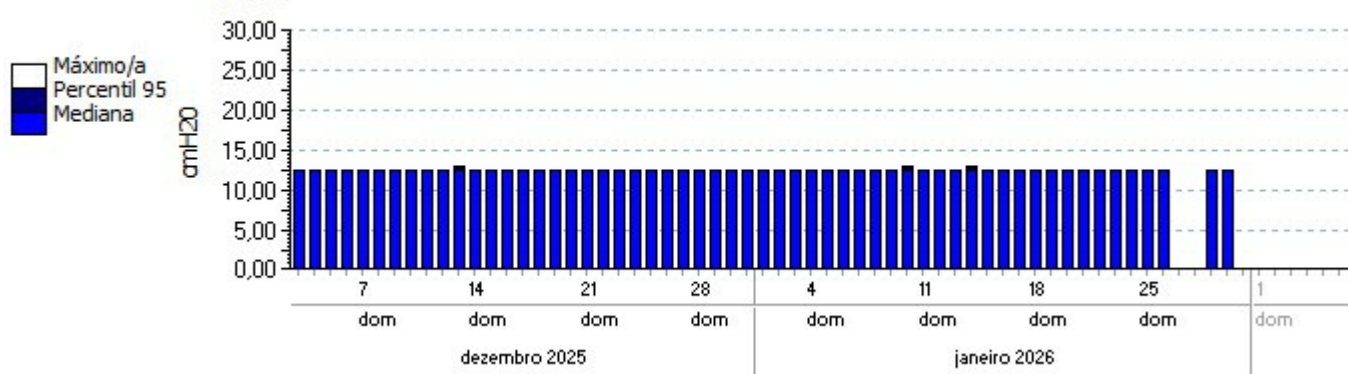


EPAP

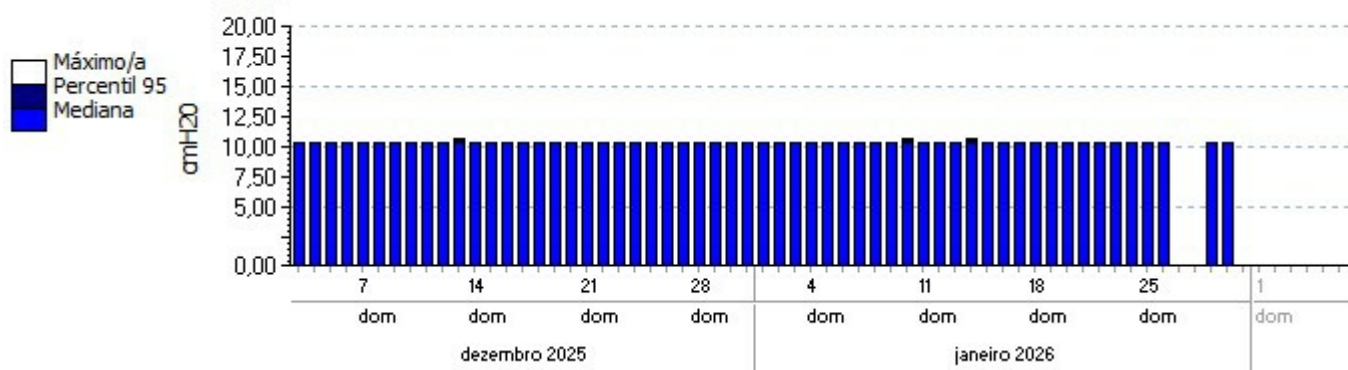


Fuga

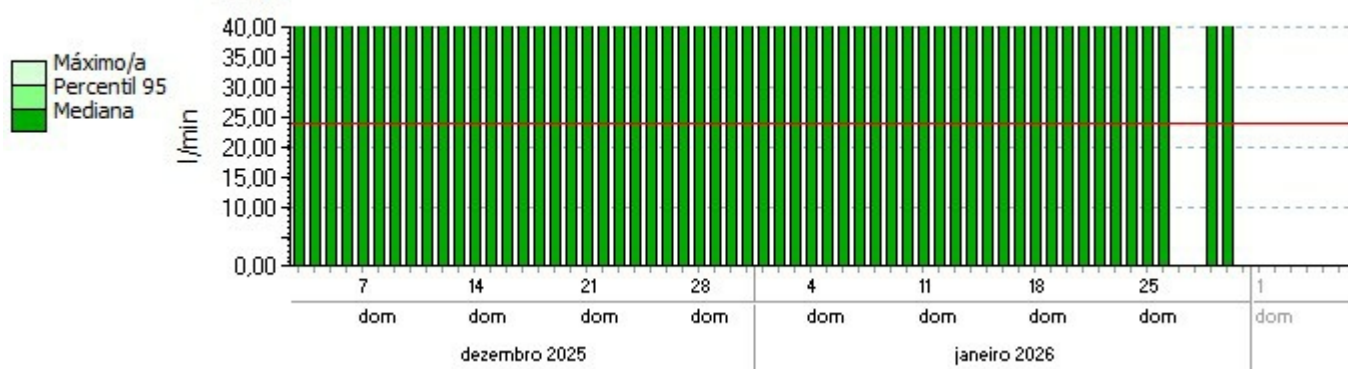


Volume corrente

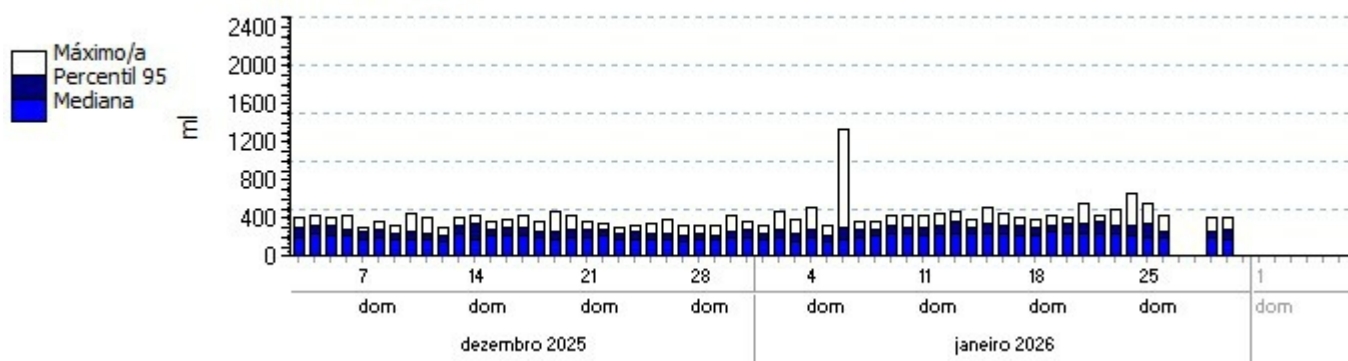


Ventilação por minuto

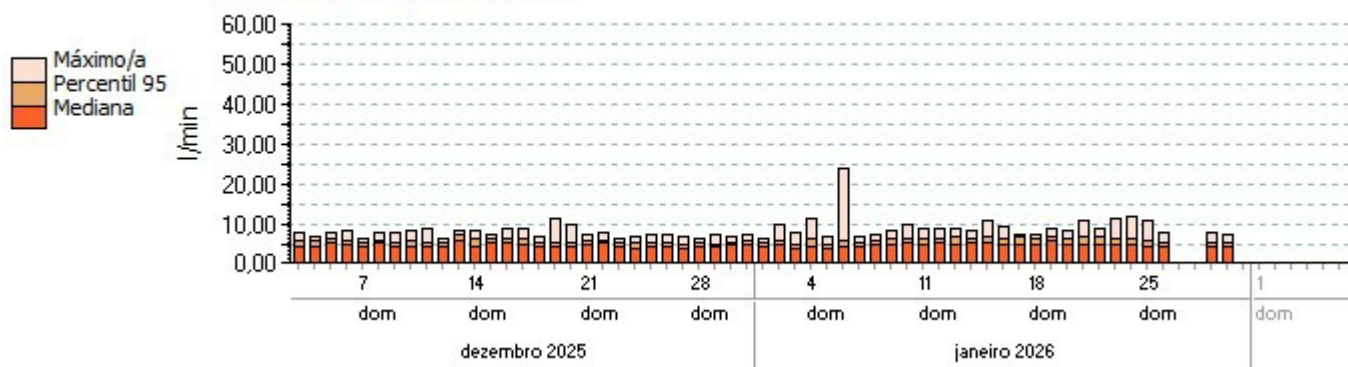


Frequência respiratória

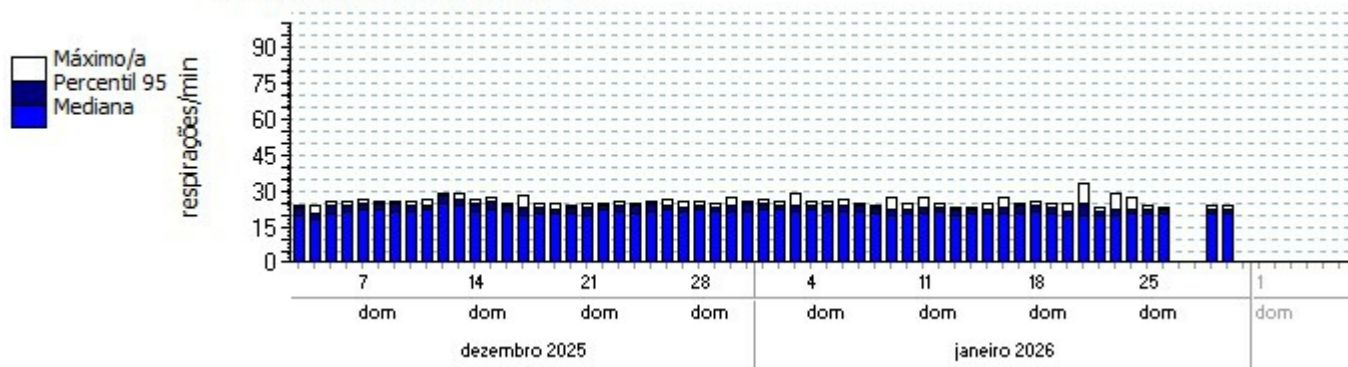


% de respirações espontâneas em ciclo

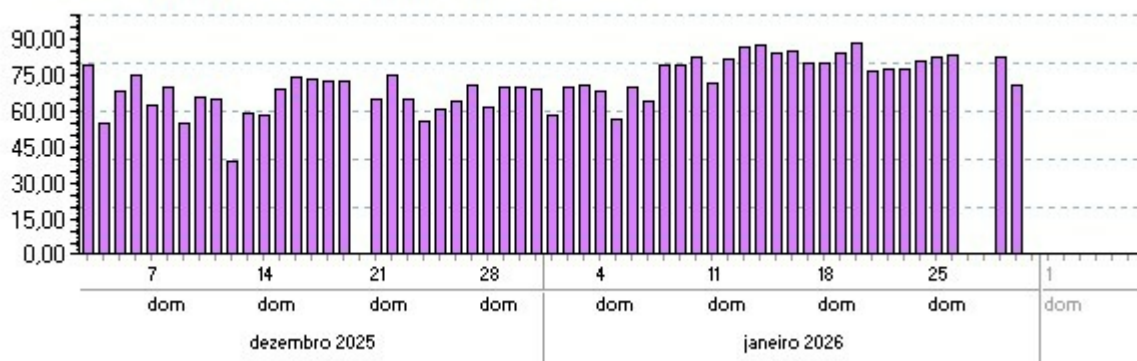


IAH & IA

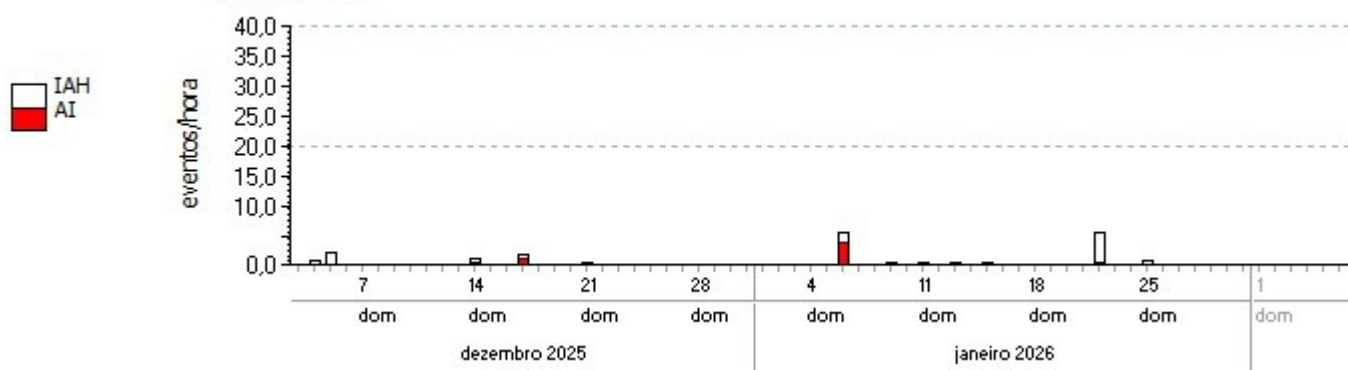

Uso

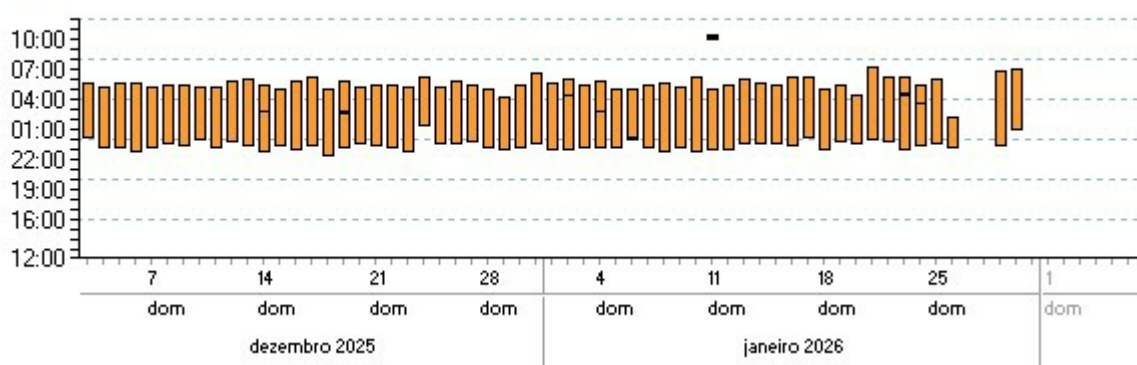

Utilização Total

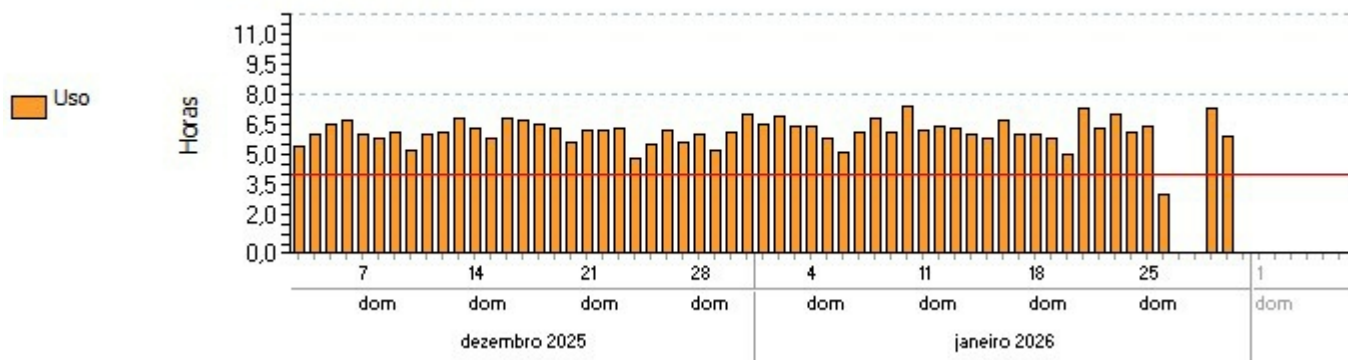

Relação I:E

