

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. RICARDO FAJARDO**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **27 outubro 1956** Idade: **69**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **31/03/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo: 22121495025	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
		Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

13/12/2025 - 11/01/2026

Dispositivo: S9 VPAP Auto (S/N: 22121495025)

Parâmetros do dispositivo

Modo de terapia: **VAuto**

Apoio de pressão: **2,2 cmH2O**

EPAP mín: **10,4 cmH2O**

IPAP máx: **13,0 cmH2O**

IPAP - cmH2O

Mediana: **12,6**

Percentil 95: **12,6**

Máximo/a: **12,6**

EPAP - cmH2O

Mediana: **10,4**

Percentil 95: **10,4**

Máximo/a: **10,4**

Fuga - l/min

Mediana: **80,4**

Percentil 95: **100,2**

Máximo/a: **111,6**

Volume corrente - ml

Mediana: **200**

Percentil 95: **280**

Máximo/a: **370**

Ventilação por minuto - l/min

Mediana: **4,3**

Percentil 95: **5,6**

Máximo/a: **7,5**

Frequência respiratória - respirações/min

Mediana: **21**

Percentil 95: **24**

Máximo/a: **26**

% de respirações espontâneas em ciclo: **70**

Índices respiratórios - eventos/hora

Índice de apneia: **0,0**

Índice de hipopneia: **0,0**

AHI: **0,0**

Obstrutiva: **0,0**

Central: **0,0**

Desconhecida: **0,0**

Utilização Total

Dias de Uso >= 4 horas : **30**

Dias de Uso < 4 horas : **0**

% Dias de Uso >= 4 horas : **100**

Dias de não utilização: **0**

Totalidade de dias: **30**

Horas de utilização: **184:07**

Mediana do uso diário: **6:12**

Média de uso diário: **6:08**

Relação I:E

Mediana: **1:1,45**

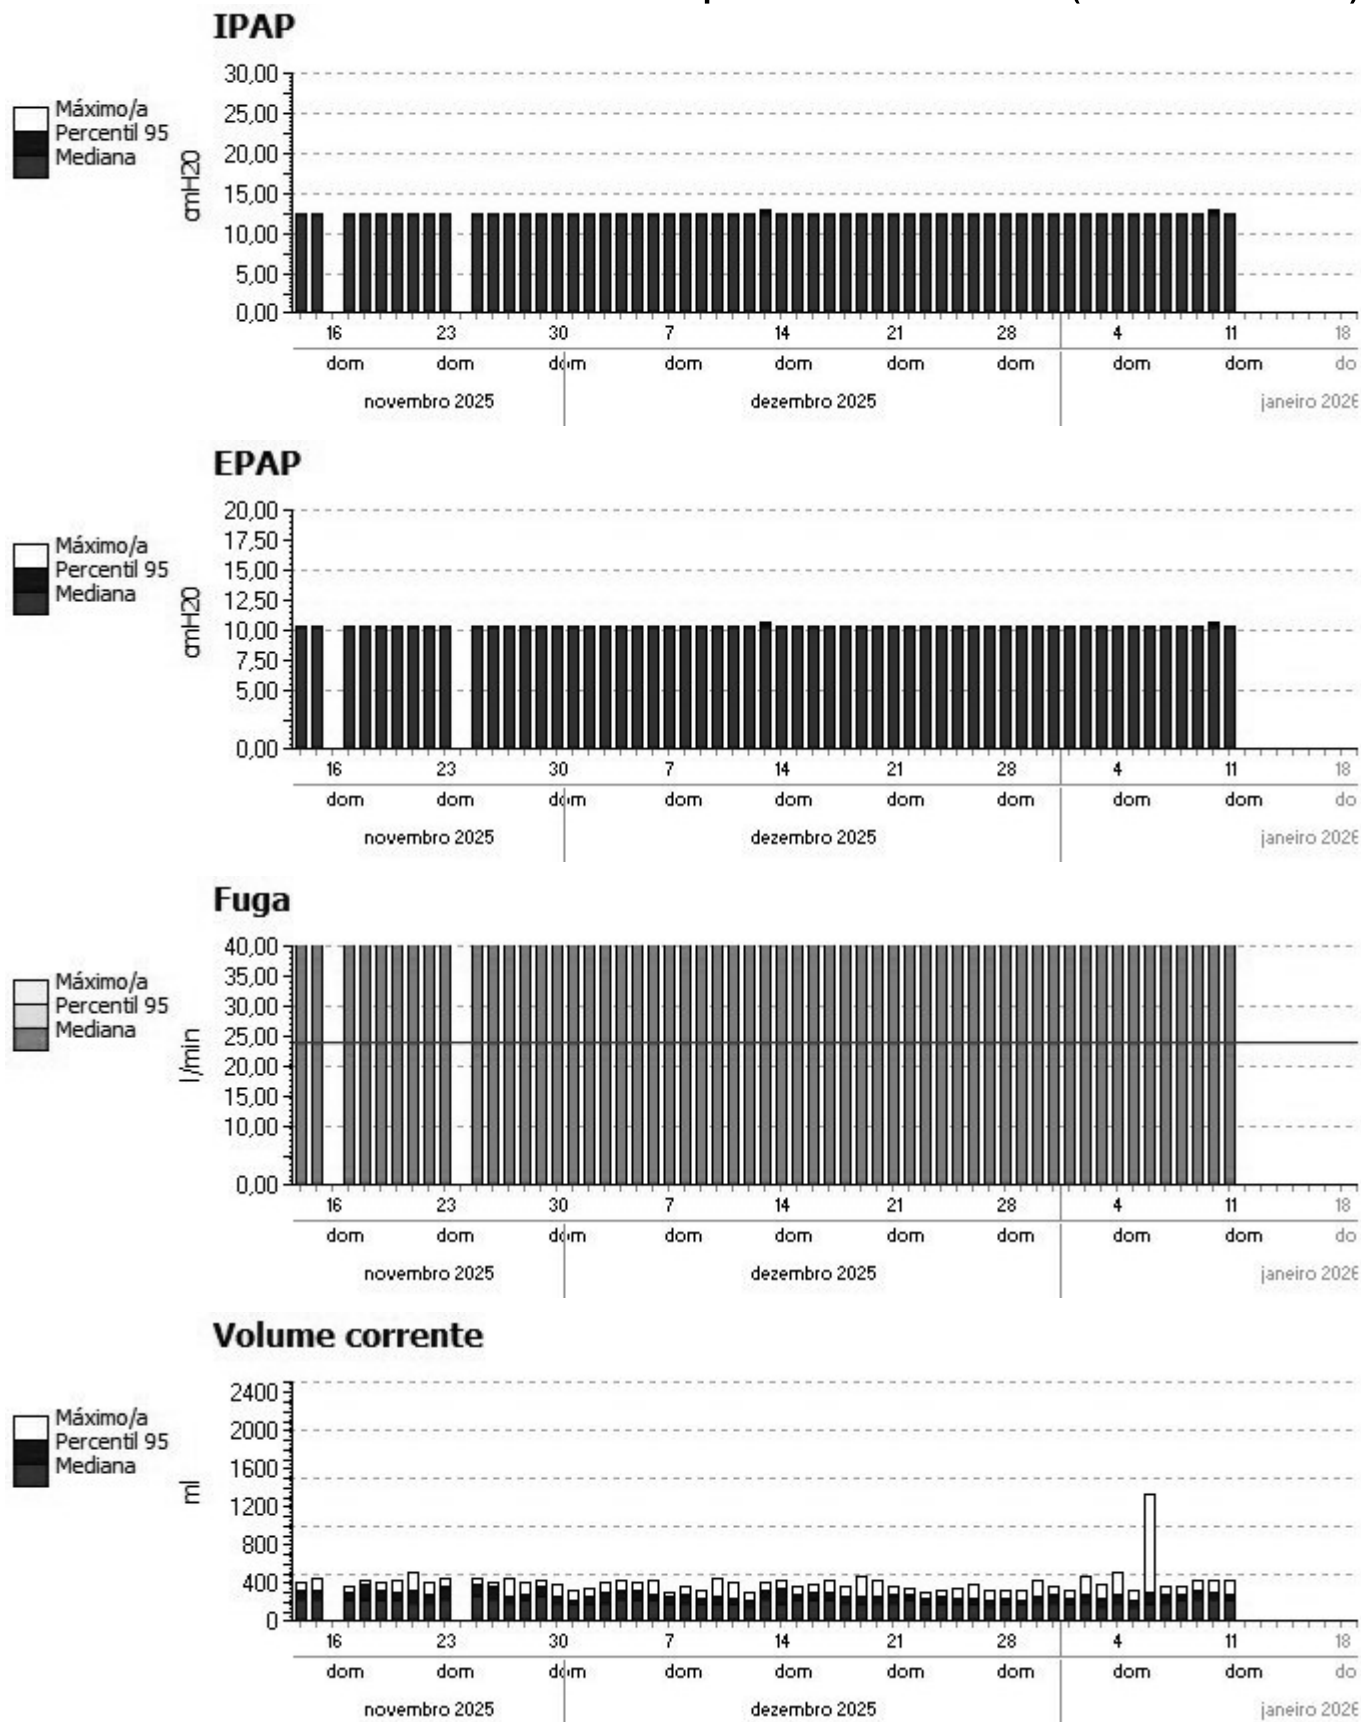
Percentil 95: **1:1,3**

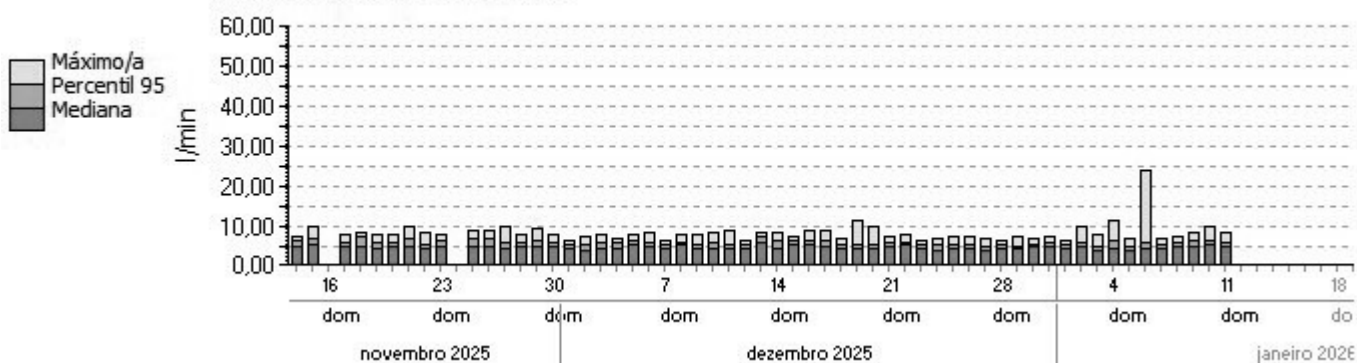
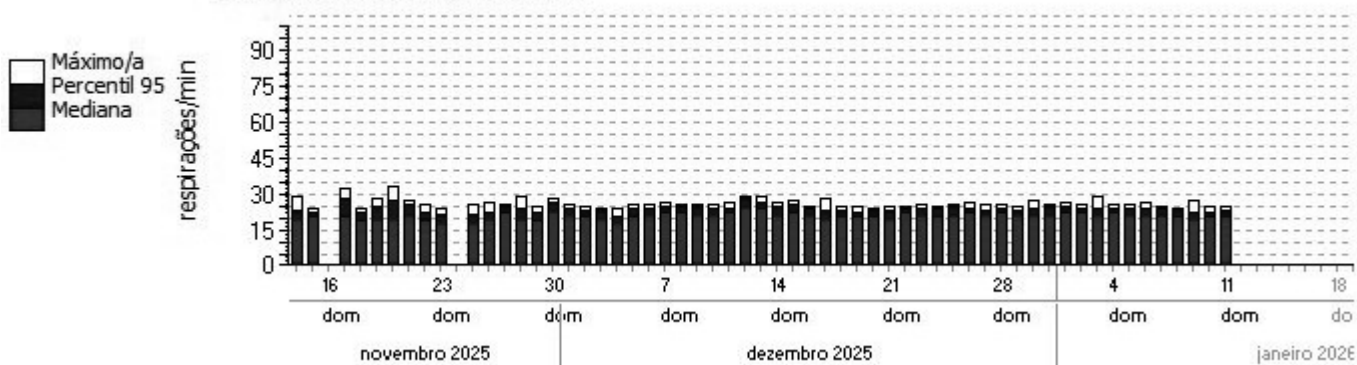
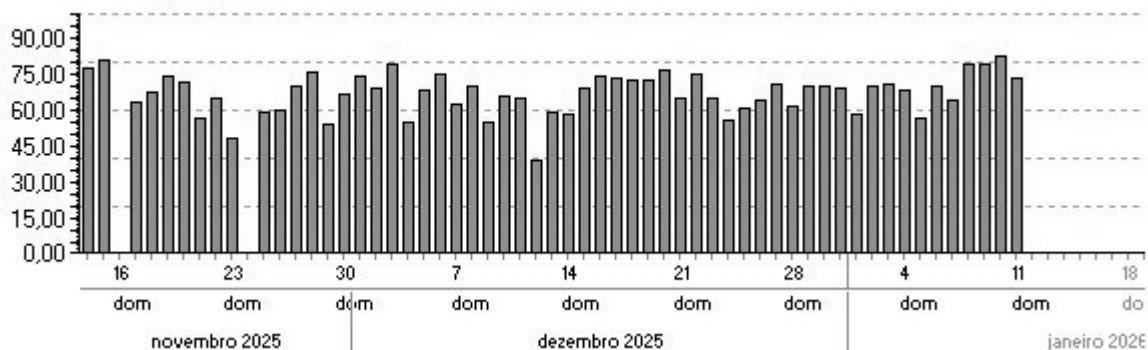
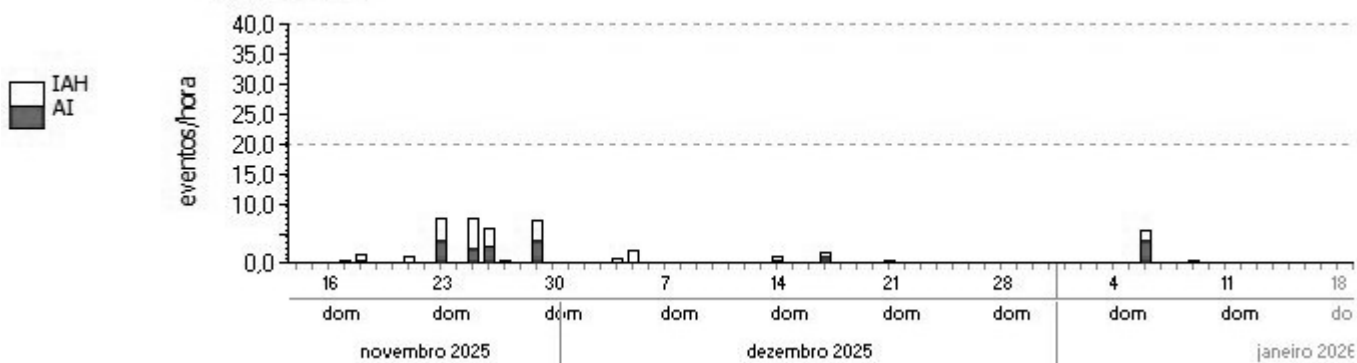
Máximo/a: **1:1,08**

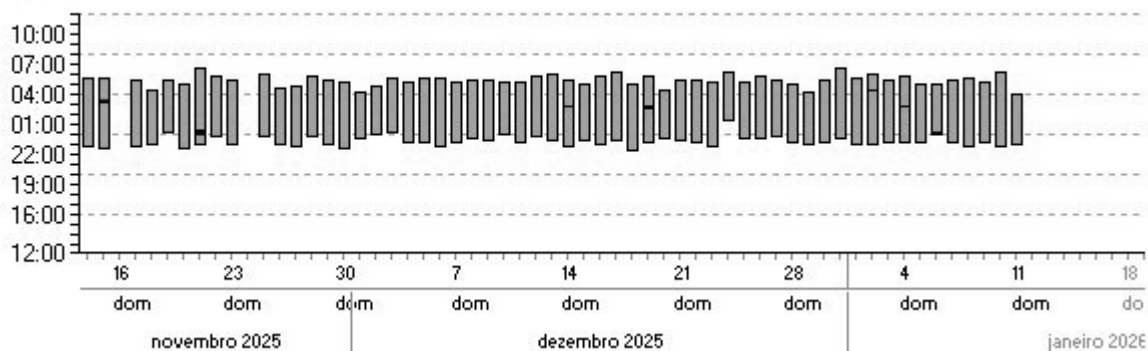
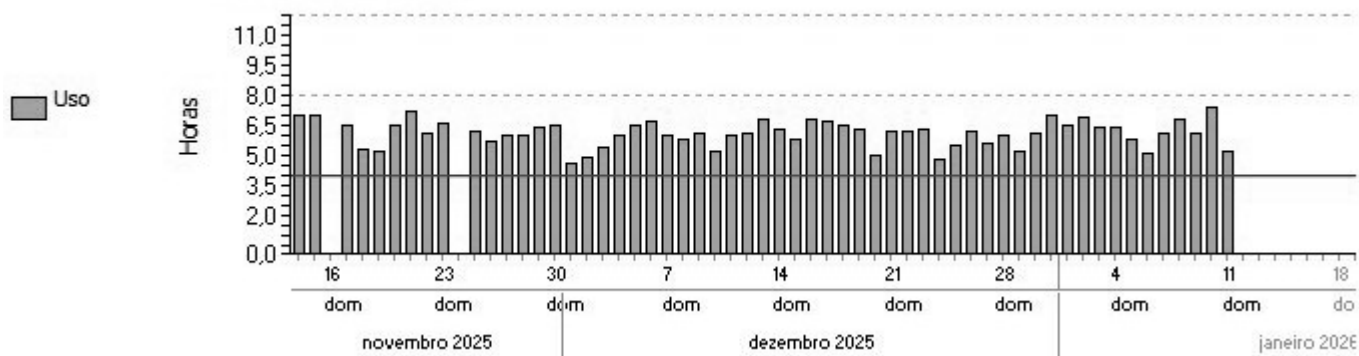
Gráficos em sumário

13/12/2025 - 11/01/2026

Dispositivo: S9 VPAP Auto (S/N: 22121495025)



Ventilação por minuto**Frequência respiratória****% de respirações espontâneas em ciclo****IAH & IA**

Uso**Utilização Total****Relação I:E**