


Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |  | 25/09/2025 - 01/10/2025 |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| Dias de utilização                                           |  | 7/7 dias (100%)         |
| >= 4 horas                                                   |  | 7 dias (100%)           |
| < 4 horas                                                    |  | 0 dias (0%)             |
| Horas de utilização                                          |  | 42 horas 20 minutos     |
| Utilização média (total de dias)                             |  | 6 horas 3 minutos       |
| Utilização média (dias de utilização)                        |  | 6 horas 3 minutos       |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |  | 6 horas 1 minutos       |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 01/10/2025) |  | 3,966 horas             |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22222292587 |
| Modo                | AutoSet     |
| Pressão mín.        | 6 cmH2O     |
| Pressão máx.        | 9.4 cmH2O   |
| EPR                 | Desl.       |
| Resposta            | Suave       |

| Terapia                                            |          |     |                 |      |                |      |
|----------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|------|----------------|------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: | 9.0 | Percentil 95.º: | 9.7  | Máximo:        | 9.7  |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: | 1.2 | Percentil 95.º: | 18.7 | Máximo:        | 28.1 |
| Eventos por hora                                   | IA:      | 0.9 | IH:             | 0.6  | IAH:           | 1.5  |
| Índice de apneia                                   | Central: | 0.6 | Obstrutiva:     | 0.1  | Desconhecid    | 0.1  |
| Índice RERA                                        |          |     |                 |      |                | 0.6  |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |          |     |                 |      | 0 minutos (0%) |      |

Horas de utilização

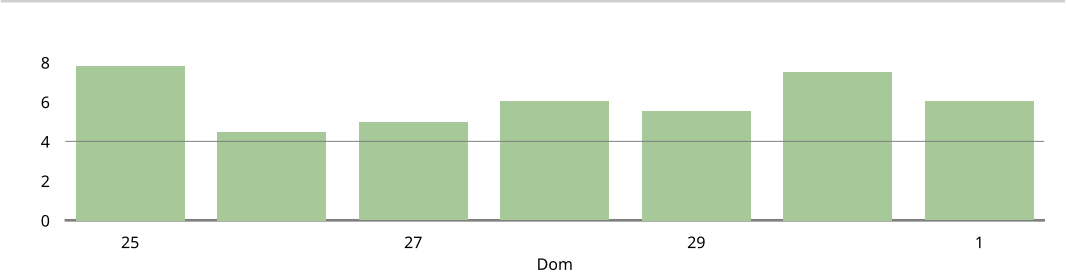


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292587


## Utilização (horas)

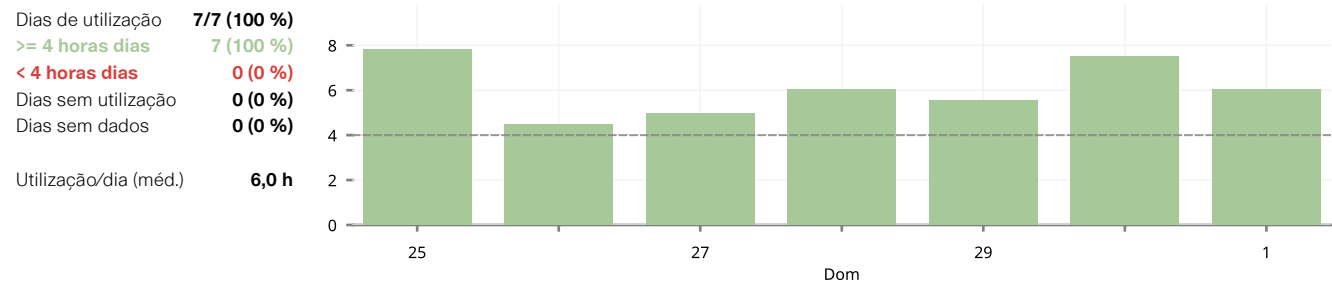

## Fuga (l/min)

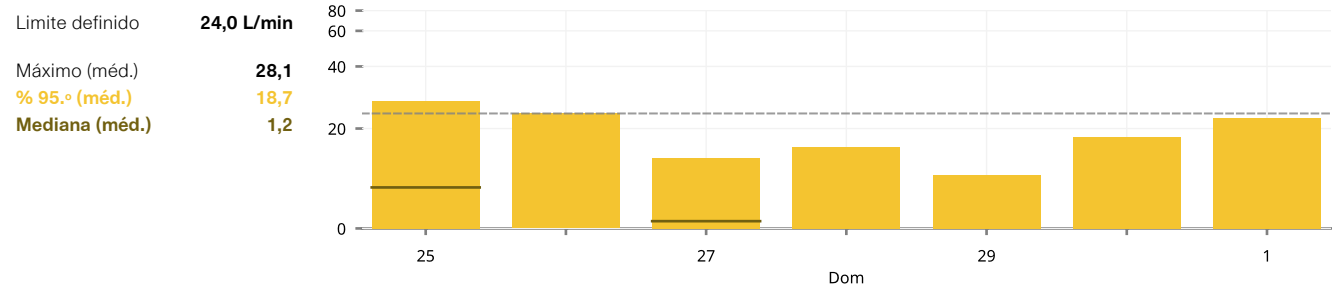

## Pressão (cmH2O)

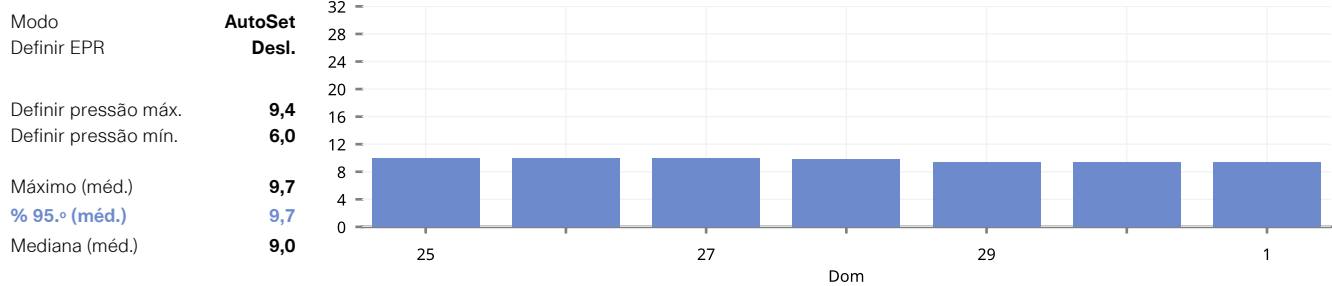

## IAH (eventos/hora)

