


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/10/2025 - 15/10/2025
Dias de utilização	10/13 dias (77%)	
>= 4 horas	8 dias (62%)	
< 4 horas	2 dias (15%)	
Horas de utilização	58 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 1 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/10/2025)	4,028 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292587
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 12.4	Máximo: 21.4	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.4	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

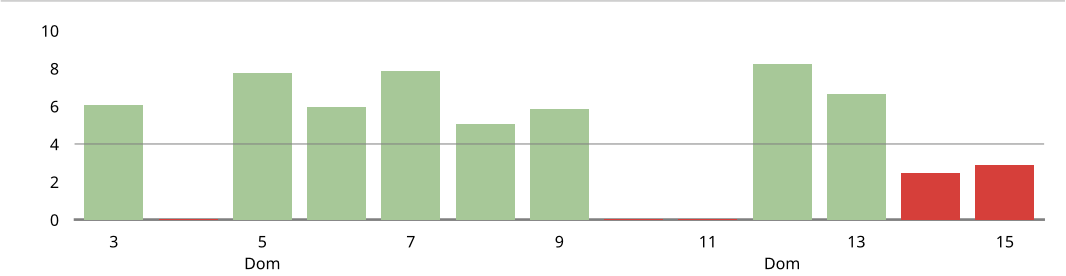


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292587


Utilização (horas)

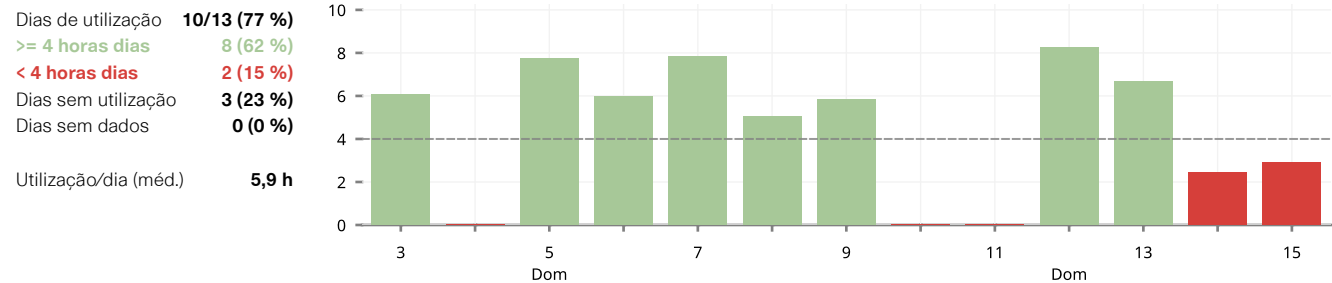

Fuga (l/min)

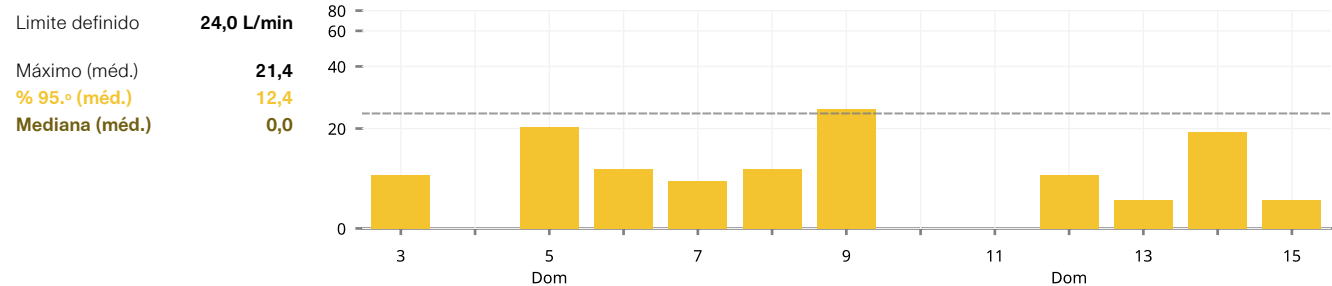

Pressão (cmH2O)

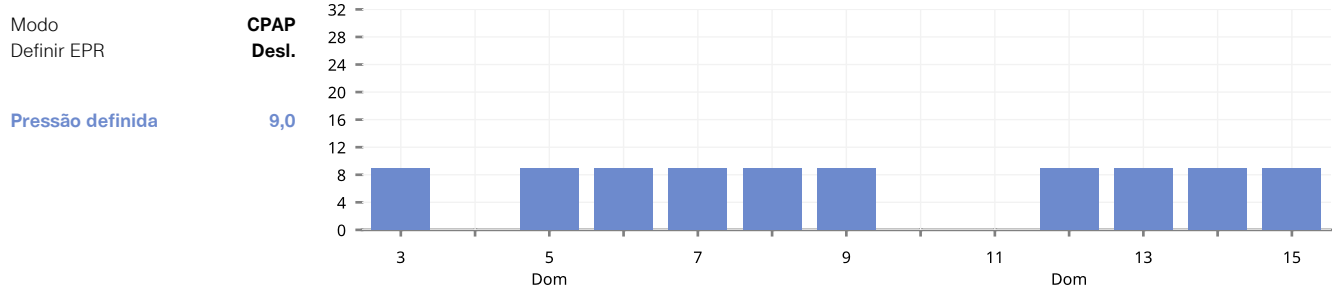

IAH (eventos/hora)

