


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/10/2025 - 07/10/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	48 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 0 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 0 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/10/2025)	5,388 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291736
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 9.7	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 13.5	Máximo: 24.2	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.2	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

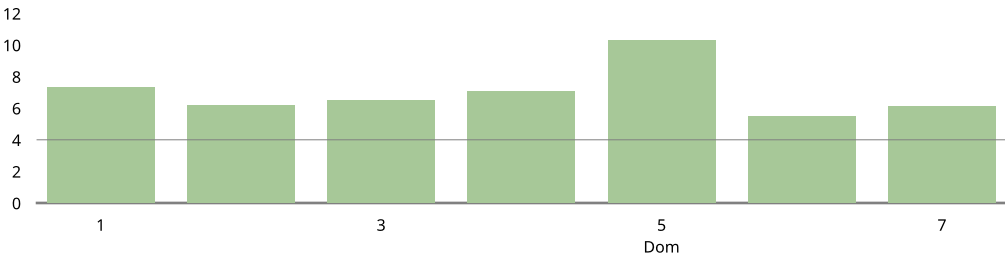


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291736


Utilização (horas)

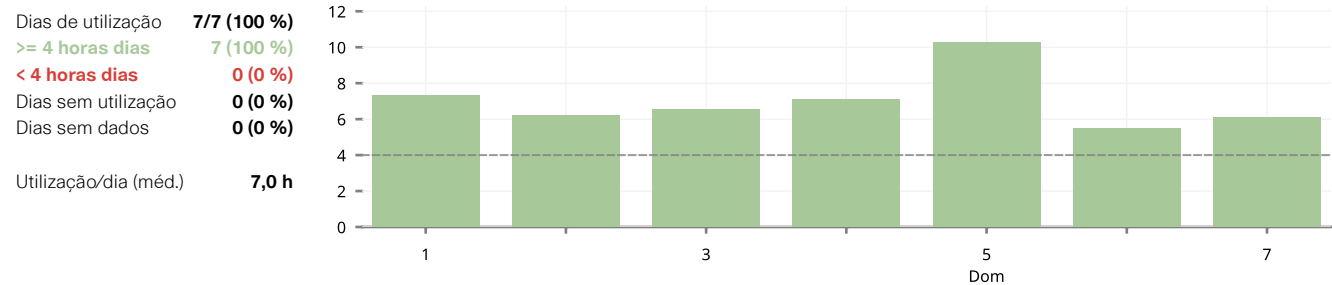

Fuga (l/min)

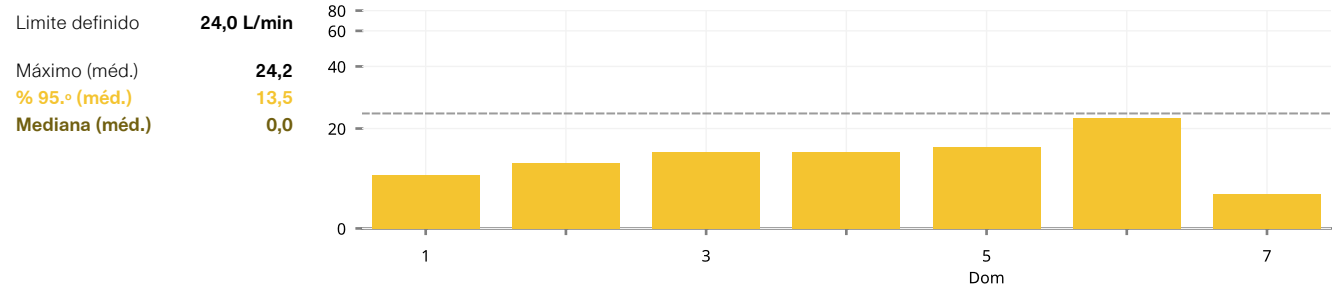

Pressão (cmH2O)

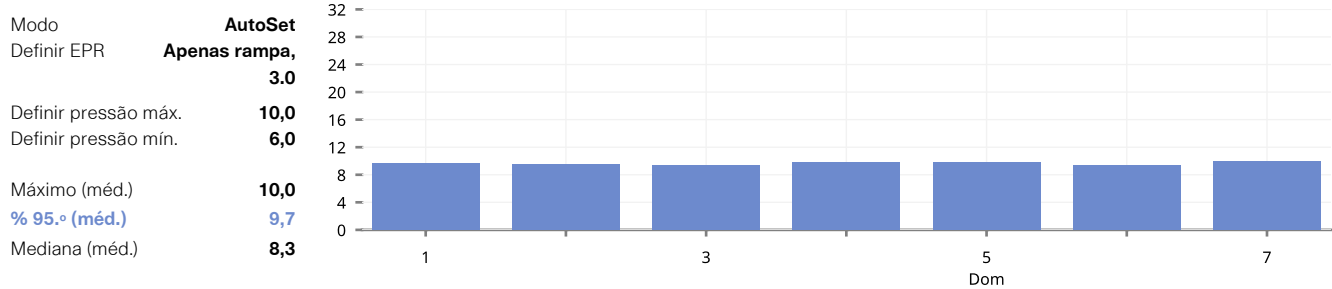

IAH (eventos/hora)

