



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Eduardo Guedes de Araújo

SOLICITADO POR: Dra. Ana Cláudia Matos e Faria

DATA: 28/09/2025

IDADE: 51 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 6h06min, com duração do registro do fluxo durante 5h54min e a avaliação da saturação de O₂ durante 5h56min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 13,4/hora, sendo 0,7 apneia/hora e 12,7 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 19,7 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 97%, sendo a **média** de 93 e a **mínima** de 82%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 54; **máxima**: 101 bpm.

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).

CONCLUSÃO:

Registro de aumento leve do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (13,4/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de dessaturações da oxi-hemoglobina, sendo várias acentuadas (**índice de dessaturação de oxigênio**: 19,7).

Registraram-se 4855 episódios respiratórios, sendo 13,7 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 2491 eventos de ronco (422 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

28/09/2025

Guedes Araujo, Eduardo

Data de nascimento: 13/12/1973

Idade: 51

Gênero: Sexo masculino

IMC: 32.4

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação

28/09/2025

Dispositivo	ApneaLink Air		Tipo:	III
Gravação	Início: 12:50am	Fim: 6:57am	Duração - h:	6:06
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 1:00am	Fim: 6:55am	Duração - h:	5:54
Avaliação saturação O2	Início: 1:00am	Fim: 6:57am	Duração - h:	5:56


Estatísticas

				
Índice de eventos	IER (IAH):	13.4	IA:	0.7
			IH:	12.7
Supina	Tempo - h	3:16	Porcentagem:	55.4
	IER (IAH):	15.0	IA:	0.6
			IH:	14.3
Não-supina	Tempo - h	2:35	Porcentagem:	43.9
	IER (IAH):	11.6	IA:	0.8
			IH:	10.8
Em pé	Tempo - h	0:02	Porcentagem:	0.7
	IER (IAH):	0.0	IA:	0.0
			IH:	0.0
Eventos totais	Apneias:	4	Hipopneias:	75
AI	Obstrutiva:	0.5	Central:	0.2
	Mista:	0.0	Não classificado:	0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h:	0:00	Porcentagem:	0
Dessaturação de oxigênio	IDO:	19.7	Total:	117
% Saturação de oxigênio	Valor inicial:	97	Média:	93
			Mais baixo:	82
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%:	7	Sat. <=85%:	1
	Sat. <=80%:	0	Sat. <=88%:	2
	Tempo<=88%-h:	0:08		
Respirações	Total:	4855	Média/minuto:	13.7
			Ronco:	2491
Pulso - bpm	Mín.:	54	Média:	66
			Máx.:	101

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

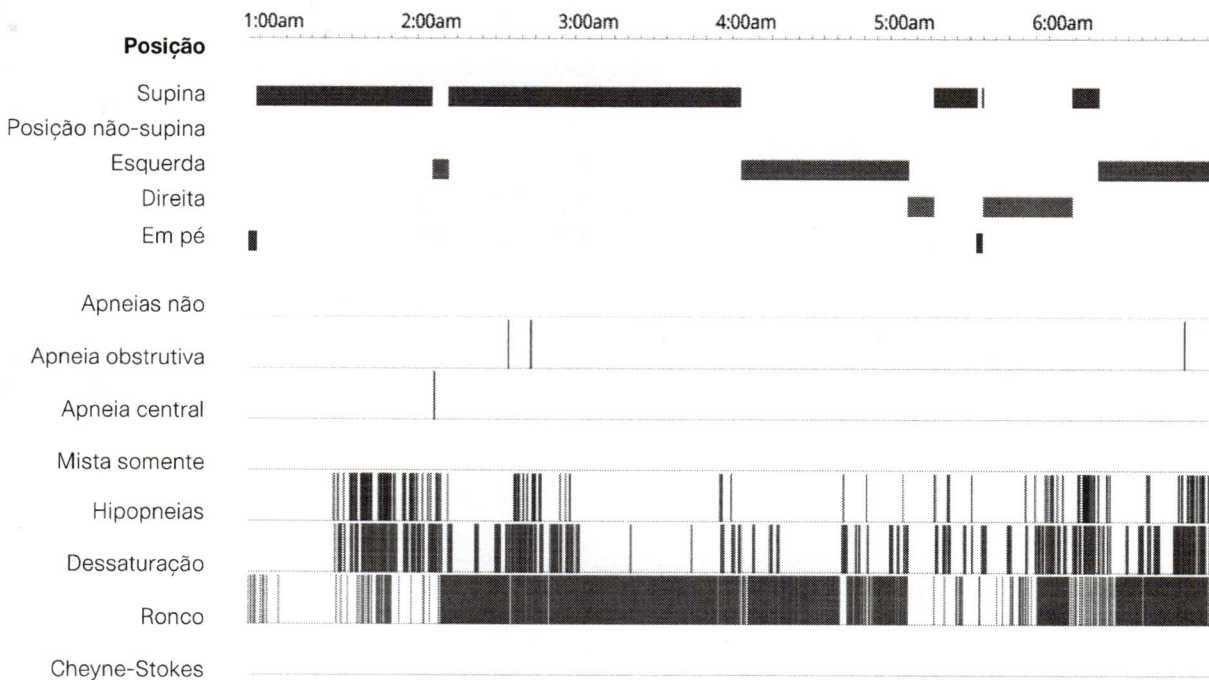


Saturação de

(%)

Valor inicial 97

Média 93

Mais baixo 82

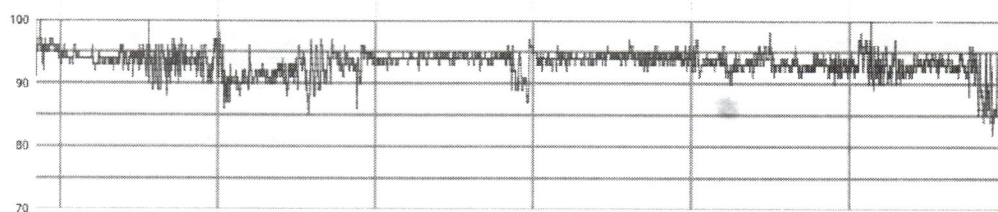

Pulso (bpm)

Mín. 54

Média 66

Máx. 101

