


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/09/2025 - 05/10/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	46 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/10/2025)	3,482 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653877
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.8	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 15.4	Máximo: 28.6	
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 0.5	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

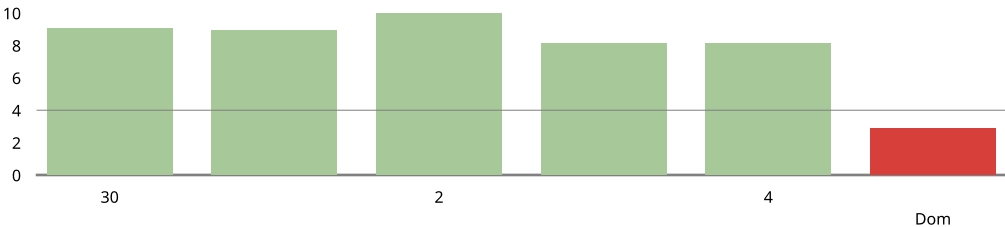

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653877

Utilização (horas)


Dias de utilização**6/6 (100 %)**
>= 4 horas dias**5 (83 %)**
< 4 horas dias**1 (17 %)**
Dias sem utilização**0 (0 %)**
Dias sem dados**0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.)**7,8 h**

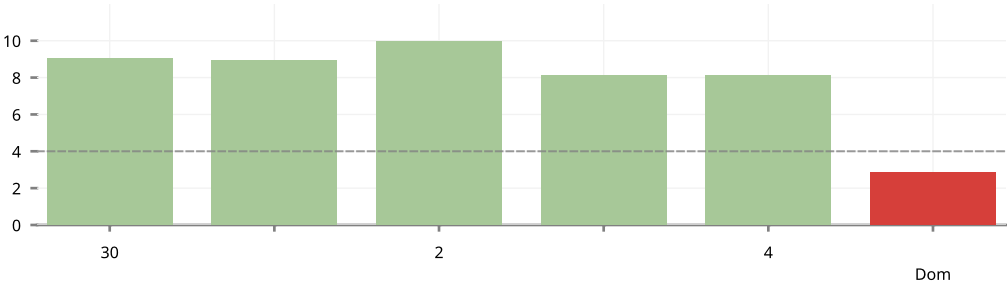

Fuga (l/min)


Limite definido**24,0 L/min**
Máximo (méd.)**28,6**
% 95.º (méd.)**15,4**
Mediana (méd.)**0,4**

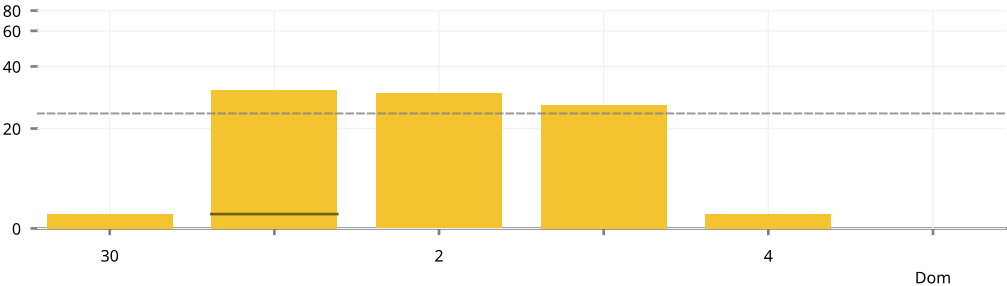

Pressão (cmH2O)

Modo**AutoSet**
Definir EPR**Apenas rampa,**
1,0
Definir pressão máx.**10,0**
Definir pressão mín.**4,0**

Máximo (méd.)**9,9**
% 95.º (méd.)**9,8**
Mediana (méd.)**7,8**

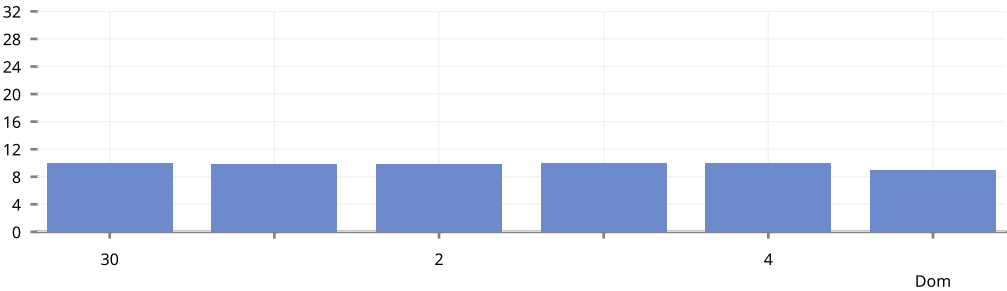

IAH (eventos/hora)

IAH ☐**2.1**
IH ☐**0.5**
IA ☐**1.6**
IAC**1,0**
IAO**0,5**
IAD**0,1**
RERA**0,2**
%RCS (méd.)**0.0**

