


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/10/2025 - 13/10/2025
Dias de utilização	5/7 dias (71%)	
>= 4 horas	5 dias (71%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	30 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 23 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/10/2025)	3,521 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653877
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.1	Percentil 95.º: 32.6	Máximo: 45.6	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.5	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

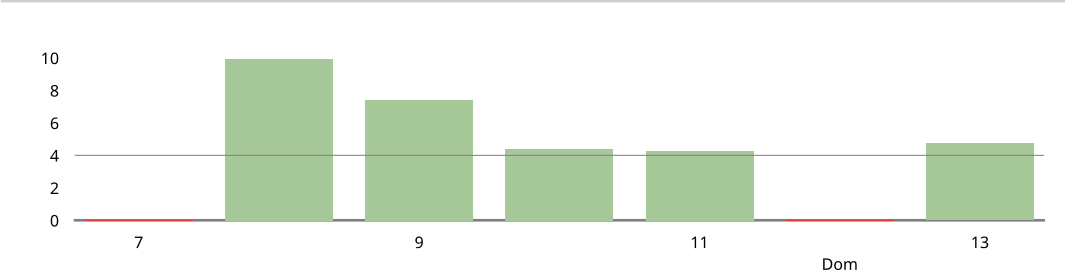


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653877


Utilização (horas)

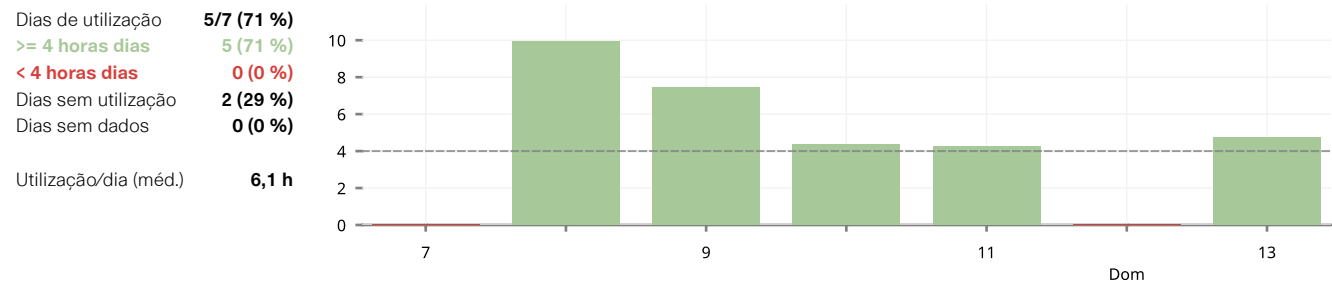

Fuga (l/min)

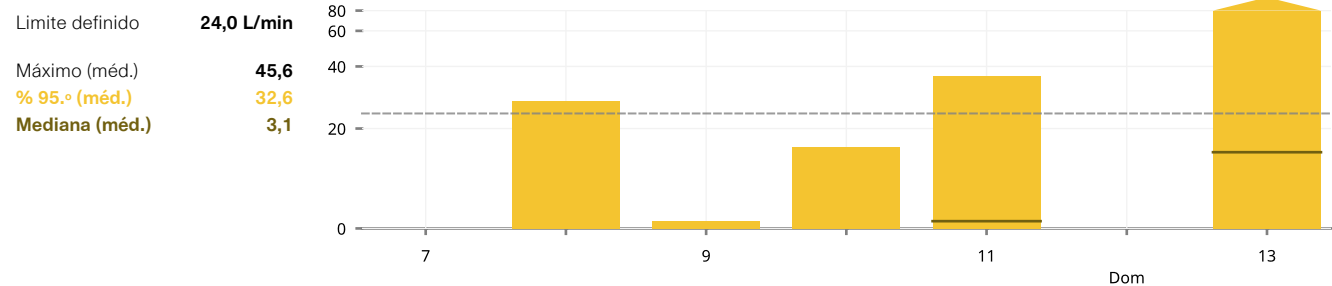

Pressão (cmH2O)

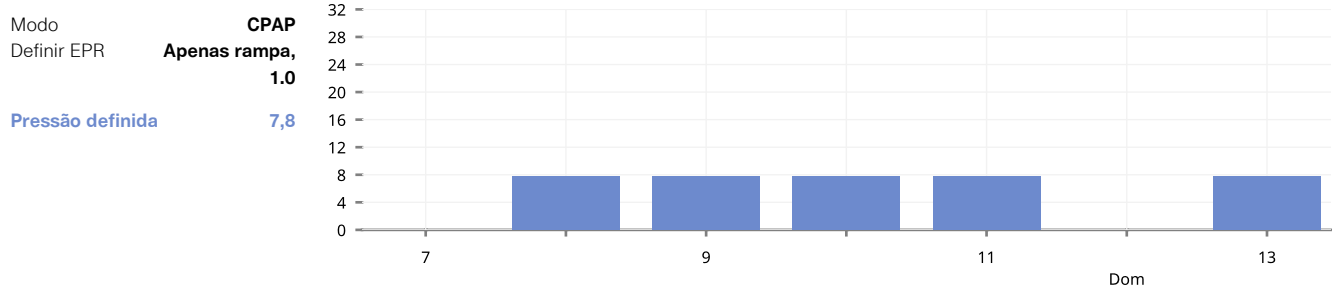

IAH (eventos/hora)

