


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/10/2025 - 12/10/2025
Dias de utilização		6/7 dias (86%)
>= 4 horas		4 dias (57%)
< 4 horas		2 dias (29%)
Horas de utilização		36 horas 8 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 10 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 1 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 8 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/10/2025)		3,675 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.5	
Fugas — l/min	Mediana: 23.8	Percentil 95.º: 39.0	Máximo: 86.2	
Eventos por hora	IA: 22.5	IH: 0.7	IAH: 23.2	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 3.0	Desconhecid	18.5
Índice RERA				0.6
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				9 minutos (3%)

Horas de utilização

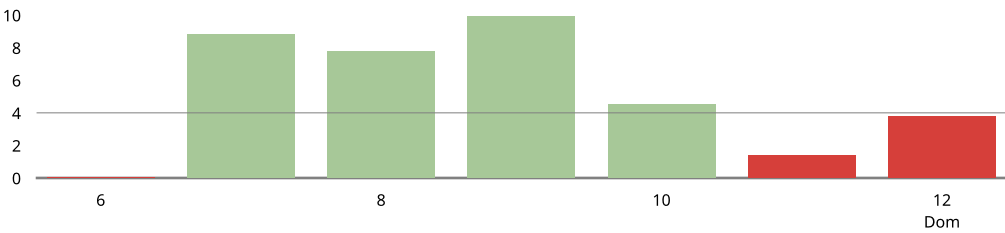

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573

Utilização (horas)

Dias de utilização
6/7 (86 %)
≥ 4 horas dias
4 (57 %)
< 4 horas dias
2 (29 %)
Dias sem utilização
0 (0 %)
Dias sem dados
1 (14 %)


Utilização/dia (méd.)
6,0 h

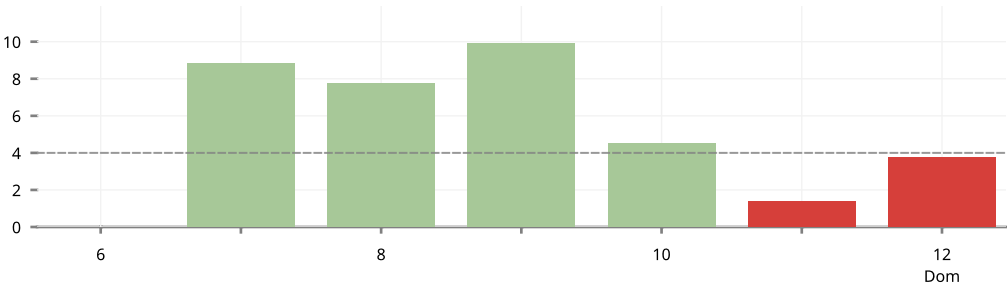

Fuga (l/min)

Limite definido
24,0 L/min

Máximo (méd.)
86,2
% 95.º (méd.)
39,0
Mediana (méd.)
23,8

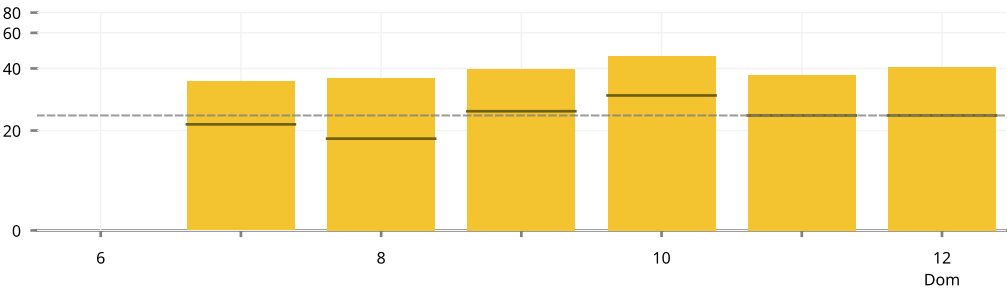


Pressão (cmH2O)

Modo
Definir EPR
Definir pressão máx.
Definir pressão mín.

Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

AutoSet
Apenas rampa,
1.0
10,0
5,0

9,5
8,9
7,1

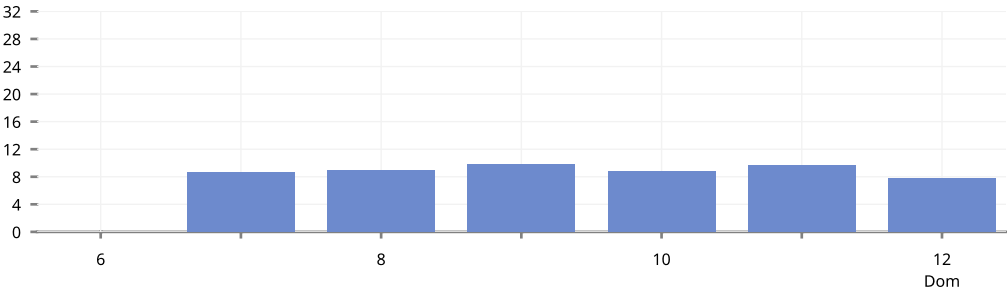

IAH (eventos/hora)

IAH
IH
IA

IAC
IAO
IAD
RERA
%RCS (méd.)

23.2
0.7
22.5

1,0
3,0
18,5
0,6
2.8

