


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/10/2025 - 13/10/2025
Dias de utilização		4/6 dias (67%)
>= 4 horas		2 dias (33%)
< 4 horas		2 dias (33%)
Horas de utilização		18 horas 36 minutos
Utilização média (total de dias)		3 horas 6 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 39 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 21 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/10/2025)		1,834 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	16 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.4	Percentil 95.º: 13.7	Máximo: 14.7	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 9.3	Máximo: 23.4	
Eventos por hora	IA: 2.2	IH: 3.1	IAH: 5.3	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 2.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

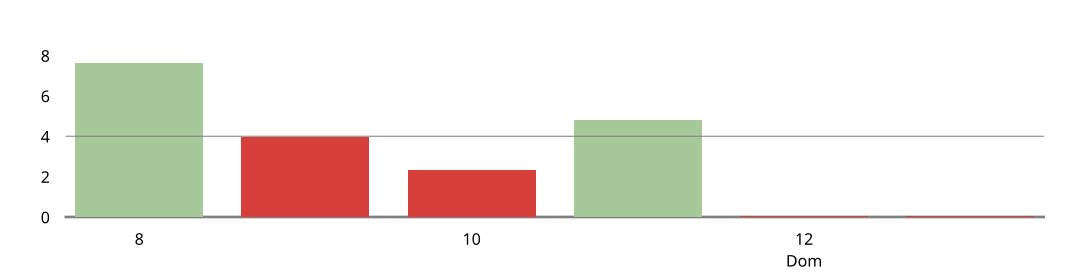


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)

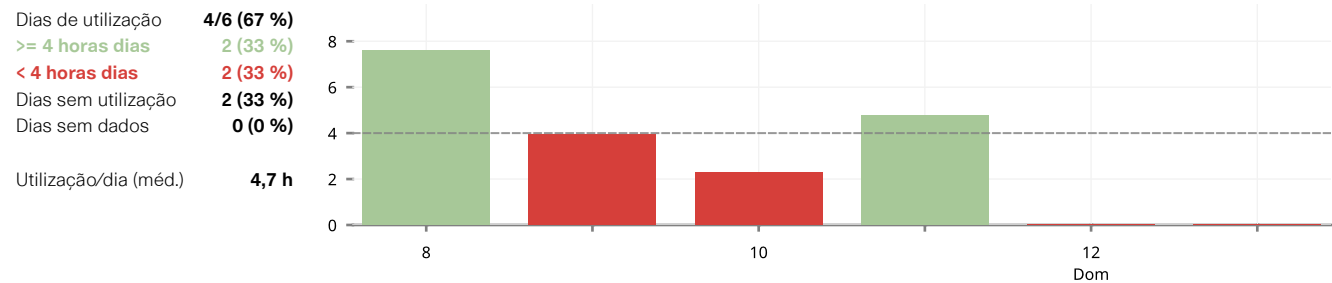

Fuga (l/min)

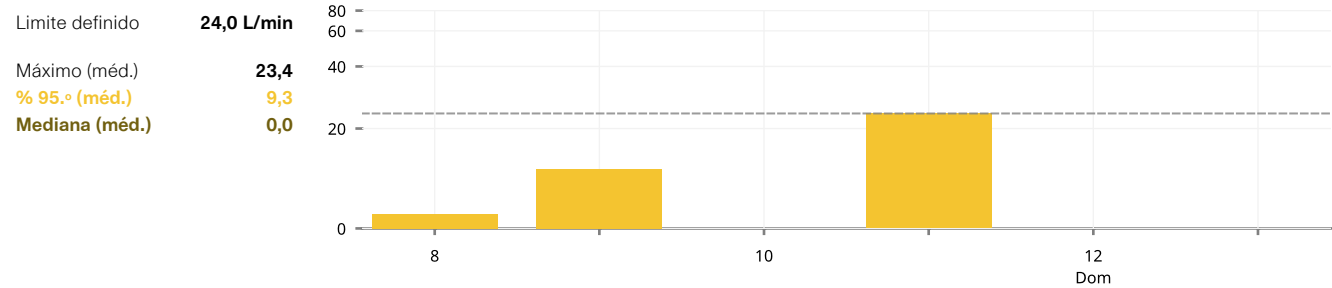

Pressão (cmH2O)

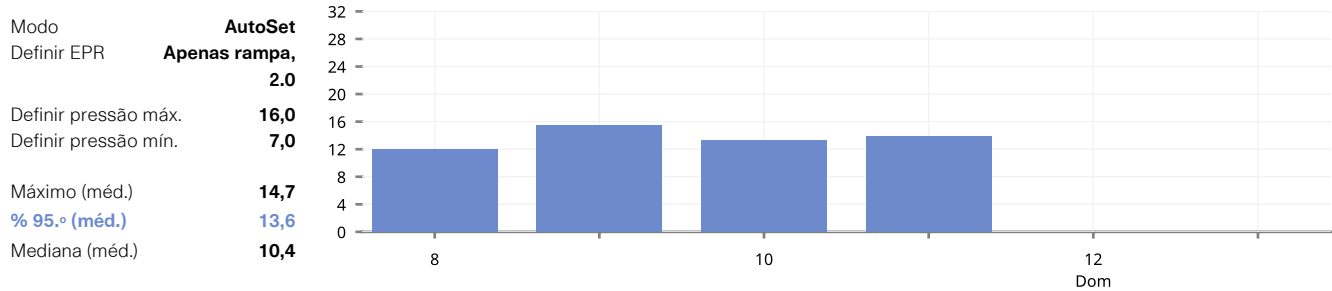

IAH (eventos/hora)

