


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |  | 08/10/2025 - 16/10/2025 |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| Dias de utilização                                           |  | 7/9 dias (78%)          |
| >= 4 horas                                                   |  | 4 dias (44%)            |
| < 4 horas                                                    |  | 3 dias (33%)            |
| Horas de utilização                                          |  | 26 horas 51 minutos     |
| Utilização média (total de dias)                             |  | 2 horas 59 minutos      |
| Utilização média (dias de utilização)                        |  | 3 horas 50 minutos      |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      |  | 4 horas 42 minutos      |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 16/10/2025) |  | 2,774 horas             |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22231024667  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 4 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 10 cmH2O     |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |              |                      |              |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 5.7 | Percentil 95.º: 7.5  | Máximo: 8.4  |                |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 1.9 | Percentil 95.º: 13.7 | Máximo: 39.6 |                |
| Eventos por hora                                   | IA: 2.8      | IH: 0.7              | IAH: 3.5     |                |
| Índice de apneia                                   | Central: 2.2 | Obstrutiva: 0.4      | Desconhecid  | 0.2            |
| Índice RERA                                        |              |                      |              | 0.2            |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |              |                      |              | 0 minutos (0%) |

## Horas de utilização

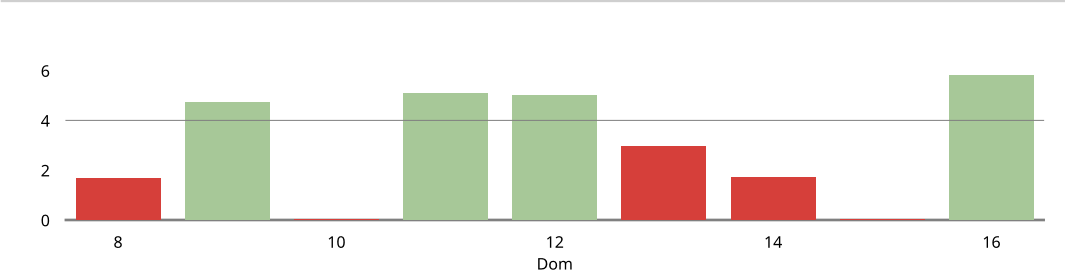


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667


## Utilização (horas)

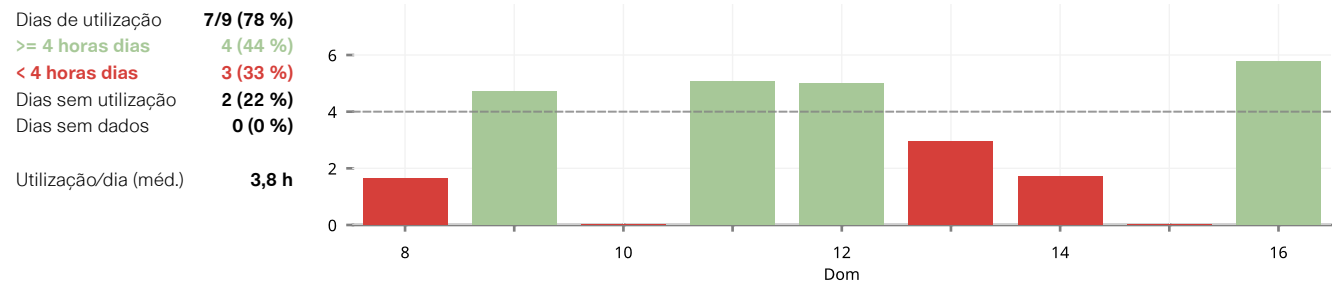

## Fuga (l/min)

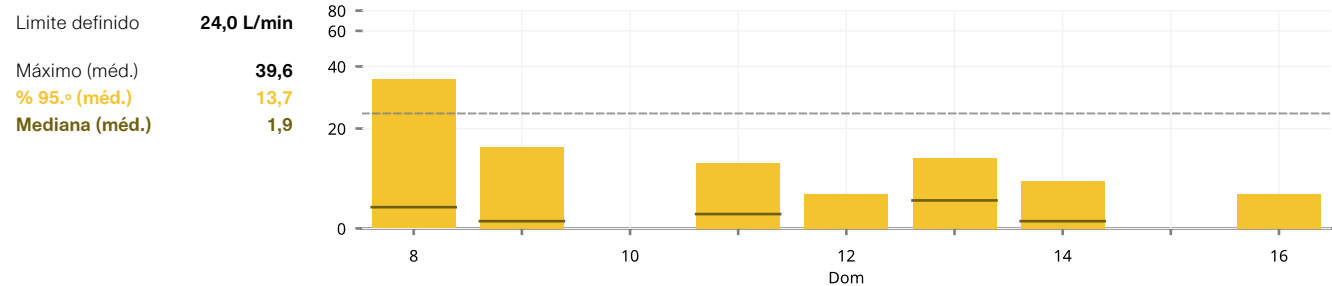

## Pressão (cmH2O)

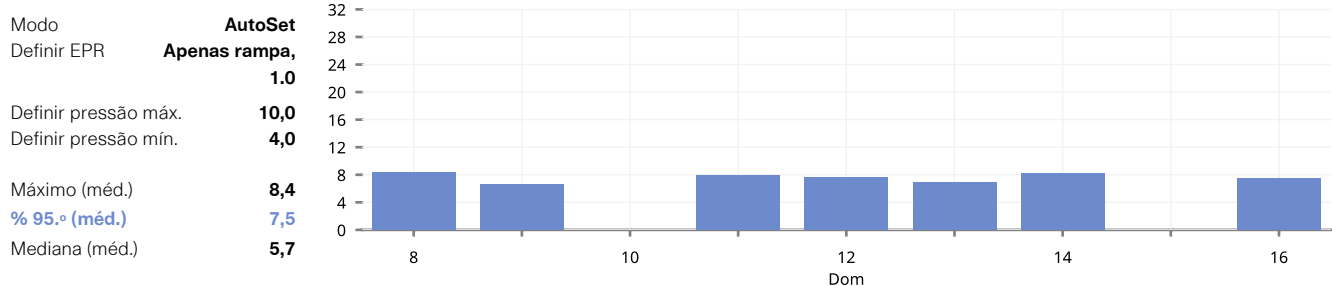

## IAH (eventos/hora)

