


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/10/2025 - 27/10/2025
Dias de utilização		11/11 dias (100%)
>= 4 horas		11 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		76 horas 44 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 59 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 59 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 37 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/10/2025)		2,806 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 12.0	Percentil 95.º: 13.3	Máximo: 13.3	
Fugas — l/min	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 26.4	Máximo: 36.8	
Eventos por hora	IA: 9.4	IH: 1.7	IAH: 11.1	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 8.2	Desconhecid	1.2
Índice RERA	1.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

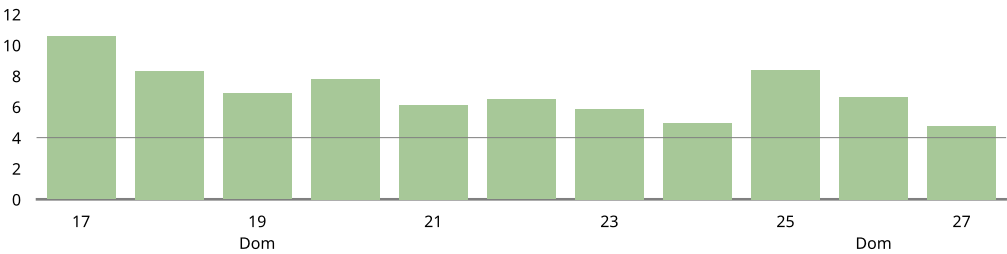


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611


Utilização (horas)

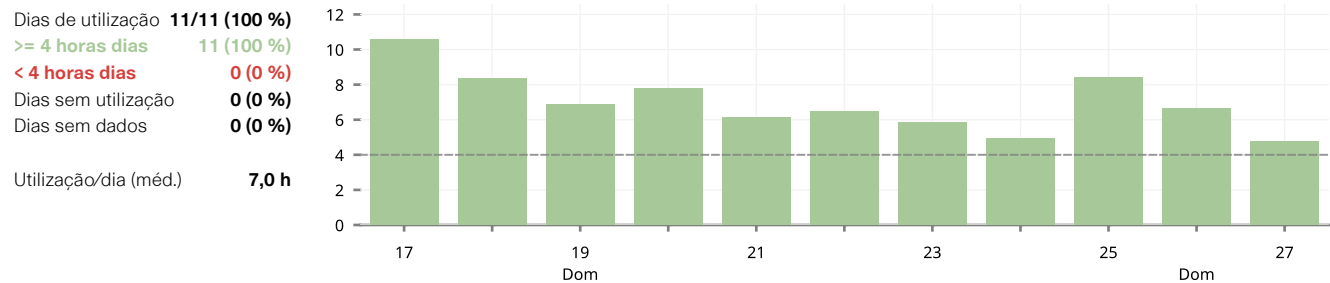

Fuga (l/min)

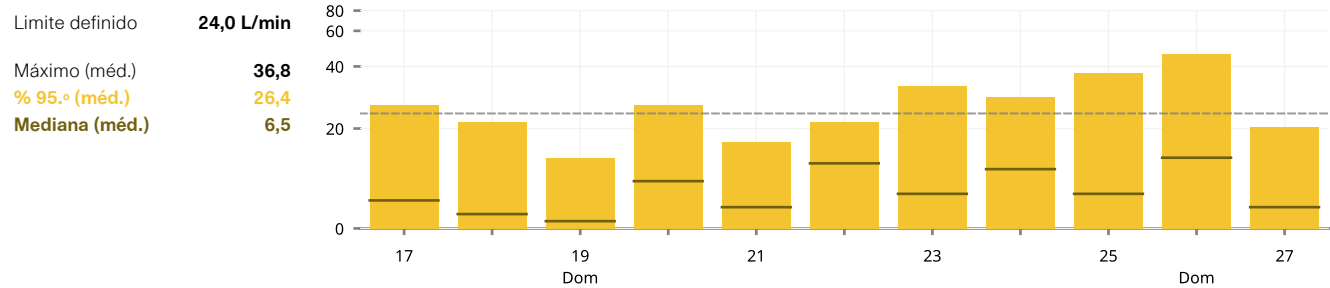

Pressão (cmH2O)

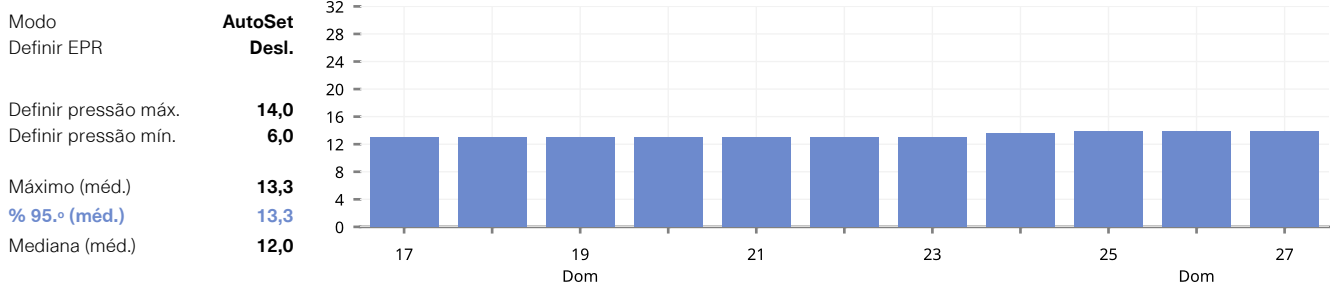

IAH (eventos/hora)

