


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/10/2025 - 28/10/2025
Dias de utilização		1/1 dias (100%)
>= 4 horas		1 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		5 horas 59 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 59 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 59 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 59 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/10/2025)		2,812 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.9	Percentil 95.º: 13.9	Máximo: 13.9	
Fugas — l/min	Mediana: 7.2	Percentil 95.º: 37.2	Máximo: 44.4	
Eventos por hora	IA: 4.6	IH: 1.5	IAH: 6.1	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 4.5	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

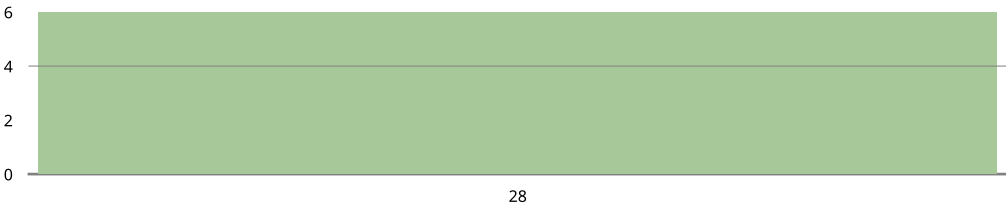


Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611


Utilização (horas)

Dias de utilização	1/1 (100 %)
>= 4 horas dias	1 (100 %)
< 4 horas dias	0 (0 %)
Dias sem utilização	0 (0 %)
Dias sem dados	0 (0 %)
Utilização/dia (méd.)	6,0 h

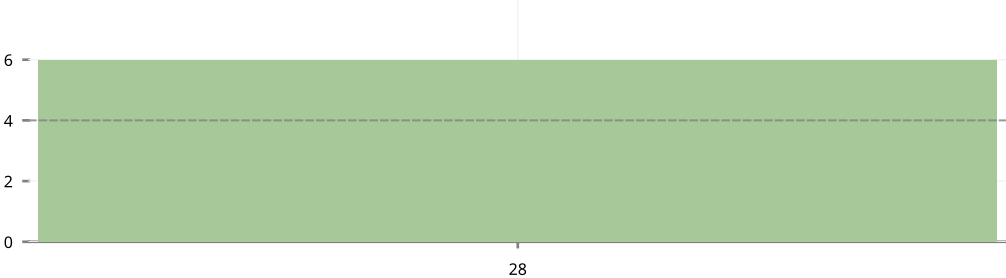


Fuga (l/min)

Limite definido	24,0 L/min
Máximo (méd.)	44,4
% 95.º (méd.)	37,2
Mediana (méd.)	7,2

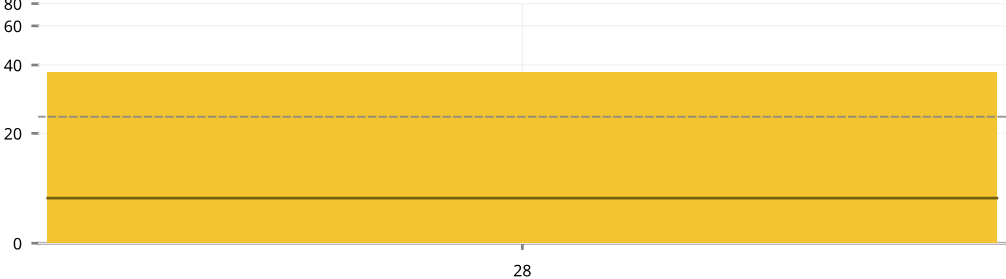

Pressão (cmH2O)

Modo	AutoSet
Definir EPR	Desl.
Definir pressão máx.	14,0
Definir pressão mín.	6,0
Máximo (méd.)	13,9
% 95.º (méd.)	13,9
Mediana (méd.)	11,9

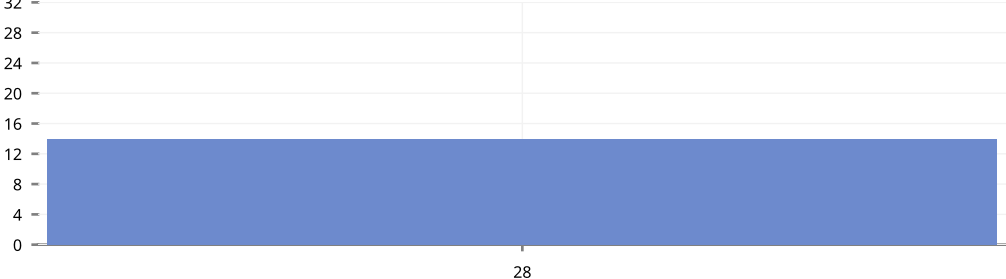

IAH (eventos/hora)

IAH	6.1
IH	1.5
IA	4.6
IAC	0.0
IAO	4.5
IAD	0.1
RERA	0.5
%RCS (méd.)	0.0

