


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/11/2025 - 10/12/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	196 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 33 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/12/2025)	3,569 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024644
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.3	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 10.8	
Fugas — l/min	Mediana: 14.6	Percentil 95.º: 28.9	Máximo: 39.4	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.7	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

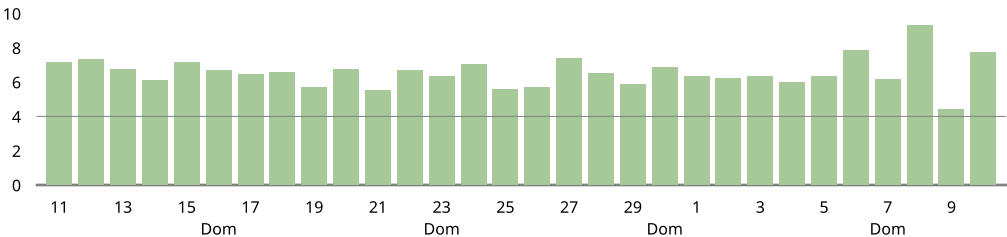


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024644


Utilização (horas)

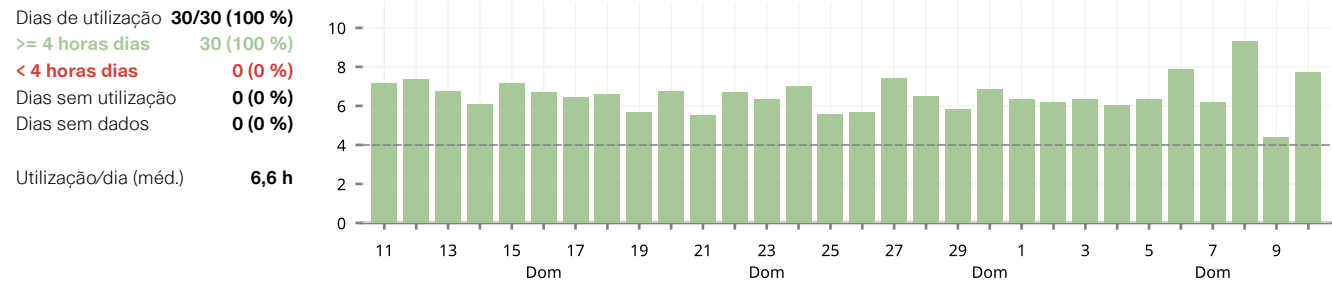

Fuga (l/min)

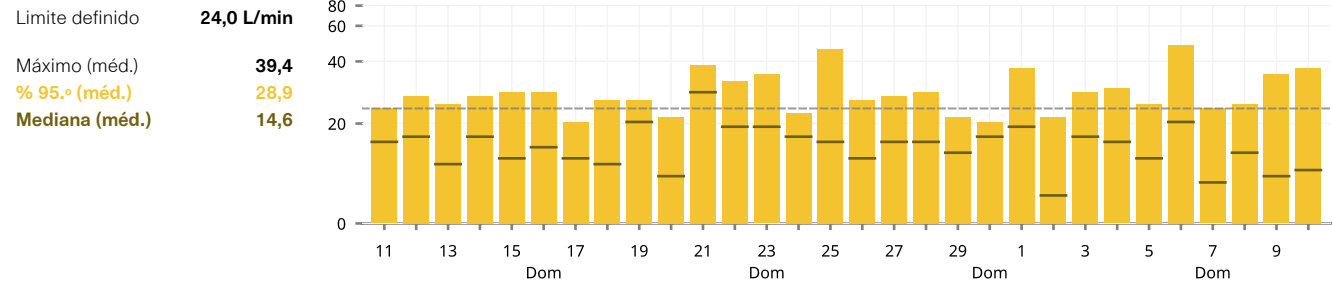

Pressão (cmH2O)

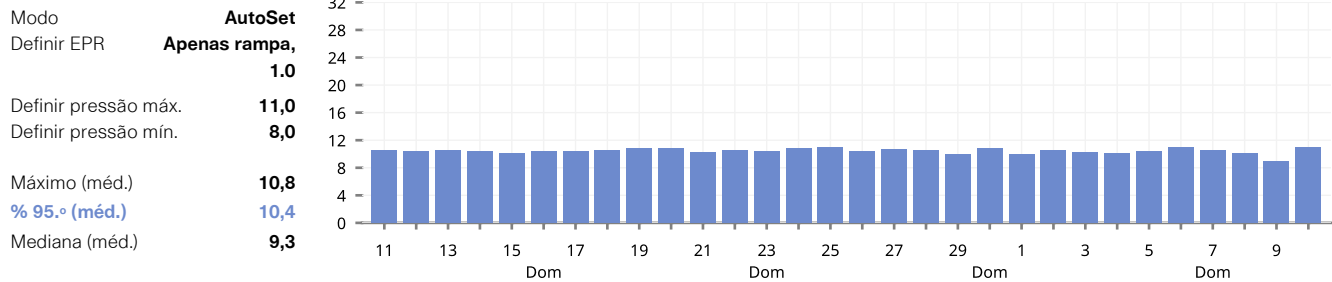

IAH (eventos/hora)

