


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/01/2026 - 02/02/2026
Dias de utilização	8/15 dias (53%)	
>= 4 horas	8 dias (53%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	54 horas 9 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/02/2026)	1,229 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609906
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 9.2	Máximo: 9.3	
Fugas — l/min	Mediana: 19.7	Percentil 95.º: 36.8	Máximo: 46.8	
Eventos por hora	IA: 6.6	IH: 1.8	IAH: 8.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 2.8	Desconhecid	3.6
Índice RERA	3.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

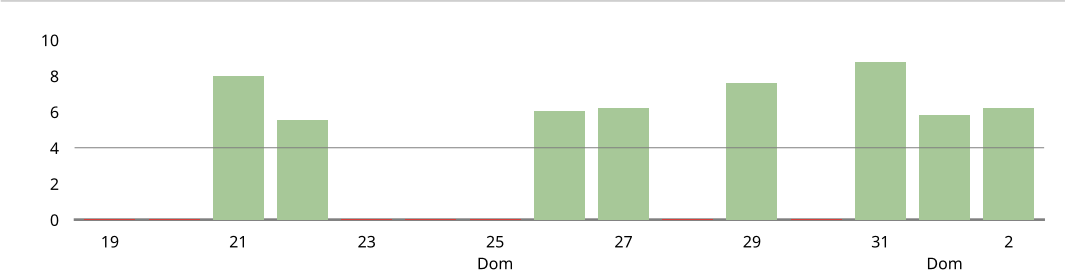

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609906

Utilização (horas)

Dias de utilização**8/15 (53 %)**

>= 4 horas dias

8 (53 %)


< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização**7 (47 %)**

Dias sem dados**0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.)**6,8 h**

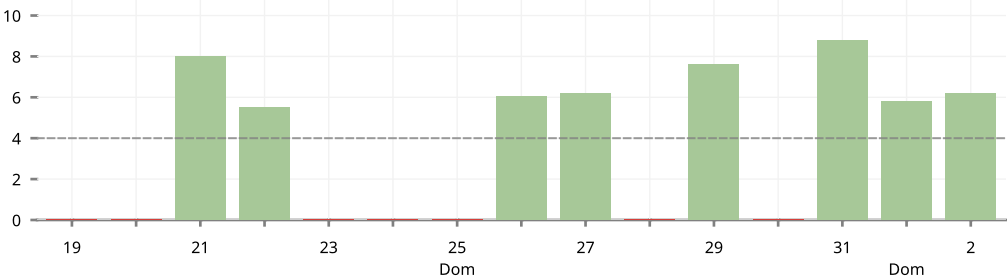


Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**

Máximo (méd.)**46,8**

% 95.º (méd.)**36,8**

Mediana (méd.)**19,6**

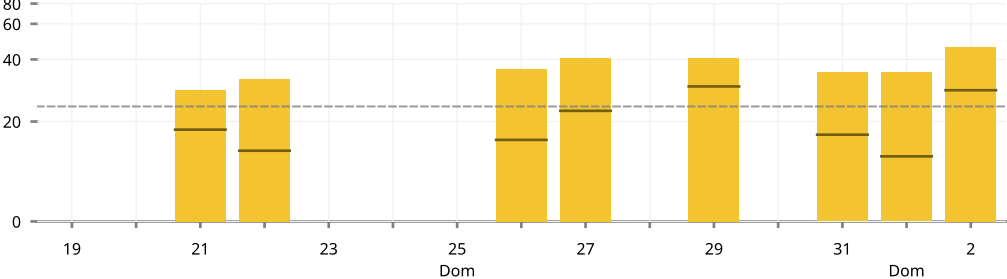

Pressão (cmH2O)

Modo**AutoSet**

Definir EPR**Apenas rampa, 2.0**


Definir pressão máx.**9,4**

Definir pressão mín.**6,0**

Máximo (méd.)**9,3**

% 95.º (méd.)**9,2**

Mediana (méd.)**8,3**

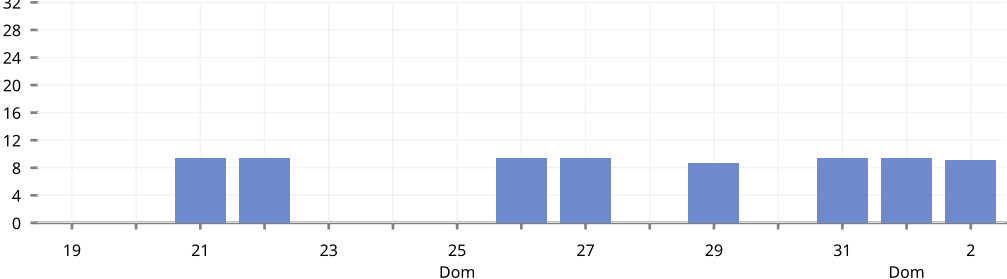

IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **8.4**

IH ☐ **1.8**

IA ☐ **6.6**

IAC **0,1**

IAO **2,8**

IAD **3,6**

RERA **3,9**

%RCS (méd.)**0.0**

